




Znak: AE/ZP-27-119/24

Tarnów, 2025-01-23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz siatek do przepuklin i taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 25.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 25 wapna sodowanego o poziomie pylenia ($< 0,5\text{mm}$) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO_2 w min. 130 l/kg , w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 82,50%, NaOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%, z indykatorem zużycia, w opakowaniach o gramaturze 5 kg ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 31.** Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 31 cewnika permanentnego poliuretanowego schodkowego o średnicy 14,5 Fr i długościach :19 cm, 23 cm,27cm,31cm,35cm od mufki do zakończenia i przepływie powyżej 400ml/min. w zestawie do inplantacji ? Pozwoli to naszej Firmie złożyć konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 30.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 30 - Zestaw do cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie, krótkoterminowego utrzymywania. Każdy zestaw zawiera: cewnik nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, igłę wprowadzającą echogeniczną, strzykawkę, przewodnik z końcówką J, 2 x rozszerzacz, koreczki heparynizowane. Ramiona cewnika posiadają nadruk określający objętość wypełnienia kanałów. Cewniki dwukanałowe 12 Fr w wymaganych długościach: 15cm, 20cm, 24cm; sterylne
4. **Dotyczy Pakietu Nr 31.** Czy Zamawiający w pakiecie 31 dopuści cewniki długoterminowe renomowanego producenta- firmy Arrow o następujących parametрах: Cewniki permanentne do hemodializy z mufą : ARROW-Clark™ VectorFlow™ z materiału Quadrathane™

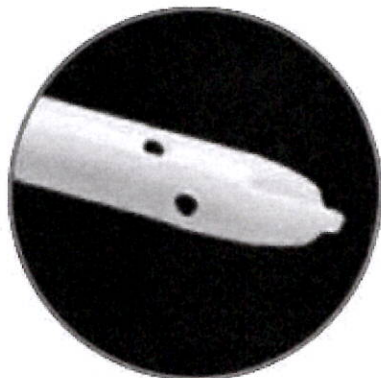

system tunelizacji wstecznej (RETROGRADE)

15Fr dostępne długości od symetrycznej końcówki do mufy sprzedawane w opakowaniach a` 1 szt.:
19 cm, 23 cm, 27 cm, 31 cm, 42 cm, 55 cm

Elementy sterylnego zestawu wprowadzającego:

1 szt. Przewodnik druciany 120cm z powłoką PTFE o przekroju: .038" (.97 mm) z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, przewodnica umieszczona w pochewce w kształcie koła. Zestaw wprowadzający ArrowAdvancer z nakładką zabezpieczającą

1 szt. SmartSeal® rozrywalna koszulka z podwójną zastawką hemostatyczną i rozszerzadłem: 16 Fr/13cm

1 szt. cienkościenna igła punkcyjna 6,35cm/18Ga x 21/2" XTW



- 1 szt. tunelizator metalowy
 2 szt. korki Luer-Lock
 1 szt. opatrunek Tegaderm® 10 cm x 12 cm
 1 szt. SharpsAway II™ kubek z blokadą na igły
 1 szt. bezpieczny skalpel rozmiar 11
 1 szt. karta identyfikacyjna pacjenta
 1 szt. rozszerzadło 12 Fr
 1 szt. rozszerzadło 14 Fr
 2 szt. uszczelki silikonowe
5. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści laryngoskop składający się z rękojeści, z wbudowanym źródłem światła w postaci diody LED?
 6. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz.: 1, 2, 3.** Czy w poz. 1, 2, 3 Zamawiający dopuści łyżki bez wymiennych światłowodów, ale przeznaczone na 4000 cykli sterylizacyjnych?
 7. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 4.** Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści rękojeść laryngoskopu LED?
 8. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 6.** Czy Zamawiający zrezygnuje z pozycji nr 6, z racji tego, że światłowody wytrzymują 4000 cykli sterylizacyjnych?
 9. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1 i 2.** Czy w poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści następujące wymiary łyżek:

Rozmiar	Dł. całkowita	Szerokość
Mac 2	116	14
Mac 3	136	14
Mac 4	156	14
Mac 5	174	14
 10. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 9.** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepack 12 o szerokości 107 mm.
 11. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 1, 3.** Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin z wycięciem na powróżek nasienny, niewchłaniające z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o gramaturze 85 g/m² i grubości 0,55 mm ?
 12. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin, niewchłaniające z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o gramaturze 85 g/m² i grubości 0,55 mm, o rozmiarze 50 mm x 100 mm?
 13. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin, niewchłaniające z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o gramaturze 85 g/m² i grubości 0,55 mm, o rozmiarze 60 mm x 110 mm lub 80 mm x 150 mm?
 14. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin, niewchłaniające z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o gramaturze 85 g/m² i grubości 0,55 mm, o rozmiarze 10 mm x 150 mm?
 15. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin, niewchłaniające z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o gramaturze 85 g/m² i grubości 0,55 mm, o rozmiarze 220 mm x 350 mm?
 16. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin, niewchłaniające z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o gramaturze 85 g/m² i grubości 0,55 mm, bez pokrycia tytanem?
 17. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin, niewchłaniające z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o gramaturze 55 g/m² i grubości 0,55 mm, wielkość porów 1,3 x 2,0 mm, o rozmiarze 150 mm x 300 mm?
 18. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin, niewchłaniające z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, o gramaturze 55 g/m² i grubości 0,55 mm, wielkość porów 1,3 x 2,0 mm?
 19. **Dotyczy Pakietu Nr 31.** Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał automatyczną podwójną zastawkę hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika?
 20. **Dotyczy Pakietu Nr 31.** Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał ruchome skrzydełko?
 21. **Dotyczy Pakietu Nr 31.** Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał wygiętą końcówkę chroniącą przed odkładaniem się skrzeplin?



22. **Dotyczy Pakietu Nr 31.** Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści:

Zestaw dializacyjny permanentny (stały) 15,5F, zakładany metodą Seldingera, dostępny wyłącznie w wersji z ramionami prostymi, wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na odkładanie się skrzeplin. Zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip) Pakowane pojedynczo.

Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm, 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm do wyboru przez Zamawiającego



- zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,
- końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,
- osobny kanał dla przewodnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,
- posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,
- wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanych,
- końcówki luerskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu

Zestaw: Iгла wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne

23. **Dotyczy Pakietu Nr 31.** Czy Zamawiający jest otwarty na oferty od różnych producentów, które mogą w pełni zaspokoić potrzeby zadania, nawet jeśli ich rozwiązania nie są dokładnie zgodne z wcześniej opisanymi specyfikacjami? Czy taka elastyczność w opisie może sprzyjać większej konkurencyjności w postępowaniu zgodnie z art. 29 ust. 2 i 7 ust. 1 ustawy Pzp?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 34.** Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści: Cewniki czasowe do hemodializy, 13F długości 15,20cm trzyświatłowy, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, pozostałe parametry jak w opisie.
25. **Dotyczy Pakietu Nr 34.** Czy Zamawiający jest otwarty na oferty od różnych producentów, które mogą w pełni zaspokoić potrzeby zadania, nawet jeśli ich rozwiązania nie są dokładnie zgodne z wcześniej opisanymi specyfikacjami? Czy taka elastyczność w opisie może sprzyjać większej konkurencyjności w postępowaniu zgodnie z art. 29 ust. 2 i 7 ust. 1 ustawy Pzp?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach 3.3 i 4.0 zamiast 3.0 i 4.0
27. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści maski kraniowe wykonane z PCV, z miękkim mankietem również wykonanym z PCV, niesilikonowanym?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rozmiary/zakresy wagowe: <5 kg, 5-10 kg, 10-20 kg, 20-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, >70 kg?


29. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 %, waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 30 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 %, waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 30 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny
36. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 %, waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 30 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści linię 5 cm przed i 10 cm za filtrem?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści powierzchnię filtrowania 1,5 cm²?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści długość ramienia głównego 60 cm oraz długość ramienia poprzecznego 20 cm?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rozmiary 10CH, 12CH, 14CH, 16CH, 18CH?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów +/- 10%?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści pas o wymiarach 135 cm x 3,2 cm?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 17.** Czy Zamawiający wymaga worka na wymiociny zawierającego dodatkowo saszetkę z absorbentem?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści balon 3 ml dla rozmiaru CH6?



46. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści balon 5-15 ml również dla rozmiarów 12CH i 14CH?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 24.** Czy Zamawiający dopuści rozmiary łyżek:
- Nr 2 – długość całkowita 105mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 82mm;
 - Nr 3 – długość całkowita 135mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 107mm;
 - Nr 4 – długość całkowita 155mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 127mm;
 - Nr 5 – długość całkowita 175mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 145mm?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 4 łyżki w rozmiarach 1, 2, 3, 4?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. poz.: 1, 2, 3.** Czy Zamawiający dopuści możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C przez 5 minut?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści diodę LED wkręcaną od zewnątrz rękojeści?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści montaż i demontaż światłowodu przy użyciu narzędzi?
52. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz.: 4, 5.** Czy Zamawiający dopuści średnicę 29 mm?
53. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewniki w długościach 13 cm, 16 cm, 20 cm?
54. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze 12 Fr?
55. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewniki w długościach 13 cm, 16 cm, 20 cm?
56. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści przewodnik 0.97/600 mm?
57. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rozszerzacz bez zastawki?
58. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5 ml?
59. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik, który jest połączony na stałe z ramionami?
60. **Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści pojemności wypełnienia kanału podane na ramionach?
61. **Dotyczy Pakietu Nr 37 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby aplikator gąbkowy był pokryty dwuwęglanem sodu, który ma działanie przeciwwzapalne, antyseptyczne oraz przeciwozrękowe?
62. **Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści czujniki dla wcześniaków i noworodków o wadze < 3 kg?
63. **Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 1.** W jakiej technologii mają być wykonane czujniki?
64. **Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści czujniki dla dzieci o wadze 1-15 kg?
65. **Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści czujniki dla dzieci o wadze 15-40 kg?
66. **Dotyczy pkt 23 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy: "W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w SWZ punkt 23.18 projektowe postanowienia umowy Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy
67. **Dotyczy pkt 23.13 b) SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od naliczania kar umownych w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości. Zamawiający przewidział kary za zwłokę w dostawie w punkcie 32.12.a, byłoby to podwójne naliczanie kar za to samo zawinięcie, poza tym po otrzymaniu zamówienia wysyłane są wszystkie dostępne produkty a w przypadku chwilowych braków magazynowych brakujący towar dosyłany jest niezwłocznie
68. **Dotyczy pkt 23.13 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości brutto umowy.



69. **Dotyczy pkt 23.14 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
70. **Dotyczy Pakietu Nr 45.** Czy Zamawiający dopuści Narzędzie dedykowane do mocowania siatek. Ładunki są wchłaniające, zbudowane z PLA (poliaktyd) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 6.7 mm. część penetrująca 5.9mm - 6mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Średnica głowicy 4,2 mm. Długość trzonu 36cm Ładunki całkowicie wchłaniają się po 12-18 miesiącach. Kompatybilny z trokarem 5 mm. Zawiera 30 zszywek. Urządzenia mają wskaźnik zużycia ładunków, są jednorazowe i sterylne. Zestawy pakowane po 5szt.

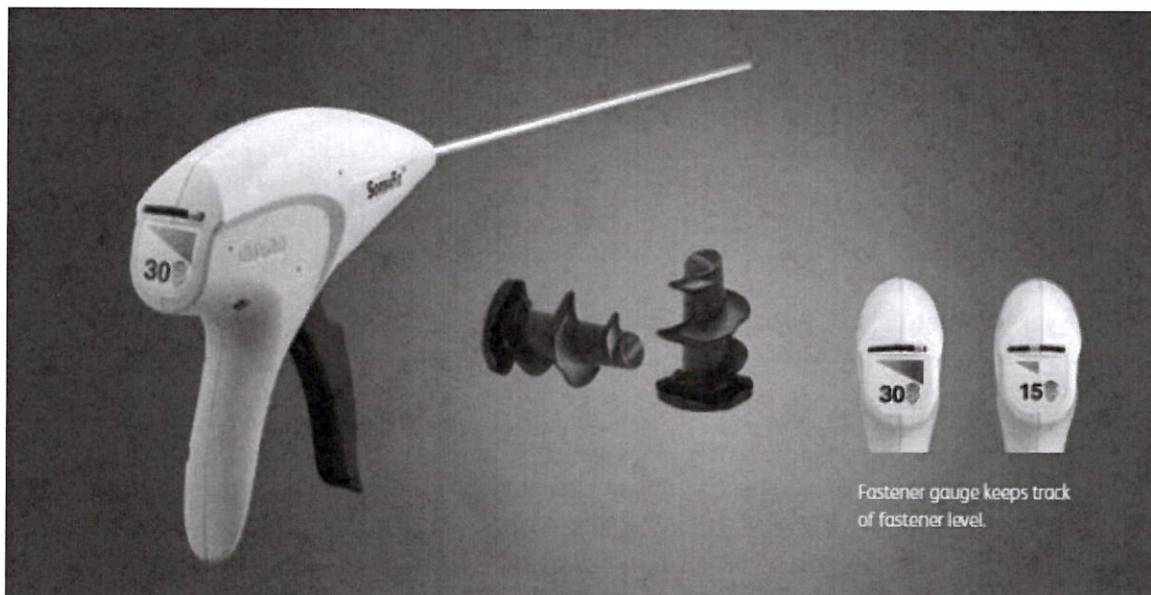

71. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1.** Czy Zamawiający w pakiecie 30 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych:
- średnica 11 FR - długość 15 cm, 20 cm, 25 cm – ramiona proste
- Charakterystyka cewnika:
- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
 - radiocieniujący szaft cewnika
 - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
 - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
 - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
 - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
 - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
 - kompatybilny z MRI
 - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
 - igła wprowadzająca 18G
 - rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr



- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

72. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1.** Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych ?

73. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1.** Czy Zamawiający w pakiecie 30 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych:

- średnica 13 FR - długość 15 cm, 20 cm, 25 cm – ramiona proste

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

74. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1.** Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych ?

75. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 31 poz. 1 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez otworów bocznych, z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi prostą i precyzyjną umieszczenie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.



- opakowanie zawiera 3 szt.

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

76. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 1.** Czy Zamawiający w pakiecie 34 poz.1 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowo (High Flow), bez otworów bocznych o długości 15 cm i 20 cm

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- rozszerzadło 13 Fr
- wyprodukowany w Niemczech

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

77. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 1.** Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

78. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra do żywienia pozajelitowego dla noworodków, do emulsji tłuszczowych, membrana 1,2 mikrona – filtr bardzo mały, płaski, łatwy do mocowania, neonatologiczny z maksymalnym czasem stosowania do 24 godzin, filtr wyposażony w zacisk szczelinowy i samoodpowietrzacz (nie przepuszcza powietrza) oraz dwa dreny z poliuretanu o długości około 5 do 10 cm przed i za filtrem, objętość wypełnienia około 0,5 ml a przepływ dla 20% emulsji lipidowej to około 10 ml/godzinę - membrana 1,2 mikrona zatrzymuje cząstki nieorganiczne i zanieczyszczenia mikrobiologiczne (np.: zarodniki grzybów), kolor obudowy NIEBIESKI - produkt sterylne, nie zawierający DEHP i lateksu?

79. **Dotyczy Pakietu Nr 7.** Prosimy o dopuszczenie jako równoważną jednorazową maskę krtaniową renomowanej firmy Ambu z mocno uwypukloną kopułą oraz dużym otworem oddechowym, wykonaną z PCV; posiadającą zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania maski w postaci wzmocnionego koniuszka; poprzeczne znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce; dren balonika kontrolnego luźny, połączony na krótkim odcinku z rurką; oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym; wykonaną z materiałów pozbawionych lateksu i szkodliwych ftalanów (w tym DEHP) z prawidłowym oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym; opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru; maski nie zawierają elementów metalowych, co umożliwia ich bezwarunkowe stosowanie w środowisku MRI; rozmiary: 1 (waga pacjenta: 2 – 5 kg), 1.5 (waga pacjenta: 5 – 10 kg); 2 (waga pacjenta: 10 – 20 kg); 2.5 (waga pacjenta: 20 – 30 kg); 3 (waga pacjenta: 30 – 50 kg); 4 (waga pacjenta: 50 – 70 kg); 5 (waga pacjenta: 70 – 100 kg); 6 Waga pacjenta: > 100 kg).

80. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj. – optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia. co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu.

81. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje przedłużaczy z kranikiem o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwi osiągnięcie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej

82. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 5.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 poz. 5 miał na myśli próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy



minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Oferowany przez nas próżnociąg położniczy zalecany jest do wszystkich ułożeń płodu i zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

83. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?
84. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych, o gładkiej powierzchni?
85. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga rurek ze znacznikiem głębokości w postaci grubego ringu dookoła?
86. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga rurki z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicy mankieta na baloniku kontrolnym?
87. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?
88. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Zamawiający wymaga rurek silikonowanych, o gładkiej powierzchni?
89. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga rurek ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych ringów dookoła rurki?
90. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?
91. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych, o gładkiej powierzchni?
92. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga rurek ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych ringów dookoła rurki?
93. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?
94. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych, o gładkiej powierzchni?
95. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz.: 6, 7, 10.** Czy Zamawiający w pozycji 6,7,10 wymaga zaoferowania papierów oryginalnych firmy Mitsubishi i Sony, czy dopuszcza zamienniki innego Producenta stosowane w Placówkach Służby Zdrowia?
96. **Dotyczy Pakietu Nr 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów sterylizowanych tlenkiem etylenu, jak 95% wyrobów medycznych jednorazowego użytku na polskim i światowym rynku? Sterylizację radiacyjną filtrów przeprowadza wyłącznie jeden producent (i to nie wszystkie typu filtrów!!), co stawia go w sytuacji uprzywilejowanej. Sterylizacja tlenkiem etylenu jest najczęściej stosowaną metodą sterylizacji, prowadzoną wg. ścisłych procedur walidacji. W przeciwnym przypadku, prosimy o uzasadnienie medyczne.
97. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z możliwością odsysania znad mankieta?
98. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści rurki o następujących rozmiarach:

ROZMIAR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	ROZMIAR RURKI
6 Fr	2.0 mm	310 mm (±10)	250 mm (±5)	od 2,0 do 4,0
10 Fr	3.3 mm	390 mm (±10)	350 mm (±5)	od 4,5 do 6,5
14 Fr	4.7 mm	390 mm (±10)	355 mm (±5)	od 7,0 do 10,0

99. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści maski w następujących rozmiarach

ROZMIAR	KOLOR BALONIKA KONTROLNEGO	PRZEDZIAŁ WAGOWY PACJENTA
1,0	Czarny	≤ 5 kg
1,5	Biały	5-10 kg
2,0	Czerwony	10-20 kg
2,5	Pomarańczowy	20-30 kg
3,0	Zielony	30-50 kg
4,0	Zółty	50-70 kg
5,0	Różowy	70-100 kg



100. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestawy zakończone są uniwersalną końcówką, która pozwala na podłączenie drenów o średnicach 8÷ 16 CH/?
101. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści dren Redon o długości 70 cm, w rozmiarach Ch8-Ch18, pakowane w wersji zwiniętej, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
102. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 4.** Czy Zamawiający oczekuje sondy wykonanej z silikonu, nie zawierającej lateksowych elementów co zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych?
103. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz.: 1, 2.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
104. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii o następujących rozmiarach:

ROZMIAR	OBWÓD GŁOWY
S	200 – 280 mm
M	240 – 340 mm
L	300 – 400 mm


105. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Cardio-Aid 50mm x30 m gładki?
106. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz.6, 7, 10.** Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych?
107. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści papier kratkowany w rozmiarze 112x100x100 z przeliczeniem zamawianych ilości?
108. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści papier kratkowany w rozmiarze 112x100x200 z przeliczeniem zamawianych ilości?
109. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 210x30?
110. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 152x100x150?
111. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 150x100x150?
112. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.1-4.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
113. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 36mm?
114. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 43mm lub 48mm?
115. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 3.** Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 36mm lub 54mm?
116. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 36x48mm?
117. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
118. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 5-6.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
119. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH6-18?
120. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewnik do embolektomii w rozmiarze F2 o długości 60cm oraz F3-F8 o długości 80cm?
121. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści dren o wymiarach ramion 45x18 cm?
122. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
123. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'200 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
124. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
125. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
126. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
127. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?



128. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
129. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach CH16-24 z balonem 5-10ml?
130. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony atraumatyczną, natłuszczoną końcówką zabezpieczoną zatyczką?
131. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
132. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
133. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz.: 1, 2.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
134. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz.: 1, 2.** Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o następujących właściwościach jak na zdjęciu:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Typ wachlarzyk
- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Wykonana z polipropylenu (uchwyt) oraz LDPE (włosie)
- Daleki zasięg dzięki długiej ręczce
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

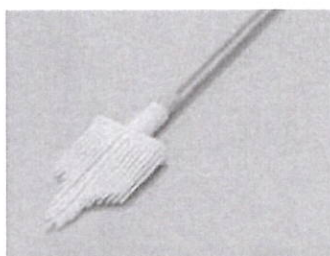



135. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 4.** Zamawiający dopuści wziernik wykonany z białego, nieprzezroczystego plastiku?
136. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 4-5.** Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu?
137. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz.:1, 4.** Czy Zamawiający dopuści nebulizator o następujących właściwościach:
- Wykonany z nietoksycznych materiałów
 - Dren o długości 210 cm, odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
 - Nebulizator o pojemności 6 ml (skalowany co 1 ml), wytwarzający cząsteczki o średniej wielkości MMAD = 3,91 µm przy przepływie 6 l/min.
 - W zestawie nebulizator, dren, złączka typu T, ustnik, zastawka jednokierunkowa oraz rurka karbowana
 - Uniwersalny łącznik T o średnicy 22M/15F - 22F umożliwia podłączenie zestawu do:
 - rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej
 - obwodu oddechowego
 - i wykonanie nebulizacji u pacjenta wentylowanego mechanicznie
 - Uniwersalny (odłączalny) ustnik umożliwia wykonanie nebulizacji u pacjenta oddychającego samodzielnie
 - Silikonowa zastawka jednokierunkowa (odłączalna) redukuje straty leku podczas nebulizacji
 - Jednorazowego użytku
 - Nie zawiera lateksu
 - Nie zawiera ftalanów
 - Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
 - Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

138. **Dotyczy Pakietu Nr 46.** Dopuszcza produkt o zbliżonych parametrach tj. : Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu .Materiał :polipropylene monofilamentowy, Długość:50cm Szerokość:1,2cm Grubość: 0,46 mm +/-10% Porowatość:84% +/-5% Gramatura: 67g/m2 +/-10% , Grubość włókien:120 um, Powierzchnia oczek:0,23 mm2 , Średnica oczek:0,56mm , Pętla na końcach wykonane z przędzy poliestrowej, pokryta osłonkami termokurczliwymi z silikonu i poliolefiny klasy medycznej. W centralnej części taśmy umieszczony element do pozycjonowania taśmy z możliwością korekty napięcia taśmy.

139. **Dotyczy Pakietu Nr 46.** Dopuszcza zaofiarowanie o zbliżonych parametrach taśmy polipropylenej, monofilamentowej do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o średnicy włókna 0,15 mm ,długości 50 cm i szerokości 1,25 cm, grubość 0,5 mm, gramatura 70g/m2, porowatość 86% , wytrzymałość 55N/cm, grubość nici 0,15mm. Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętli na całej długości taśmy. Specjalny splot warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma nie wymagająca dwuczęściowej plastikowej osłonki. Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę. Implantacja narzędziem wielorazowego użytku ?



140. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania okularków do fototerapii o poniższym opisie:
 Model składa się z gumki i osłony na oczy
 Struktura siatki pozwala aby promieniowanie UV docierało do skóry głowy (z wyłączeniem oczu).
 Występują w trzech rozmiarach:
 - S – 23 cm (20 - 24 cm)
 - M – 27 cm (25 – 28 cm)
 - L – 32 cm (29 - 33 cm)

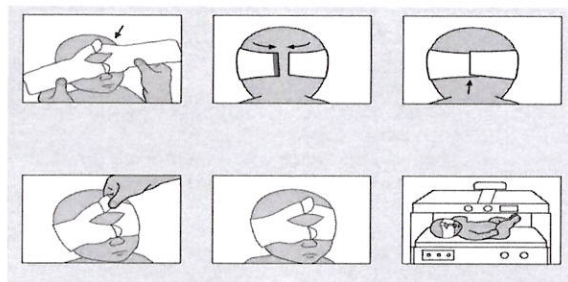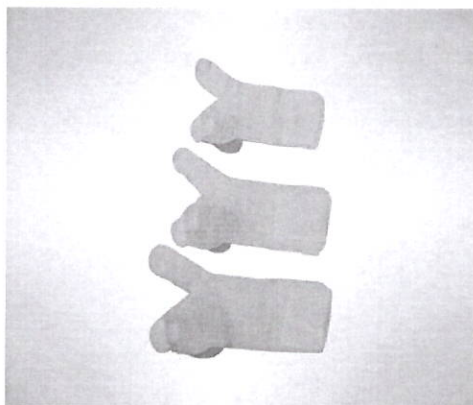

141. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.: 5, 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości
142. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
143. **Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania produktu o poniższym opisie:
 - zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań np. z wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym.
 - w jego skład wchodzi: pojemnik 25 ml, skalowany co 1 ml, zakrętka z końcówkami dł. 37 i 39 cm, dodatkowa zakrętka zabezpieczająca pojemnik, dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania, etykieta samoprzylepna
 - niepirogenny, nietoksyczny
 - nie zawiera ftalanów
 - sterylizowany tlenkiem etylenu
 - jednorazowego użytku?
144. **Dotyczy pkt 23 SWZ.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 23.13
 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 c) **0,5%** wartości wynikającej z różnicy pierwotnej wartości brutto umowy oraz zwaloryzowanego zgodnie pkt.23.34 – 23.39 SWZ wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt.23.34 SWZ.
145. **Dotyczy pkt 23 SWZ.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 23.14
 W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania/wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy
146. **Dotyczy Pakietu Nr 46.** Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonane z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego; szerokość 1.1 cm (+/- 0.1 cm), długość 45 cm, grubość 0.34 mm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 X 1,25 mm. Brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. Taśmy umieszczone w plastikowej, dwuczęściowej osłonce. Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę

konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

147. **Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 7.** Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tej pozycji z pakietu, w związku z wycofaniem tego produktu z oferty?
148. **Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatkę o wielkości 11,5x14,5 cm?
149. **Dotyczy Pakietu Nr 46.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt o poniższych parametrach:
Taśma urologiczna Dallop NM wytwarzana jest techniką dziewiarską z transparentnej monofilamentowej przędzy propylenowej. Na obydwu końcach taśma zaopatrzona jest uchwyty również z przędzy monofilamentowej w kolorze niebieskim, pozwalające na bezpieczne zamocowanie na odpowiednim aplikatorze, a także dobrą widoczność w polu operacyjnym. Każdy uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem w postaci rurek termokurczliwych. Masa powierzchniowa taśmy (bez uchwytów) 65-75 g/m², szerokość taśmy 1,1 cm +/- 0,2, grubość nitki 0,16 mm, powierzchnia porów ok. 5,9 mm² długość taśmy (bez uchwytów) 45 cm. Taśma charakteryzuje się bezpiecznymi, atraumatycznymi brzegami, niską masą liniową, biostabilnością, dzięki czemu nie traci właściwości fizycznych podczas długotrwałego kontaktu z tkankami i płynami ustrojowymi, porowatą strukturą minimalizującą ryzyko infekcji bakteryjnej, optymalnie opracowaną strukturą przestrzenną, gdzie wielkość porów umożliwia szybkie przerastanie tkanką łączną. Taśma urologiczna przeznaczona jest do stosowania w chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet metodami TVT i TOT, które umożliwiają beznapięciowe założenie implantów syntetycznych
150. **Dotyczy Pakietu Nr 35.** Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:
- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
 - wykonane z miękkiej tkaniny
 - strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
 - unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
 - mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
 - odporne na płyny
 - brak zawartości lateksu
 - przezierne dla promieni RTG ?????
 - uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych m.in. Mistral-Air, kompatybilność poświadczona przez producenta
151. **Dotyczy Pakietu Nr 35.** Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym, w związku z tym prosimy o zwiększenie zapotrzebowania do 30 sztuk.
152. **Dotyczy Pakietu Nr 35.** Prosimy o dopuszczenie koców na całe ciało pacjenta i wymiarach: 195 x 100 cm.
153. **Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie czujników dla dzieci poniżej 3 kg i dorosłych powyżej 30kg.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 25** wapna sodowego opisanego w pytaniu pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie 31** cewnika permanentnego w zestawie do implantacji opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 30.**



Ad. 4

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 31** cewników długoterminowych opisanych w pytaniu.

Ad. 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 1** laryngoskopu składającego się z rękojeści, z wbudowanym źródłem światła w postaci diody LED.

Ad. 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz.: 1, 2, 3** łyżek bez wymiennych światłowodów.

Ad. 7

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 4** rękojeści laryngoskopu LED, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

Ad. 8

Zamawiający nie zrezygnuje z przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 24 poz. 6**.

Ad. 9

Zamawiający podtrzymuje określone w SWZ wymagania dotyczące rozmiaru łyżek ujętych w **Pakiecie Nr 24 poz. 1 i 2**.

Ad. 10

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 9** papieru do aparatu Lifepack o szerokości 107 cm.

Ad. 11

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 43 poz. 1 i 3**.

Ad. 12

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 43 poz. 2**.

Ad. 13

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 43 poz. 4**.

Ad. 14

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 43 poz. 5**.

Ad. 15

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 43 poz. 6**.

Ad. 16

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 43 poz. 7**.

Ad. 17

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 43 poz. 8**.

Ad. 18

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 43 poz. 9**.

Ad. 19-21

Zamawiający wymaga aby zaoferowany w **Pakiecie Nr 31** cewnik spełniał wymagania SWZ

Ad. 22

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 31 poz. 1** zestawu dializacyjnego permanentnego opisanego w pytaniu.

Ad. 23, 25

Zamawiający jest otwarty na oferty od różnych producentów, ale w niektórych przypadkach ważne jest nie tylko jak to nazwał Wykonawca „zaspokojenie potrzeby zadania” ale również sposób w jaki to zadanie zostało rozwiązane. Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z



2024r. poz.1320) nie wymagają od Zamawiającego zakupu wyrobów, które nie spełniają w pełni jego wymagań, co zwłaszcza w świetle świadczonych przez Zamawiającego usług jest niezmiernie ważne. To Zamawiający wie z jakimi przypadkami medycznymi ma do czynienia i jakiego sprzętu potrzebuje w celu świadczenia usług zdrowotnych. W związku z tym, iż Wykonawca nie podał w tych pytaniach żadnych parametrów proponowanego asortymentu Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 31 i Pakiecie Nr 34.**

Ad. 24

Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 34 poz. 1** opisane w pytaniu czasowe cewniki do hemodializy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym składu zestawu.

Ad. 26

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 6** przewodnic 3,3 zamiast 3,0, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym również w zakresie pozostałych rozmiarów.

Ad. 27

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** masek krtaniowych wykonanych z PCV, z miękkim mankietem również wykonanym z PCV, niesilikonowanym

Ad. 28

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie **Pakiecie Nr 7 poz. 1** masek krtaniowych tylko w rozmiarach/zakresach wagowych podanych w pytaniu.

Ad. 29-31

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 2.**

Ad. 32-34

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 4.**

Ad. 35-37

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 5.**

Ad. 38

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 8** filtra z linią 5 cm przed i 10 cm za filtrem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 39

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 8** filtrów z powierzchnia filtrowania 1,5 cm², pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym w zakresie przepuszczania lipidów, i zatrzymywania: cząsteczek, pęcherzyków powietrza, grzybów i drożdży.

Ad. 40

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 19 poz. 1.**

Ad. 41

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 19 poz. 1** drenów Kher bez rozmiaru mieszczącego się w zakresie 21-22 CH.

Ad. 42

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 22 poz. 5.**

Ad. 43

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 22 poz. 14.**

Ad. 44

Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 22 poz. 17** worka na wymiociny spełniającego wymagania określone w SWZ.

Ad. 45

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23 poz. 1** cewników Foley'a z balonem 3 ml dla rozmiaru CH6, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ



Ad. 46

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23 poz. 2** cewników Foley'a z balonem 5-15 ml dla rozmiarów 12CH i 14CH, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, w tym zaoferowania pozostałych rozmiarów cewników.

Ad. 47

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla łyżek do laryngoskopów oferowanych w **Pakiecie Nr 24 poz. : 1, 2, 3.**

Ad. 48

Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz. 1** kompletu zawierającego 4 łyżki w rozmiarach 1, 2, 3, 4, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, w tym długości całkowitej, szerokości, długości wewnętrznej poszczególnych rozmiarów oferowanych łyżek.

Ad. 49

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz.: 1, 2, 3,** w tym w zakresie sterylizacji.

Ad. 50

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 3**

Ad. 51

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 3.**

Ad. 52

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 4 i 5.**

Ad. 53

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 30 poz. 1.**

Ad. 54

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 31 poz. 1** cewników w rozmiarze 12 Fr.

Ad. 55

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 31 poz. 1** cewników w długościach 13 cm, 16 cm, 20 cm.

Ad. 56

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 31 poz. 1** przewodników 0.97/600 mm.

Ad. 57

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 31 poz. 1** rozszerzaczy bez zastawki.

Ad. 58

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 31 poz. 1** strzykawek 5 ml.

Ad. 59

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 31 poz. 1** cewników, które są połączone na stałe z ramionami.

Ad. 60

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 33 poz. 1** pojemności wypełnienia kanału podane na ramionach, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, w tym parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia i składu zestawu

Ad. 61

Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 37 poz. 1** gąbek do higieny jamy ustnej spełniających wymagania SWZ.

Ad. 62

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 39 poz. 1.**

Ad. 63

Zamawiający wymaga dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 39 poz. 1** określił w SWZ.



Ad. 64

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 39 poz. 2.**

Ad. 65

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 39 poz. 3.**

Ad. 66-69, 144-145

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę oraz wprowadzenie nowych zapisów do **pkt 23 SWZ.**

Ad. 70

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 45** opisanych w pytaniu narzędzi dedykowanych do mocowania siatek.

Ad. 71

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 30 poz. 1.**

Ad. 72

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30 poz. 1** cewników z ramionami prostymi i zagiętymi.

Ad. 73

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 30 poz. 1.**

Ad. 74

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30 poz. 1** cewników z ramionami prostymi i zagiętymi.

Ad. 75

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 31 poz. 1** cewnika dwuświatłowego długoterminowego opisanego w pytaniu.

Ad. 76

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 34 poz. 1** cewnika trójświatłowego długoterminowego opisanego w pytaniu.

Ad. 77

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 34 poz. 1** cewników z ramionami prostymi i zagiętymi.

Ad. 78

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 8** filtra opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 79

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7** masek krtaniowych opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 80-81

Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 8 poz. 3** przedłużaczy z kranikiem tójdrożnym spełniających wymagania SWZ.

Ad. 82

Zamawiający w **Pakiecie Nr 29 poz. 5** miał na myśli próżnościąg spełniający wymagania SWZ.

Ad. 83-84

Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** rurek intubacyjnych spełniających wymagania SWZ.

Ad. 85-86

Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** rurek intubacyjnych spełniających wymagania SWZ.

Ad. 87-89

Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 3** rurek intubacyjnych zbrojonych spełniających wymagania SWZ.



Ad. 90-91

Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** rurek intubacyjnych z możliwością odsysania z nad balonu spełniających wymagania SWZ.

Ad. 92-94

Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** rurek intubacyjnych zbrojonych spełniających wymagania SWZ.

Ad. 95, 106

Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 13 poz.: 6, 7, 10** papierów rejestracyjnych do aparatury medycznej spełniających wymagania SWZ.

Ad. 96

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9** filtrów sterylizowanych tlenkiem etylenu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 97

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 4**.

Ad. 98

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 6**.

Ad. 99

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** masek krtaniowych w rozmiarach: ≤5 kg, 5 - 10 kg, 10-20 kg, 20-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 100

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 1**.

Ad. 101

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 2**.

Ad. 102

Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 10 poz. 4** sond-zgłębników Sengstakena spełniających wymagania SWZ.

Ad. 103

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 11 poz. 1 i 2** opakowań po 50 szt. W przypadku oferowania opakowań po 50 sztuk należy zaferować w poz. 1 - 5 takich opakowań, a w poz. 2 – 150 takich opakowań.

Ad. 104

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 3** okularów w rozmiarach wymienionych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 105

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 4** gładkiego papieru do defibrylatora Cardio-Aid.

Ad. 107-108

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 13 poz. 11**.

Ad. 109

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 13 poz. 12**.

Ad. 110-111

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 13 poz. 14**

Ad. 112

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 16 poz. 1-4** opakowań po 50 szt. W przypadku oferowania opakowań po 50 sztuk należy zaferować: w poz. 1 - 2 takie opakowania, w poz. 2 – 1700 takich opakowań, w poz. 3 – 1100 takich opakowań, w poz. 4 – 2 takie opakowania.



Ad. 113

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 1** elektrod do monitorowania EKG o średnicy 36 mm, pod warunkiem, że przeznaczone są dla dzieci i spełniają pozostałe wymagania SWZ.

Ad. 114

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 2** elektrod do monitorowania EKG o średnicy 43 mm, pod warunkiem, że przeznaczone są dla dorosłych i spełniają pozostałe wymagania SWZ.

Ad. 115

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 3** elektrod holterowskich o średnicy 54 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 116

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 4** elektrod do EKG o wymiarach 36x48 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 117

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 17 poz. 4** opakowań po 50 szt. W przypadku oferowania opakowań po 50 sztuk należy zaoferować w poz. 4- 32 takie opakowania.

Ad. 118

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 17 poz. 5-6** opakowań po 100 szt. W przypadku oferowania opakowań po 100 sztuk należy zaoferować: w poz. 5 - 11 takich opakowań, w poz. 6 – 7 takich opakowań.

Ad. 119

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18 poz. 2** cewników do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych bez rozmiaru F4 lub F5.

Ad. 120

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18 poz. 3** (Wykonawca zadał pytanie do Pakietu Nr 18 poz. 2 ale opisany w pytaniu przedmiot zamówienia jest ujęty w Pakiecie Nr 18 poz. 3) cewników do embolektomii w rozmiarze F2 o długości 60 cm oraz F3-F8 o długości 80 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 121

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 19 poz. 1**.

Ad. 122

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 21 poz. 1** opakowań po 50 szt. W przypadku oferowania opakowań po 50 sztuk należy zaoferować: w poz. 1 - 240 takich opakowań.

Ad. 123

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 21 poz. 5** opakowań po 200 szt. W przypadku oferowania opakowań po 200 sztuk należy zaoferować: w poz. 5 - 3 takie opakowania.

Ad. 124

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 22 poz. 2** opakowań po 90 szt. W przypadku oferowania opakowań po 90 sztuk należy zaoferować: w poz. 2 - 4000 takich opakowań.

Ad. 125

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 22 poz. 6** opakowań po 10 szt. W przypadku oferowania opakowań po 10 sztuk należy zaoferować: w poz. 6 - 25 takich opakowań.

Ad. 126

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 22 poz. 13** opakowań po 10 szt. z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę W przypadku oferowania opakowań po 10 sztuk należy zaoferować: w poz. 13 - 2 takie opakowania.

Ad. 127

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 22 poz. 14** opakowań po 5 szt. W przypadku oferowania opakowań po 5 sztuk należy zaoferować: w poz. 14 - 5 takich opakowań.

Ad. 128

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 22 poz. 17** opakowań po 20 szt. W przypadku oferowania opakowań po 20 sztuk należy zaoferować: w poz. 17 - 25 takich opakowań.



Ad. 129

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23 poz. 2** cewników Foley'a w rozmiarze CH 16-24 z balonem 5-10 ml, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 130

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27 poz. 1** zestawów do lewatywy zakończonych atraumatyczną natłuszczoną końcówką zabezpieczoną zatyczką, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 131

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 27 poz. 2** opakowań po 100 szt. W przypadku oferowania opakowań po 100 sztuk należy zaoferować: w poz. 2 - 27 takich opakowań.

Ad. 132

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 27 poz. 3** opakowań po 10 szt. W przypadku oferowania opakowań po 10 sztuk należy zaoferować: w poz. 3 - 1500 takich opakowań.

Ad. 133

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 29 poz.: 1, 2** opakowań po 10 szt. W przypadku oferowania opakowań po 10 sztuk należy zaoferować: w poz. 1 - 70 takich opakowań, a w poz. 2 - 15 takich opakowań.

Ad. 134

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 29 poz.: 1, 2.**

Ad. 135

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 29 poz. 4.**

Ad. 136

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 29 poz. 4-5** do osobnego pakietu.

Ad. 137

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz.: 1, 4** (Wykonawca zadał pytanie do Pakietu Nr 29 poz.: 1, 4 ale opisany w pytaniu przedmiot zamówienia jest ujęty w Pakiecie Nr 42 poz.: 1, 4) nebulizatorów opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 138

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 46** taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu opisanych w pytaniu.

Ad. 139

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 46** taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu opisanych w pytaniu.

Ad. 140

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie 11 poz. 3** okularków do fototerapii opisanych w pytaniu.

Ad. 141

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 17 poz.: 5, 6** opakowań po 100 szt. W przypadku oferowania opakowań po 100 sztuk należy zaoferować: w poz. 5 - 11 takich opakowań, a w poz. 6 - 7 takich opakowań.

Ad. 142

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 22 poz. 2** opakowań po 80 szt. W przypadku oferowania opakowań po 80 sztuk należy zaoferować w poz. 2 - 4500 takich opakowań.

Ad. 143

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie 47 poz. 3** zestawów do pobierania próbek w postaci płynów opisanych w pytaniu.

Ad. 146

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 46** taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu opisanych w pytaniu.

Ad. 147

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 43 poz. 7.**

Ad. 148

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 44 poz. 1** siatki o wielkości 11,5x14,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 149

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 46** taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu opisanych w pytaniu.

Ad. 150

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 35.**

Ad. 151

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 35** opakowań po 10 szt. W przypadku oferowania opakowań po 10 sztuk i braku możliwości sprzedaży niepełnych opakowań należy zaoferować 3 takie opakowania, przy czym Zamawiający nie zwiększy zapotrzebowania do 30 sztuk.

Ad. 152

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 35**, w tym również dotyczące rozmiaru.

Ad. 153

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 39 poz. 1.**

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

MK

