


ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ

ELEM.	OPIS	WYMIARY Dł.xSz.xWys. (mm)	WAGA (kg)
1	GANTRY	2439x1006x1992	1816
2	STÓŁ PACJENTA	650x2347x1060	320
3	JEDNOSTKA DYSTRYBUCJI MOCY (PDU)	700x550x1062	370
4	CZĘŚCIOWY UPS	702x305x817	160
5	STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA NA STOJAKU	-	-
6	ELEKTRYCZNA SKRZYŃKA ROZDZIELCZA (PDB)	600x300x800	42
7	GOC4 KONSOLA	1240x1235x883	225
8	MODUŁ STERUJĄCY STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ	-	-
9	KONSOLA AW	1000x690	22

ŚCIANA - ZGODNIE Z OTRZYMANYM RYSUNKAMI

WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA BADAŃ

WYSOKOŚĆ OD PODŁOGI DO STROPU	3.20 m
WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZONEGO	min. 2.28 m

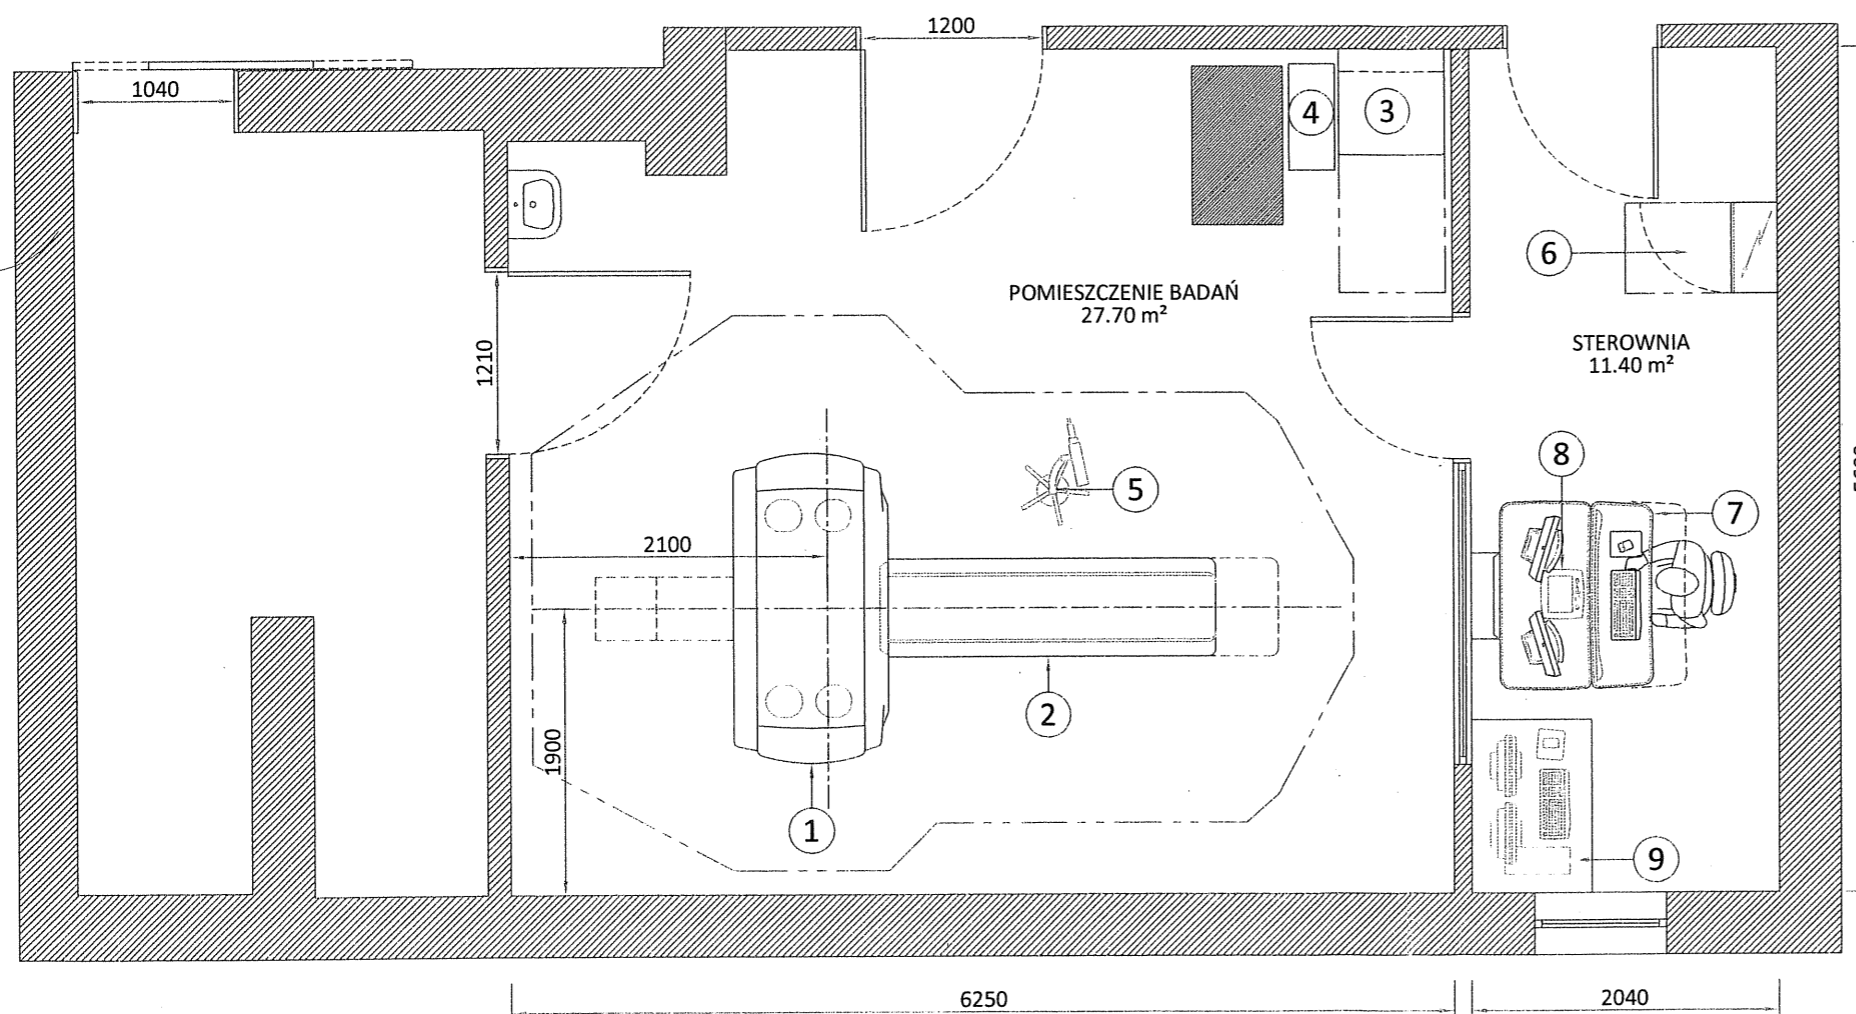

GE Medical Systems
Polska Sp. z o.o.
Michał Pietrzak
Project Manager of Installation