



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku



Płock, dnia 25 września 2024 r.

TZPiZI.261.1876.24

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr TZPiZI.261/04/D/24

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej PZP na dostawę pn. **Zakup sprzętu medycznego jednorazowego**

I. Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, zwaną dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które charakteryzują się: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna; paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; duży ekran z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu o zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; czas pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)- łatwość w obsłudze bez dodatkowych czynności sprawdzających; zakres hematokrytu 20-65%; część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu -  $\leq 20\text{mg/L}$ ; górna granica zakresu -  $\leq 600\text{ mg/dL}$ ; kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy; bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem (możliwość kontroli glukometru przed pierwszym użyciem); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 (przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowaną jednostkę TÜV Rheinland Polska Sp. o.o.)- parametry z normy ISO 15197:2015 są zalecane przez wytyczne PTD ; glukometr z dożywotnią gwarancją;

25<sup>lat</sup> Mazowsze

KRS: 0000029842 NIP: 774-10-02-289 REGON: 610317845

Telefon: 24 267-84-00; fax: 24 267-84-15

e-mail: [sekretariat@wspritsplock.pl](mailto:sekretariat@wspritsplock.pl) <http://wspritsplock.pl>

Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 09-400 Płock ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie: <http://wspritsplock.pl> w zakładce ochrona danych.

Informujemy, że glukometry do w/w pasków testowych zostaną przez nas dostarczone bezpłatnie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie 2:**

Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN ISO 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, że po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowe będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postępowaniach, w których umowa nie zakończyła się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie.

Czy wymagają Państwo:

a. glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015? **Odpowiedź: W formularzu oferty nie widnieje pozycja glukometr.**

b. dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną? – **Odpowiedź:nie wymaga**

c. potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?  
**Odpowiedź:nie wymaga**

#### **Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonyj pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów?

**Odpowiedź: W formularzu oferty nie widnieje pozycja glukometr.**

#### **Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?

**Odpowiedź: W formularzu oferty nie widnieje pozycja glukometr.**

#### **Pytanie 6:**

Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla symbol ostrzeżenia ketonowego w przypadku wyniku większego lub równego 240 mg/dl ( 13,3 mmol/l)?

**Odpowiedź: W formularzu oferty nie widnieje pozycja glukometr.**

**Pytanie 7: zadanie 1, poz. 148,**

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 8: zadanie 1, poz. 148,**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 9: zadanie 1, poz. 148,**

Czy zamawiający wydzieli poz.148 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 10: poz. 1-6,**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 11: Zadanie 9, poz. 6**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 12: do części 1, lp.76,77,78,79,80,81,159,160**

Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny oraz zasadą uczciwej konkurencji wydzieli z części 1 pozycji lp.76,77,78,79,80,81,159,160 ( stanowiące dość znaczną część wartości części 1) do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 13: Część 8 paski do glukometrów**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikrokuwety wraz z analizatorami HemoCue do oznaczenia glukozy, opierające się na laboratoryjnej precyzji pomiarowej. Mikrokuwety do oznaczenia glukozy są częścią systemu HemoCue (urządzenie przenośne). System HemoCue ([www.homecue.com](http://www.homecue.com)) daje możliwość podłączenia analizatora do systemów informatycznych zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 23 października 2023 r. „w sprawie standardów organizacyjnych badań laboratoryjnych parametrów krytycznych wykonywanych w materiale biologicznym, umożliwiających podjęcie szybkiej decyzji terapeutycznej”. Analizatory HemoCue są szeroko stosowane w jednostkach służby zdrowia.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 14: cz.4 filtr do ssaka**

Filtr BSU734 nie jest już produkowany. Został zamieniony filtrem o modelu BSU999. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tego produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 15: Część 1, pozycja 181**

Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy składający się z trzech pakietów o składzie:

PAKIET A:

1 szt. podkład chłonny 40 x 60 cm

1 szt. podkład nieprzemakalny

2 szt. ręczniczki do rąk

2 pary rękawiczek lateksowych

PAKIET B:

1 szt. gruszka do odsysania wydzieliny

4 szt. zaciski pępowinowe

4 szt. kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm

1 szt. nożyczki do pępowiny

PAKIET C:

1 szt. opaska identyfikacyjna dla noworodków

1 szt. kocyk dla noworodka 100 x 60 cm

2 szt. ręczniczki do rąk

1 szt. pielucha dla noworodka

1 szt. podpaska higieniczna

1 szt. torba foliowa na łóżysko?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zestaw porodowy składający się z trzech pakietów.**

**Pytanie 16: Część 1, pozycja 188-189, 200**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'10sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 17: Część 1, pozycja 190**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'5sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 18: Część 1, pozycja 190**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z gumką w rozmiarze 160x160cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 19: Część 1, pozycja 204**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100sztuk z przeliczeniem ilości na 1 opakowanie?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 20: Część 3**

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 21: Część 9, pozycja 4, 6**

Czy Zamawiający podając jednostkę miary sztuka, miał na myśli opakowanie a'3szt czy 1 sztukę kompresu?

**Odpowiedź: Zamawiający podając jednostkę miary sztuka, miał na myśli opakowanie a'3szt.**

**Pytanie 22: Część 9, pozycja 4, 6**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'3 sztuki z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ceny za opakowanie a'3 sztuki.**

**Pytanie 23: Część 9, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści plaster tkaninowy 1mx8cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 24: Część 9, pozycja 23**

Czy Zamawiający podając jednostkę miary sztuka, miał na myśli opakowanie a'24szt czy 1 sztukę przylepca?

**Odpowiedź: Zamawiający podając jednostkę miary sztuka, miał na myśli opakowanie a'24szt.**

**Pytanie 25: Część 9, pozycja 23**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'24szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: : Zamawiający wymaga przylepiec pakowany a'24szt.**

**Pytanie 26: Część 9, pozycja 24**

Czy Zamawiający podając jednostkę miary sztuka, miał na myśli opakowanie a'12szt czy 1 sztukę przylepca?

**Odpowiedź: : Zamawiający podając jednostkę miary sztuka, miał na myśli opakowanie a'12szt.**

**Pytanie 27: Część 9, pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'12szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: : Zamawiający wymaga przylepiec pakowany a'12szt.**

**Pytanie 28: Część 9, pozycja 25**

Czy Zamawiający podając jednostkę miary sztuka, miał na myśli opakowanie a'6szt czy 1 sztukę przylepca?

**Odpowiedź: Zamawiający podając jednostkę miary sztuka, miał na myśli opakowanie a'6szt.**

**Pytanie 29: Część 9, pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'6szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: : Zamawiający wymaga przylepiec pakowany a'6szt.**

**Pytanie 30: Pakiet 1, Pozycja 1-8**

Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworem centralnym i dwoma naprzemianległymi, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 31: Część 1, pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 2,0mm o długości roboczej 250mm +/-5mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 32: Część 1, pozycja 30**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości roboczej 250mm +/-5mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 33: Część 1, pozycja 31**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 3,3mm o długości roboczej 350mm +/-5mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 34: Część 1, pozycja 32-33**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4,7mm o długości roboczej 355mm +/-5mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 35: Część 1, pozycja 34-35**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice bez futerału, pakowane papier-folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prowadnice bez futerału, pakowane papier-folia.**

**Pytanie 36: Część 1, pozycja 36**

Czy Zamawiający dopuści łącznik 22M/15F – 15M z otworem do odsysania oraz bronchoskopii zabezpieczony zatyczką?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 37: Część 1, pozycja 37-38**

Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurek intubacyjnych w jednym rozmiarze, z uniwersalnymi rzepami umożliwiającymi szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy, z regulowanym uchwytem pozwalającym na zamontowanie każdego rozmiaru rurki, możliwość zaferowania w dwóch typach: z pionowym lub poziomym umocowaniem śruby?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 38: Część 1, pozycja 47-61**

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne niesilikonowaną z niskociśnieniowym, cienkościennym mankietem, bez znakowania rozmiarem na baloniku kontrolnym, ze śladową zawartością ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 39: Część 1, pozycja 62-68**

Czy Zamawiający dopuści niebieskie, nieprzeźroczyste maski z przeźroczystym tubusem i drenem jak na zdjęciu:



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 40: Część 1, pozycja 107-110**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z tłokiem z czterostronnym podcięciem na końcu tłoka, umożliwiającym jego złamanie i zapobiegnięciu ponownemu użyciu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 41: Część 1, pozycja 107-110**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z oznaczeniem kolorystycznym tylko na opakowaniu zbiorczym, nie zawierające ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 42: Część 1, pozycja 107**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową ze skalą nominalną rozszerzoną do 2,2ml?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 43: Część 1, pozycja 108**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową ze skalą nominalną rozszerzoną do 5,5ml?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 44: Część 1, pozycja 109**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową ze skalą nominalną rozszerzoną do 11ml?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 45: Część 1, pozycja 110**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową ze skalą nominalną rozszerzoną do 22ml w opakowaniach zbiorczych a'50 szt. z przeliczeniem opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 46: Część 1, pozycja 111**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 47: Część 1, pozycja 111**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą pomiarową co 2ml, bez ftalanów i lateksu, wyposażona w 2 dodatkowe łączniki luer?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 48: Część 1, pozycja 115-120**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z zielonym tłokiem wykonanym z polipropylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 49: Część 1, pozycja 115-120**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z nazwą producenta/logiem na korpusie strzykawkę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 50: Część 1, pozycja 115**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 3ml?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 51: Część 1, pozycja 123-128**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z portem górnym o kształcie zaoblonego trójkąta umieszczonego nad skrzydełkami jak na zdjęciu:



?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 52: Część 1, pozycja 123-128**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarach i przepływach jak poniżej:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPIYW [ml/min]
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 1/4"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1 1/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 1/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 1/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 53: Część 1, pozycja 123-128**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 54: Część 1, pozycja 135-136**

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



**Pytanie 55: Część 1, pozycja 136**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski w rozmiarze L ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 56: Część 1, pozycja 137-144**

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniu papier-folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 57: Część 1, pozycja 137-144**

Czy Zamawiający dopuści maski zawierające śladowe ilości ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 58: Część 1, pozycja 148**

Czy Zamawiający dopuści aparat o długości komory w części przezroczystej 45mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 59: Część 1, pozycja 151-152**

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne posiadające tylko optyczny identyfikator?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 60: Część 1, pozycja 153**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze dostępne w kolorze bursztynowym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 61: Część 1, pozycja 154**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kateterem do odsysania w rozmiarze CH21?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 62: Część 1, pozycja 163**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 120mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 63: Część 1, pozycja 165**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 64: Część 1, pozycja 166-173**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zatyczki?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 65: Część 1, pozycja 166-173**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o powierzchni gładkiej?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 66: Część 1, pozycja 175**

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków w opakowaniu a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 67: Część 1, pozycja 175**

Czy Zamawiający dopuści worki posiadające zastawkę w worku?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 68: Część 1, pozycja 176**

Czy Zamawiający dopuści kaczki na mocz wykonane z folii polietylenowej?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 69: Część 1, pozycja 178**

Czy Zamawiający dopuści aby worek na wymiociny posiadał dodatkową precyzyjną skalę pomiarową co 10ml dla małych objętości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 70: Część 1, pozycja 180**

Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki 90x220cm z dwoma parami rękawic?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 71: Część 1, pozycja 180**

Czy Zamawiający dopuści płachtę foliowa do przykrycia o wymiarach 220x180 bez dołączonych do zestawu rękawiczek foliowych?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 72: Część 1, pozycja 180**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oraz wycenę osobno płachty do zwłok oraz foliowych rękawiczek?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 73: Część 1, pozycja 182**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm
- cewnik 2,7 x 450 mm wykonany z poliuretanu -kontrastuje w promieniach RTG , koreczek zamykający , folia ochronna na cewnik
- podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika
- worek 2,0 L
- strzykawka trzyczęściowa 60 ml Omnifix z końcówką Luer Lock
- kranik trójdrożny Discofix?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw.**

**Pytanie 74: Część 1, pozycja 193**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 75: Część 1, pozycja 195**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za op.a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**

**Pytanie 76: Część 1, pozycja 201**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 77: Część 1, pozycja 202**

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 78: Część 1, pozycja 205**

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania o szlifie ołówkowym w rozmiarze 18G 12x30mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę do pobierania o szlifie ołówkowym w rozmiarze 18G 12x30mm.**

**Pytanie 79: Część 2, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelazem stałym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 80: Część 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 48mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody o średnicy 48mm.**

**Pytanie 81: Część 1, pozycja 30**

Czy zamawiający dopuści przewodnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze ID 2.0/255 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 82: Część 1, pozycja 31**

Czy zamawiający dopuści przewodnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze ID 3.3/340 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 83: Część 1, pozycja 33**

Czy zamawiający dopuści przewodnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze ID 4.7/340 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 84: Część 1, pozycja 34-35**

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę do trudnej intubacji pakowaną w opakowanie papierowo-foliowe z plastikowym zabezpieczeniem końcówki przewodnicy, bez futerału?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 85: Część 1, pozycja 36**

Czy Zamawiający dopuści łącznik do rurek intubacyjnych w rozmiarze 15F/22M?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 86: Część 1, pozycja 37:**

Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurek intubacyjnych dla dzieci przeznaczony do rurek w rozmiarze dziecięcym (od 2,0 – 6,0)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 87: Część 1, pozycja 47-61**

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne wykonane z medycznego PCV, niesilikonowane?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 88:Część , pozycja 62-68**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z medycznego PCV, zawierającą śladową ilość ftalanów, dopuszczoną do produkcji wyrobów medycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 89:Część 1, pozycja 82 – 95**

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową wykonaną z medycznego PCV, niesilikonowaną, zawierającą śladową ilość ftalanów, dopuszczoną do produkcji wyrobów medycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 90:Część 1, pozycja 107 – 110**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z zwężoną końcówką tłoka jak zdjęciu poniżej?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 91:Część 1, pozycja 112- 113**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową o długości całkowitej min. 15 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 92:Część 1, pozycja 115 – 120**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową z zielonym tłokiem, które w zamian parametru „bez lateksu, BPA” spełniają parametr „bez lateksu i bez ftalanów”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 93:Część 1, pozycja 115**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 ml w zamian 2 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 94:Część 1, pozycja 115 – 120**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową z tłokiem wykonanym z polietylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 95:Część 1, pozycja 122**

Czy zamawiający dopuści kaniulę dożylną (do delikatnych żył) noworodkowa typu neoflon. Kaniula wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Pakowane w opakowania typu Tyvek - zabezpieczające przed wilgocią. Na opakowaniu oznaczenie producenta

o braku lateksu w kaniuli. Jałowa, z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar 24G (0,7x19mm, przepływ 13ml/min) ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 96:Część 1, pozycja 123 – 128**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym w zamian bezpośrednio na kaniuli?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 97:Część 1, pozycja 123**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 24G (0,7x19 mm), przepływ 23 ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 98:Część 1, pozycja 125**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 20G (1,1x32 mm), przepływ 61 ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 99:Część 1, pozycja 126**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 18G (1,3x45 mm), przepływ 100 ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 100:Część 1, pozycja 127**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 17G (1,5x45 mm), przepływ 142 ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 101:Część 1, pozycja 128**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 16G (1,7x45 mm), przepływ 200 ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 102:Część 1, pozycja 134**

Czy Zamawiający dopuści igłę bezpieczną pakowaną po 100 sztuk z przeliczeniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 103:Część 1, pozycja 154**

Czy Zamawiający dopuści zestaw wyposażony w końcówkę do odsysania w rozmiarze ok CH21 (7,51mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 104:Część 1, pozycja 161 – 166**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady z standardowym wieczkiem zamykanym na wcisk lub zakręcane w zależności od pojemności ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 105:Część 1, pozycja 162**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 300 mm, średnicy górnej / dolnej : 240 / 200 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 106:Część 1, pozycja 176**

Czy zamawiający dopuści jednorazowe wkłady (stosowane wraz z wielorazowymi uchwytami z możliwością dezynfekcji) – zdjęcie poglądowe poniżej, takie rozwiązanie eliminuje czyszczenie, rozchlapywanie, rozlanie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Po 30 sekundach superchłonna wkładka higieniczna zamienia 600 ml płynów ustrojowych w żel. Wkładki są wykonane w 100% z materiałów recyklingowych. Wymiary: 16x43 cm, pakowane po 20 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 107:Część 1, pozycja 181:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy składający się z trzech pakietów o składzie:

PAKIET A:

- 1 szt. podkład chłonny 40 x 60 cm
- 1 szt. podkład nieprzemakalny
- 2 szt. ręczniczki do rąk
- 2 pary rękawiczek lateksowych

PAKIET B:

- 1 szt. gruszka do odsysania wydzieliny
- 4 szt. zaciski pępowinowe
- 4 szt. kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm
- 1 szt. nożyczki do pępowiny

PAKIET C:

- 1 szt. opaska identyfikacyjna dla noworodków
- 1 szt. kocyk dla noworodka 100 x 60 cm
- 2 szt. ręczniczki do rąk
- 1 szt. pielucha dla noworodka
- 1 szt. podpaska higieniczna
- 1 szt. torba foliowa na łóżysko?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 108:Część 1, pozycja 182:**

Czy w związku z wycofaniem opisanego zestawu Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej o składzie:

- worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2 000 ml z zastawką przeciwwrotną, zapobiegającą cofaniu się zaaspirowanych płynów oraz zaworem spustowym
- dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.)
- zastawki przeciwwrotne wzdłuż linii umożliwiające nieprzerwalną aspirację i drenaż bez użycia kranika trójdrożnego
- strzykawką 60 ml do aspiracji
- dostępny w kilku wersjach i rozmiarach:
  - trio igieł 55 mm (14G, 16G i 19G)
  - trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G)
  - igła Veress 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką
- sterylne
- opakowanie podwójne - zewnętrzne papier - folia, wewnętrzne folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 109 Część 2 poz.1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych na pasku po 4szt.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 110 Część 2 poz.1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych na pasku po 2szt.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 111 Część 2 poz.2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych na pasku po 2szt.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 112 Część 2 poz.2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych na pasku po 5szt.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 113 Część nr 2 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z żelazem stałym, pakowanych po 5 szt na pasku.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 114 Część nr 2 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG dla dzieci z żelazem ciekłym, okrągłych o średnicy 36 mm z wypustką (38mm) ułatwiającą aplikację, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia pakowanych po 5szt na pasku.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 115 Projekt umowy – par. 6 pkt.5,6**

Prosimy o odniesienie kary umownej w wysokości 10% do wartości umowy pozostałej do realizacji zamiast ogólnej wartości zamówienia o której mowa w par. 4 pkt 1.

**Odpowiedź: Zamawiający dokona odpowiednio zmiany.**

**Pytanie 116 Część 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 121 kaniul dożylnych pediatrycznych zgodnych z opisem poniżej, gdyż produkt jest niedostępny na rynku ponieważ producent zakończył produkcję?

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z PUR
- wyposażona w uchwyt zdejmowalny
- 6 linie RTG
- brak lateksu
- nie zawiera ftalanów
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkownika w opakowaniu pośrednim 50 szt.
- Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister pack

**dostępne rozmiary:**

Rozmiar Gauge	Kolor	Kaniula			
		Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)	
26	Fioletowa	0.6	19	10 ml	

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 117


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 181 zestawu położniczego jednorazowego użytku o następującym składzie:

#### Skład zestawu:

- 1 serweta Protect (opakowanie zestawu)
- 1 serweta dla noworodka
- 2 ręczniki celulozowe
- 6 kompresów włókninowych Medicomp
- 1 nożyczki chirurgiczne proste tępe tępe Peha-instrument
- 3 zaciski do pępowiny plastikowe
- 4 rękawiczki Peha-soft nitrile by pack
- 1 gruszka gumowa
- 1 x torebka papierowa

#### Rozmiar:

- 120 x 95 cm
- 87 x 90 cm
- 30 x 33 cm
- 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m<sup>2</sup>)
- 14,5 cm
- 53 mm
- L
- 60 ml
- 30 x 18,5 cm



7,5 x 7,5 cm



14,5 cm



53 mm



60 ml




L



30 x 33 cm



30 x 18,5 cm



120 x 95 cm



87 x 90 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 118

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z części 1 poz. 182 zestaw do drenażu opłucnej, gdyż produkt nie jest już dostępny na rynku, producent zakończył produkcję?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 119


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 182 zestawu do drenażu opłucnej użytku o następującym składzie:



## Zestaw do nakłucia jamy opłucnej (toracentezy) wersja z trójkierunkowym kranikiem



- Zestaw do drenażu jamy opłucnej (toracentezy) w składzie:
  - worek do drenażu z zaworem spustowym poprzecznym i skalą pomiarową, zastawką przeciwwrotną, drenem o dł. ok. 90 cm
  - kranik trójkierunkowy z oznaczeniami kierunku przepływu
  - dren przedłużający o dł. ok. 50 cm
  - strzykawka z gumowym tłokiem 60 ml
  - igła punkcyjna Veresa w trzech wersjach lub 3 igłami typu Lancet
- Produkt sterylny, jednorazowego użytku
- Tuba chroniąca ostrze igły

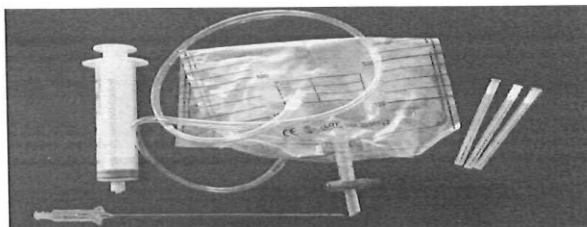

### Wersje igieł Veresa:

- A - otwarty mandryn, otwór na igłę
- B - zamknięty mandryn, 2 otwory
- C - zamknięty mandryn, 3 okienka co 120°

### Wersje igieł typu Lancet:

- 14G, 16G, 18G – dł. 50 mm (zestaw igieł)
- 14G, 16G, 18G – dł. 80 mm (zestaw igieł)
- 15G – dł. 80 mm

WERSJA IGŁY VERESA	DŁUGOŚĆ IGŁY	ŚREDNICA IGŁY			
		14 G	15 G	16 G	18 G
A	50 mm	AV01 1405 A	AV01 1505 A	AV01 1605 A	AV01 1805 A
	100 mm	AV01 1410 A	AV01 1510 A	AV01 1610 A	AV01 1810 A
	120 mm	AV01 1412 A	AV01 1512 A	AV01 1612 A	AV01 1812 A
	150 mm	AV01 1415 A	AV01 1515 A	AV01 1615 A	
B	50 mm	AV01 1405 B	AV01 1505 B	AV01 1605 B	AV01 1805 B
	100 mm	AV01 1410 B	AV01 1510 B	AV01 1610 B	AV01 1810 B
	120 mm	AV01 1412 B	AV01 1512 B	AV01 1612 B	AV01 1812 B
	150 mm	AV01 1415 B	AV01 1515 B	AV01 1615 B	
C	50 mm	AV01 1405 C	AV01 1505 C	AV01 1605 C	AV01 1805 C
	100 mm	AV01 1410 C	AV01 1510 C	AV01 1610 C	AV01 1810 C
	120 mm	AV01 1412 C	AV01 1512 C	AV01 1612 C	AV01 1812 C
	150 mm	AV01 1415 C	AV01 1515 C	AV01 1615 C	

DŁUGOŚĆ IGŁY LANCET	Pojemność worka	
	2 L	5 L
50 mm	AV01 T 50	AV01 T 505
80 mm	AV01 T 80	AV01 T 805

IGŁA LANCET	Pojemność worka
	2 L
15G, dł.80 mm	AV01 T 1580

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 120

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 190 prześcieradła z fizeliny z gumką w rozmiarze 230 x 130 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 121

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 192 serwety sterylnej w rozmiarze 50 cm x 60 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- II. Zamawiający dokona odpowiednich modyfikacji w SWZ w związku z odpowiedziami na pytania.
- III. Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
- IV. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SWZ, w tym wyznaczone sposoby, terminy składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

**DYREKTOR**  
**SP ZOZ**  
**Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego**  
**i Transportu Sanitarnego w Płocku**  
**mgr Lucyna Kęsicka**