

Gdańsk, dnia 26.08.2020 r.

D10.251.55.F.2020

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „dostawę wyposażenia medycznego i niemedycznego.”**

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Zestaw I**

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 45**

**pozycja 1 :**

Czy dopuszczają Państwo dozownik z zakresem regulacji 1-17 l/min?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**pozycja 2 :**

Czy dopuszczają Państwo regulator o wymiarach wys 156mm głębokość 140mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

Czy dopuszczają Państwo regulator z maksymalnym przepływem 80 l/min

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

Urządzenie ma być wyposażone w tuleje lub pojemnik zabezpieczający ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**


**Zestaw II**

**Pytanie 1 dot. pakietu nr 1- wózek reanimacyjny- 4 sztuki**

Prosimy o możliwość zaofiarowania wózka reanimacyjnego o poniższych parametrach:

- 4 szuflady o wysokości frontów 3 x 150 mm, 1 x 225 mm
- 1 x półka pod defibrylator o wym. 320 x 400 mm, z regulacją obrotu, bez regulacji wysokości
- 1 x odcinek szyny instrumentalnej
- 1 x pojemnik z pokrywą otwieraną kolanem
- 3 x uchylna, tworzywowa kuweta z boku wózka przeznaczona na akcesoria
- 1 x blat boczny wysuwany
- 1 x pojemnik na odpady z pokrywą otwieraną kolanem
- blat z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 75 mm

- szafka stalowa lakierowana proszkowo, prowadnice szuflad z samodociągiem
- podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokadą
- uchwyt do pojemnika na zużyte igły oraz pojemnik na narzędzia ze stali nierdzewnej
- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 720 x 610 x 1080 mm
- wymiary szafki 650 x 550 x 1000 mm (wysokość do blatu, z kołami)
- kolor uchwytów szuflad do wyboru przez Zamawiającego (6 kolorów do wyboru: pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony, jasno niebieski, niebieski)?

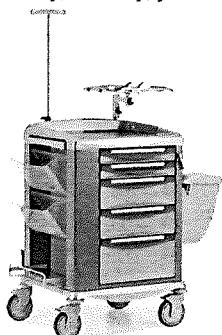

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 2 dot. pakietu nr 2- wózek anestezyjologiczny – 2 sztuki**

Prosimy o możliwość zaoferowania wózka anestezyjologicznego o poniższych parametrach:

- 4 szuflady o wysokości frontów 3 x 150 mm, 1 x 225 mm
- 1 x blat boczny wysuwany z tworzywa sztucznego
- 1 x odcinek szyny instrumentalnej
- 1 x pojemnik z pokrywą otwieraną kolanem
- 3 x uchylna, tworzywowa kuweta z boku wózka przeznaczona na akcesoria
- 1 x zamek centralny
- 1 x uchwyt do prowadzenia
- blat z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 75 mm
- szafka stalowa lakierowana proszkowo, prowadnice szuflad z samodociągiem
- podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokadą
- uchwyt do pojemnika na zużyte igły oraz pojemnik na narzędzia ze stali nierdzewnej
- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 720 x 610 x 1080 mm
- wymiary szafki 650 x 550 x 1000 mm (wysokość do blatu, z kołami)
- kolor uchwytów szuflad do wyboru przez Zamawiającego (6 kolorów do wyboru: pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony, jasno niebieski, niebieski)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

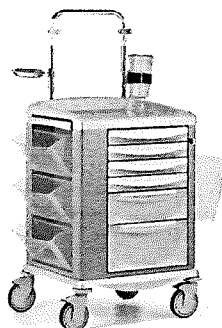

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

### **Pytanie 3 dot. pakietu nr 13, poz. 1 – wózek transportowy- 1 sztuka**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści materac nie wyposażony w wysuwane wkładki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek nie posiadający wskaźników kąta nachylenia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek bez podziałki wzdłuż leża?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 778 x 2143 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści wymiary leża 650 x 1900 mm?


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści regulację wysokości 600 – 920 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści regulację przechyłów wzdłużnych +/- 20°?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

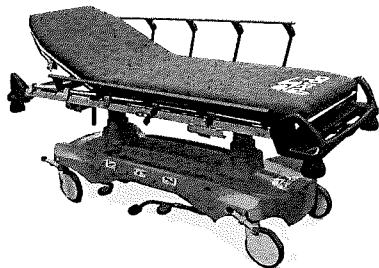

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

**Pytanie 4 dot. pakietu nr 13, poz. 2- wózek transportowy- 2 sztuki**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści barierki boczne składane wykonane ze stali nierdzewnej oraz estetycznego tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści podwozie wózka wyposażone w uchwyt na butlę z tlenem oraz wyprofilowane miejsce na ramię pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści tworzywowe, zabudowane koła jezdne o średnicy 200 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści stalowe, lakierowane proszkowo poręczne uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy i nóg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści wymiary całkowite 2143 x 778 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści wymiary leża 1900 x 650 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści regulację wysokości 600 – 920 mm?


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści regulację Trendelenburga i anty-Trendelenburga +/- 20°?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści regulację segmentu pleców 0° - 90°?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

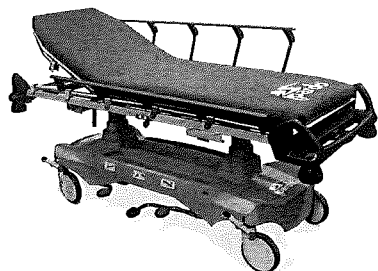


(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

**Pytanie 5 dot. pakietu nr 16, poz. 1- wózek zabiegowy- 2 sztuki**

Prosimy o możliwość zaoferowania wózka zabiegowego o poniższych parametrach:

- stelaż / konstrukcja wózka stalowa, lakierowana proszkowo
- wyposażenie wózka zamocowane bezpośrednio do korpusu lub nad blatem roboczym wózka w sposób umożliwiający swobodne korzystanie przez personel
- korpus wózka z prawej strony oraz z tyłu posiadający nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego
- 1 x blat z ABS, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 75 mm
- prowadnice szuflad z samodociągami
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokadą
- blat górny (roboczy) posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do prowadzenia
- szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 225 mm)
- 2 x półka nadblatowa o wym. ok. 520 x 115 mm
- 1 x odcinek szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami (zaokrąglonymi)
- 1 x pojemnik do worka na odpady z pokrywą otwieraną kolanem
- 1 x stelaż nadstawki
- 1 x pojemnik na zużyte igły
- 1 x uchwyt do prowadzenia
- wysokość wózka z nadstawką ok. 1650 mm
- wymiary szafki 650 x 550 x 1000 mm (wysokość do blatu, z kołami)
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady 390 x 450 x 200 mm
- wymiary powierzchni użytkowej blatu 570 x 470 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

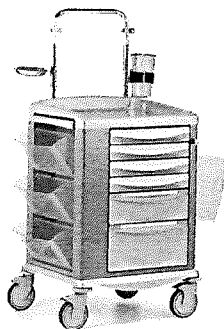


(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

## **Pytanie 6 dot. pakietu nr 16, poz. 2- wózek zabiegowy- 4 sztuki**

Prosimy o możliwość zaoferowania wózka zabiegowego o poniższych parametrach:

- szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 225 mm)
- 1 x odcinek szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami (zaokrąglonymi)
- 1 x wieszak kroplówki z regulacją wysokości
- 1 x pojemnik na zużyte igły
- 1 x pojemnik na cewniki, wym. ok. 150 x 615 x 80 mm
- 1 x pojemnik do worka na odpady z pokrywą otwieraną kolaniem
- 1 x listwa zasilająca
- 1 x uchwyt do prowadzenia
- stelaż / konstrukcja wózka stalowa, lakierowana proszkowo
- wyposażenie wózka zamocowane bezpośrednio do korpusu lub nad blatem roboczym wózka w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z wózka przez personel
- korpus wózka z prawej strony oraz z tyłu posiadający nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego
- blat z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 75 mm
- szafka stalowa lakierowana proszkowo
- prowadnice szuflad z samodociągiem
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokadą
- wymiary całkowite 720 x 610 x 1000 mm – wysokość od podłoża do blatu
- wymiary szafki 650 x 550 x 1000 mm (wysokość do blatu, z kołami)
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady 390 x 450 x 200 mm
- wymiary blatu: 640 x 545 mm
- wymiary powierzchni użytkowej blatu 570 x 470 mm
- kolor uchwytów szuflad do wyboru przez Zamawiającego (6 kolorów do wyboru: pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony, jasno niebieski, niebieski)?

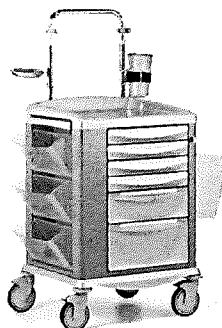

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **Pytanie 7 dot. pakietu nr 25- wózek zabiegowy- 1 sztuka**

Prosimy o możliwość zaoferowania wózka o poniższych parametrach:

- szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 3 x 225 mm)
- 1 x blat roboczy z tworzywa sztucznego wysuwany z boku wózka
- nadstawka z dwoma rzędami uchylnych pojemników (5+5)
- 1 x odcinek szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami (zaokrąglonymi)
- 1 x pojemnik na odpady
- 1 x stelaż nadstawki
- 1 x pojemnik na zużyte igły
- 1 x uchwyt do prowadzenia
- 1 x uchwyt na pudełko rękawiczek
- 3 x uchylna, tworzywowa kuweta z boku wózka na akcesoria
- stelaż / konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo

- wyposażenie wózka zamocowane bezpośrednio do korpusu lub nad blatem roboczym wózka w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z wózka przez personel
- blat z ABS, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 75 mm
- szafka stalowa lakierowana proszkowo, prowadnice szuflad z samodociąganiem
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokadą
- wymiary wózka bez wyposażenia 720 x 610 x 1000 mm
- wysokość wózka z nadstawką ok. 1650 mm
- wymiary szafki 650 x 550 x 1000 mm (wysokość do blatu, z kołami)
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady 390 x 450 x 200 mm
- wymiary blatu 640 x 545 mm
- wymiary powierzchni użytkowej blatu 570 x 470 mm
- kolor uchwytów szuflad do wyboru przez Zamawiającego (6 kolorów do wyboru: pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony, jasno niebieski, niebieski)?

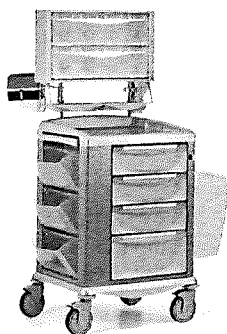


(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8 dot. pakietu 28- wózek opatrunkowy- 2 sztuki**

Prosimy o możliwość zaoferowania wózka opatrunkowego o poniższych parametrach:

- 3 x szuflady samoczynnie domykane
- blat roboczy wykonany z tworzywa ABS
- wózek wyposażony w zamek centralny
- dodatkowy, wysuwany na prowadnicach blat roboczy (z boku wózka)
- 4 x koła przeciwpływowe
- 3 x uchylna, tworzywowa uniwersalna kuweta z boku wózka
- 1 x pojemnik zamykany na odpady
- 1 x uchwyt na pudełko rękawiczek
- kolor uchwytów szuflad do wyboru przez Zamawiającego (6 kolorów do wyboru: pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony, jasno niebieski, niebieski)?
- szerokość 720 mm
- głębokość 610 mm
- wysokość z kołami 1080 mm?

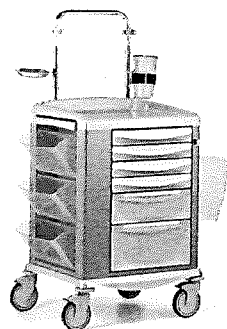

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Zestaw III

**Pytanie 1 dot. pakietu nr 40**

Czy w Pakiecie nr 40 Zamawiający dopuści fotel operatora o parametrach jak poniżej:

- Fotel operatora przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki z elektryczną regulacją wysokości siedziska góra/dół
- Podstawa jezdna, łatwo zmywalna, na trzech kołach z przyciskami sterowania ruchem góra/dół wmontowanymi w podstawę
- Podstawa jezdna wyposażona w centralną blokadę jezdną
- Siedzisko profilowane z regulacją góra/dół w zakresie min. 530-680 mm
- Podparcie pleców operatora z dosuwaniem w kierunku odcinka lędźwiowego w zakresie min.50mm
- Regulacja kąta nachylenia podparcia pleców w zakresie +/-15°
- Regulacja podparcia pleców operatora w zakresie góra/dół min.50mm
- Podłokietniki regulowane mechanicznie w zakresie góra/dół co najmniej 100mm i możliwością obrotu w osi 360°
- Możliwość wykonania tapicerki fotela w co najmniej 4 kolorach

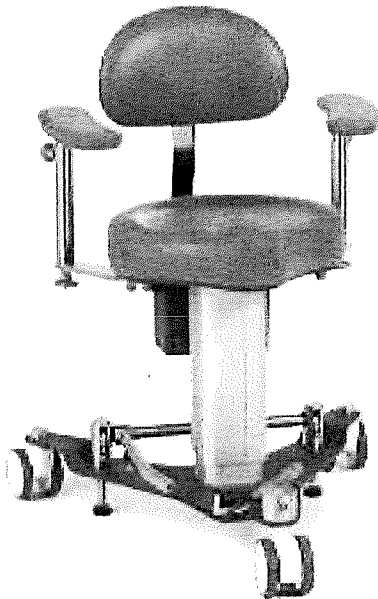

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2 dot. pakietu nr 47**

Czy w Pakiecie nr 47 Zamawiający dopuści taborety z pneumatyczną regulacją wysokości, z chromowaną podstawą jezdnią z 5-cio ma kółkami, średn. podstawy 500mm, śr. Siedziska 329mm, min. Wys. Siedziska 450mm - 650mm, max. Wys. Siedziska 560mm - 810mm, bez możliwości montowania wyposażenia dodatkowego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zestaw IV

**Pytanie 1 dot. pakietu nr 40**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fotela operatora o poniższych parametrach:

|     |   |
|-----|---|
| 1.  | Fotel przeznaczony do operacji okulistycznych                 |
| 2.  | Komfortowe siedzisko o grubości 80 mm                         |
| 3.  | Regulacja pochyleń siedziska: 12°                             |
| 4.  | Regulacja siedziska przód-tył: 150 mm                         |
| 5.  | Regulacja kąta oparcia  |
| 6.  | Regulacja wysokości (140-290 mm) i wysunięcia podłokietników  |
| 7.  | Podłokietniki multiużytkowe                                   |
| 8.  | Regulacja wysokości: nożna, elektryczna w zakresie 550-710 mm |
| 9.  | Blokada kół: nożna  |
| 10. | Koła jedno o średnicy 75 mm                                   |
| 11. | Sterowanie fotelem przy użyciu przełączników nożnych          |
| 12. | Maksymalna waga operatora: 250 kg                             |
| 13. | Zasilanie bateryjne   |
| 14. | Wymiary siedziska: 420 x420 mm                                |
| 15. | Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego           |
| 16. | Gwarancja 12 miesięcy   |
| 17. | Produkt fabrycznie nowy                                       |

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zestaw V

**Pytanie 1 dot. pakietu nr 1- Wózek reanimacyjny - 4szt. Pkt. 1.**



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w 4 szuflady o wysokości:

- 3 górne szuflady o wysokości frontów: 110mm,
- 1 dolna szuflada o wysokości frontu: 230mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie ze zmienioną SIWZ.**

**Pytanie 2 dot. pakietu nr 1 -Wózek reanimacyjny - 4szt. Pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w 5 szuflad o wysokości:

- 4 górne szuflady o wysokości frontów: 110mm,
- 1 dolna szuflada o wysokości frontu: 230mm,

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3 dot. pakietu nr 1- Wózek reanimacyjny - 4szt. Pkt. 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w półkę pod defibrylator o wymiarach: długość: 280mm, szerokość: 360mm, obrotowa o 360°, zaopatrzoną w pasy zabezpieczające sprzęt znajdujący się na niej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 dot. pakietu nr 1- Wózek reanimacyjny - 4szt. Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, posiadający dwa tworzywowe kosze z klapkami na odpady mocowane do szyny z boku wózka, zamiast kosza w koszyku drucianym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 dot. pakietu nr 1- Wózek reanimacyjny - 4szt. Pkt. 8.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej w celu ograniczenia namnażania się bakterii, po bokach i z tyłu zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6 dot. pakietu nr 1- Wózek reanimacyjny - 4szt. Pkt. 9.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego szafka wykonana jest z nierdzewnego kompozytu aluminium w kolorze szarym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 7 dot. pakietu nr 1- Wózek reanimacyjny - 4szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego podstawa wykonana jest z solidnego, grubego tworzywa, z wyprofilowanymi nad każdym z kół odbojami zabezpieczającymi wózek przed obciami?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8 dot. pakietu nr 1- Wózek reanimacyjny - 4szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w 4 podwójne, cichobieżne, niebrudzące posadzek koła o średnicy 100mm, w tym dwa z blokadą jazdy, a jedno z funkcją jazdy kierunkowej, rozmieszczone na planie prostokąta dla lepszej stabilności wózka?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9 dot. pakietu nr 1- Wózek reanimacyjny - 4szt. Pkt. 11.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, bez uchwytu na pojemnik z narzędziami ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 10 Dot. pakietu nr 1- Wózek reanimacyjny - 4szt. Pkt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, o wymiarach (bez wyposażenia):

- szerokość: 650mm,
- głębokość: 475mm,

- wysokość do blatu górnego: 965mm,

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 11 dot. pakietu nr 1- Wózek reanimacyjny - 4szt. Pkt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, o wymiarach (bez wyposażenia):

- szerokość: 650mm,

- głębokość: 475mm,

- wysokość do blatu górnego: 850mm,

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 12 dot. pakietu nr 1- Wózek reanimacyjny - 4szt. Pkt. 13.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego szafka ma wymiary:

- szerokość: 620mm,

- głębokość: 450mm,

- wysokość: 830mm,

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 13 dot. pakietu nr 1- Wózek reanimacyjny - 4szt. Pkt. 13.**




Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego szafka ma wymiary:

- szerokość: 620mm,


- głębokość: 450mm,

- wysokość: 720mm,

*Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:*

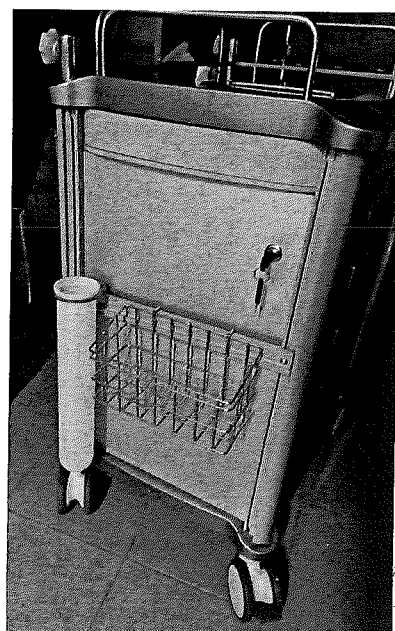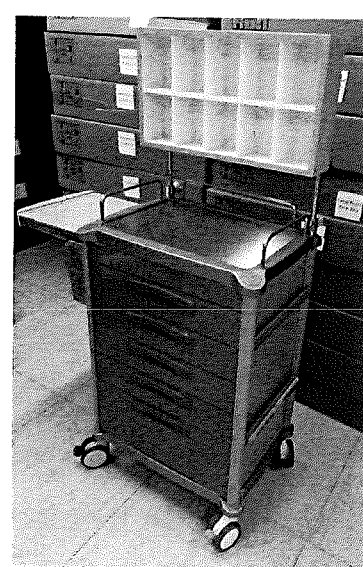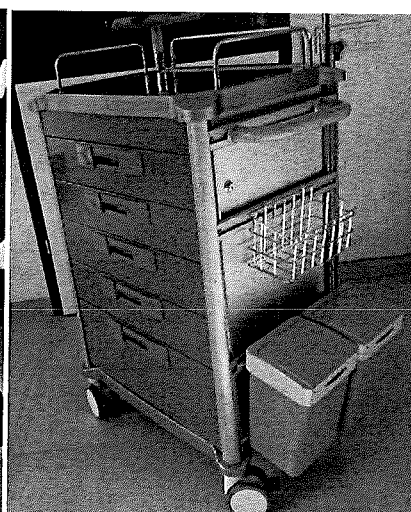

Sp. z o.o.  
Gdańsk  
80-000

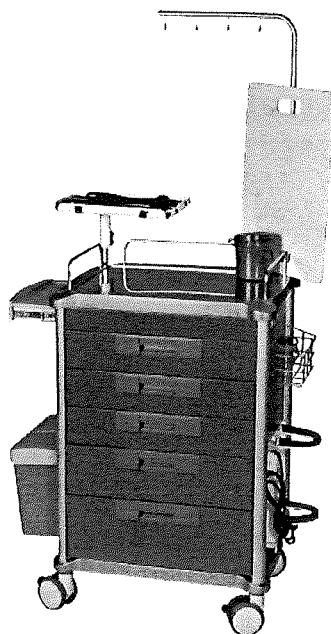

58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

www.copernicus.gda.pl  
sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl  
ul. 22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
kapitał zakładowy 271 848 000,00 PLN wpłacony w całości  
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 14 dot. pakietu nr 2- Wózek anesteziologiczny - 2szt. Pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anesteziologiczny, wyposażony w 4 szuflady o wysokości:

- 3 górne szuflady o wysokości frontów: 110mm,
- 1 dolna szuflada o wysokości frontu: 230mm,

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 15 dot. pakietu nr 2- Wózek anesteziologiczny - 2szt. Pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anesteziologiczny, wyposażony w 5 szuflad o wysokości:

- 4 górne szuflady o wysokości frontów: 110mm,
- 1 dolna szuflada o wysokości frontu: 230mm,

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 16 dot. pakietu nr 2- Wózek anesteziologiczny - 2szt. Pkt. 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anesteziologiczny, wyposażony w wysuwany blat boczny wykonany z tworzywa ABS?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 17 dot. pakietu nr 2- Wózek anesteziologiczny - 2szt. Pkt. 8.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anesteziologiczny, którego górny blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej w celu ograniczenia namnażania się bakterii, po bokach i z tyłu zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów podczas przetaczania?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 18 dot. pakietu nr 2- Wózek anesteziologiczny - 2szt. Pkt. 9.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anesteziologiczny, którego szafka wykonana jest z nierdzewnego kompozytu aluminium w kolorze szarym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19 dot. pakietu nr 2- Wózek anesteziologiczny - 2szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anesteziologiczny, którego podstawa wykonana jest z solidnego, grubego tworzywa, z wyprofilowanymi nad każdym z kół odbojami zabezpieczającymi wózek przed obciami?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie ze zmienioną SIWZ.**

**Pytanie 20 dot. pakietu nr 2- Wózek anesteziologiczny - 2szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anesteziologiczny, wyposażony w 4 podwójne, cichobieżna, niebrudzące posadzek koła o średnicy 100mm, w tym dwa z blokadą jazdy, a jedno z funkcją jazdy kierunkowej, rozmieszczone na planie prostokąta dla lepszej stabilności wózka?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie ze zmienioną SIWZ.**

**Pytanie 21 dot. pakietu nr 2- Wózek anesteziologiczny - 2szt. Pkt. 11.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anesteziologiczny wyposażony w uchwyt na pojemnik zużytych igieł, bez uchwytu na nierdzewny pojemnik z narzędziami ze stali kwasoodpornej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 22 dot. pakietu nr 2- Wózek anesteziologiczny - 2szt. Pkt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anesteziologiczny, o wymiarach (bez wyposażenia):

- szerokość: 650mm,
- głębokość: 475mm,
- wysokość do blatu górnego: 965mm,

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 23 dot. pakietu nr 2- Wózek anesteziologiczny - 2szt. Pkt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anesteziologiczny, o wymiarach (bez wyposażenia):

- szerokość: 650mm,
- głębokość: 475mm,
- wysokość do blatu górnego: 850mm,

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 24 dot. pakietu nr 2- Wózek anesteziologiczny - 2szt. Pkt. 13.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anesteziologiczny, którego szafka ma wymiary:

- szerokość: 620mm,
- głębokość: 450mm,
- wysokość: 830mm,

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 25 dot. pakietu nr 2- Wózek anesteziologiczny - 2szt. Pkt. 13.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anesteziologiczny, którego szafka ma wymiary:

- szerokość: 620mm,
- głębokość: 450mm,
- wysokość: 720mm,

***Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:***



**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 26 dot. pakietu nr 11- Szafa dwudrzwiowa - 2szt. Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafę dwudrzwiową o wymiarach:

- szerokość: 900mm,

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk  
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100  
Sekretariat Biura Zarządu:  
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

www.copernicus.gda.pl  
sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl  
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
Kapitał zakładowy 271 848 000,00 PLN wpłacony w całości  
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064

- głębokość: 420mm,
- wysokość: 1800mm,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie ze zmienioną SIWZ.**

***Poniżej zdjęcie poglądowe szafy, którą chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:***



**Pytanie 27 dot. pakietu nr 21- Wózek do przewożenia zwłok - 1szt. Pkt. 3.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu zwłok, którego wysokość regulowana jest za pomocą mechanizmu śrubowego w zakresie: 500-850mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie ze zmienion SIWZ.**


**Pytanie 28 dot. pakietu nr 21- Wózek do przewożenia zwłok - 1szt. Pkt. 5.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu zwłok, o wymiarach:

- długość całkowita: 2200mm,
- szerokość całkowita: 700mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie ze zmienioną SIWZ.**

***Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:***

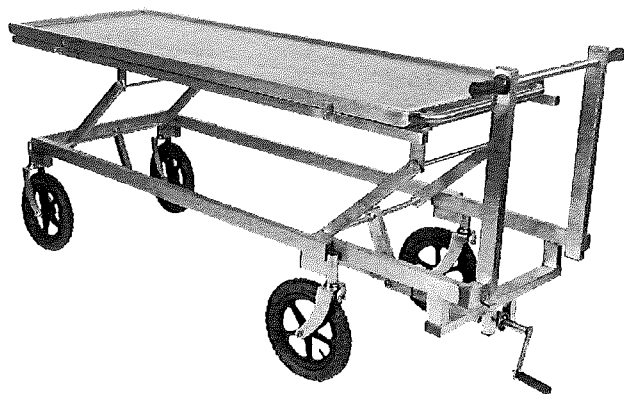

**Pytanie 29 dot. pakietu nr 28- Wózek opatrunkowy - 2szt. Pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy wyposażony w 4 szuflady?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Pytanie 30 dot. pakietu nr 28- Wózek opatrunkowy - 2szt. Pkt. 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, którego blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej, w celu ograniczenia namnażania się bakterii?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Pytanie 31 dot. pakietu nr 28- Wózek opatrunkowy - 2szt. Pkt. 4.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, wyposażony w manualnie wysuwany blat boczny z boku wózka?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 32 dot. pakietu nr 28- Wózek opatrunkowy - 2szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, o szerokości: 650mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 33 dot. pakietu nr 28- Wózek opatrunkowy - 2szt. Pkt. 11.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, o głębokości: 475mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie 34 dot. pakietu nr 28- Wózek opatrunkowy - 2szt. Pkt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, o wysokości: 930mm?

*Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaferować w postępowaniu:*



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 35 dot. pakietu nr 33- Wózek wielofunkcyjny - 1szt. Pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego konstrukcja opiera się na aluminiowych kolumnach nośnych, ściany boczne i tylnia wózka wykonane są z nierdzewnego kompozytu aluminium, fronty szuflad są aluminiowe – lakierowane proszkowo, natomiast blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w celu ograniczenia namnażania się bakterii?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 36 dot. pakietu nr 33- Wózek wielofunkcyjny - 1szt. Pkt. 4.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny wyposażony w 4 szuflady?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 37 dot. pakietu nr 33- Wózek wielofunkcyjny - 1szt. Pkt. 6.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego długość wynosi: 650mm?

***Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:***



**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 38 dot. pakietu nr 36- Stolik zabiegowy mobilny - 6szt. Pkt. 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stolik zabiegowy, którego stelaż wykonany jest ze stali nierdzewnej, w związku z czym nie jest lakierowany proszkowo, co pogorszyłoby właściwości stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 39 dot. pakietu nr 36- Stolik zabiegowy mobilny - 6szt. Pkt. 4.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stolik zabiegowy, wyposażony w 4 koła obrotowe, o średnicy 100mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 40 dot. pakietu nr 36- Stolik zabiegowy mobilny - 6szt. Pkt. 6.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości stolik zabiegowy, o wysokości: 970mm?

***Poniżej zdjęcie poglądowe stolika, który chcielibyśmy zaferować w postępowaniu:***



**Odpowiedź:**  
**możliwości.**

**Zamawiający nie dopuszcza takiej**

**Zestaw VI**

**Pytanie 1 dot. Pakietu nr 13**

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 2 dot. Pakietu nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje (podział pakiet na dwa odrębne pakiety)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 3 dot. Pakietu nr 13**

Czy Zamawiający dopuści wózek (poz. 2) o długości leża 200 cm oraz długości prowadnicy na kasetę RTG o długości 112 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 4 dot. Pakietu nr 13**

Czy Zamawiający dopuści wózek (poz. 2) z barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 5 dot. Pakietu nr 13**

Czy Zamawiający dopuści wózek (poz. 2) z miejscem na butlę z tlenem oraz podręczne rzeczy pacjenta w tworzywowej obudowie podwozia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 6 dot. Pakietu nr 13**

Czy Zamawiający dopuści wózek (poz. 2) o długości całkowitej 2185 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**



**Pytanie 7 dot. Pakietu nr 13**

Czy Zmawiający dopuści wózek (poz. 2) o szerokości całkowitej 870 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 8 dot. Pakietu nr 13**

Czy Zmawiający dopuści wózek (poz. 2) z leżem o wymiarach 200 x 70 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 9 dot. Pakietu nr 13**

Czy Zmawiający dopuści wózek (poz. 2) z regulacją wysokości leża w zakresie 47-79 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 10 dot. Pakietu nr 13**

Czy Zmawiający dopuści wózek (poz. 2) z Trendelburgiem 12° i anty-Trendelenburgiem 12°?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 11 dot. Pakietu nr 13**

Czy Zmawiający dopuści wózek (poz. 2) z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70°?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 12 dot. Pakietu nr 12**

Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami nieantystatycznymi?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 13 dot. Pakietu nr 12**

Czy Zmawiający dopuści szafkę przyłóżkową z 4 kołami (z czego dwa koła z blokadą) oraz piątym kołem pod białem bocznym (bez blokady)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

## Zestaw VII

**Pytanie 1 dot. pakietu nr 12- Szafki przyłóżkowe – 19 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadająca blat boczny z możliwością regulacji w zakresie 740 – 1120 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z aktualną SIWZ.**

**Pytanie 2 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia pacjentów – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów którego konstrukcja jest wykonana ze stali węglowej malowanej proszkowo?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia pacjentów – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów, który posiada materac bez wysuwanych wkładek?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia pacjentów – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów bez wskaźnika kąta nachylenia leża?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia pacjentów – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów, który nie posiada podziałki wzdłuż leża?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia pacjentów – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów o wymiarach zewnętrznych 2130 x 800 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia pacjentów – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, który posiada leże o wymiarach 1920 x 630 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia pacjentów – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów posiadający regulację wysokości w zakresie 565 – 895 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia pacjentów – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów posiadający regulację przechyłów wzdłużnych : Trendelenburg - 17°, anty- Trendelenburg - 16°?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia chorych – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z barierkami wykonanymi ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 11 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia chorych – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający tworzywowe zabudowane koła o średnicy 200 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 12 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia chorych – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów o wymiarach całkowitych 2090 x 790 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 13 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia chorych – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów o wymiarach leża 1920 x 650 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 14 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia chorych – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów posiadający regulację wysokości w zakresie 570 – 910 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 15 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia chorych – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów wyposażony w uchwyty od strony głowy i nóg pacjenta wykonane ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 16 dot. pakietu nr 13- Wózek do przewożenia chorych – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów posiadający regulację przechyłów wzdłużnych: Trendelenburg - 20°, anty- Trendelenburg - 12°?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 17 dot. pakietu nr 32- Stół do badań – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 570 – 910 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18 dot. pakietu nr 32- Stół do badań – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań z dopuszczalnym obciążeniem 180 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19 dot. pakietu nr 32- Stół do badań – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań o wymiarach zewnętrznych 1920 x 650 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20 dot. pakietu nr 32- Stół do badań – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań , którego podstawa wyposażona jest w kółka o średnicy 150 mm, z indywidualną blokadą kół?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21 dot. pakietu nr 32- Stół do badań – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań , którego podstawa wyposażona jest w kółka o średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## Zestaw VIII

**Pytanie 1 dot. pakietu nr 13, poz.2 -Wózek transportowy-2 szt.**

Dotyczy-(pkt. 1 zestawienia parametrów technicznych)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjenta o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo na kolor biały?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 dot. pakietu nr 13, poz.2 -Wózek transportowy-2 szt.**

Dotyczy-(pkt. 14 zestawienia parametrów technicznych)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek długości całkowitej: 2070 mm oraz szerokości całkowitej wynoszącej 800 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 dot. pakietu nr 13, poz.2 -Wózek transportowy-2 szt.**

Dotyczy-(pkt.15 zestawienia parametrów technicznych)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o wymiarach leża wynoszących 1850 x 590 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 dot. pakietu nr 13, poz.2 -Wózek transportowy-2 szt.**

Dotyczy-(pkt. 16 zestawienia parametrów technicznych)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta z hydrauliczną regulacją wysokości leża za pomocą obustronnej dźwigni nożnej w zakresie od 560-960 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 dot. pakietu nr 17- Kozetka lekarska na kółkach-12 szt.**

Dotyczy-(zestawienia parametrów technicznych)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o długości całkowitej 1850 mm, dopuszczalnym obciążeniem wynoszącym 200 kg z zachowanie pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6 dot. pakietu nr 30- Kozetka- 2 szt.**

Dotyczy-(zestawienia parametrów technicznych)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o długości całkowitej 1850 mm, regulacja kąta nachylenia podglówka w zakresie -15 do +45°, z zachowanie pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7 dot. pakietu nr 13, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej (zewnętrznej) 2050mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8 dot. pakietu nr 24**

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z leżem o długości 2050mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9 dot. pakietu nr 24**

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z regulacją wysokości leża w zakresie 460-940mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10 dot. pakietu nr 24**

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z regulacją segmentu pleców w zakresie od -27° do +50°?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11 dot. pakietu nr 24**

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o szerokości 750mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## Zestaw IX

**Pytanie 1 dot. Zał. nr 6 - Projekt umowy (dostawy jednorazowe), dot. §3 ust2 oraz §6 ust8**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętów w zakresie pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 25, 26, 30, 35, 38, 44, 47 ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu w ww. pakietach.**

**Pytanie 2 dot. zał. nr 6- Projekt umowy, dot. §6 ust14**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu.**

## Zestaw X

**Pytanie 1 dot. pakietu nr 17: Kozetka lekarska na kółkach – 12szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kozetkę lekarską na kółkach o długości 1970mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 2 dot. pakietu nr 17: Kozetka lekarska na kółkach – 12szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kozetkę lekarską na kółkach o szerokości 600mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 3 dot. pakietu nr 24: Stół rehabilitacyjny – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół rehabilitacyjny o długości 1950mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 4 dot. pakietu nr 24: Stół rehabilitacyjny – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 550-900mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 5 dot. pakietu nr 24: Stół rehabilitacyjny – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół rehabilitacyjny z regulacją segmentu pleców w zakresie -20<sup>0</sup>/+70<sup>0</sup>? Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 6 dot. pakietu nr 31: Kozetka elektryczna – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kozetkę elektryczną z regulacją wysokości realizowaną silnikiem elektrycznym za pomocą przewodowego sterownika nożnego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7 dot. pakietu nr 31: Kozetka elektryczna – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kozetkę elektryczną z regulacją wysokości w zakresie 550-900mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 8 dot. pakietu nr 32: Stół do badań – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół do badań z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 550-900mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 9 dot. pakietu nr 32: Stół do badań – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół do badań o długości 1900mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 10 dot. pakietu nr 32: Stół do badań – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół do badań z podstawą wyposażoną w koła o średnicy 80mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 11 dot. pakietu nr 39: Fotel laryngologiczno - okulistyczny – 3szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel laryngologiczno – okulistyczny wykonany ze stali malowanej proszkowo osadzony na stabilnej płaskiej podstawie o średnicy 550mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 12 dot. pakietu nr 39: Fotel laryngologiczno - okulistyczny – 3szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel laryngologiczno – okulistyczny z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców oraz regulacją wysokości podglówka?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13 dot. pakietu nr 39: Fotel laryngologiczno - okulistyczny – 3szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel laryngologiczno – okulistyczny o szerokości powierzchni siedzącej 480mm oraz szerokości zewnętrznej 600mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 14 dot. pakietu nr 39: Fotel laryngologiczno - okulistyczny – 3szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel laryngologiczno – okulistyczny o wysokości fotela 1200-1500mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 15 dot. pakietu nr 39: Fotel laryngologiczno - okulistyczny – 3szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel laryngologiczno – okulistyczny z regulacją wysokości siedziska w zakresie 540-680mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 16 dot. pakietu nr 43: Stół opatrunkowy elektryczny – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół opatrunkowy elektryczny z regulacją wysokości realizowaną silnikiem elektrycznym za pomocą przewodowego sterownika nożnego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17 dot. pakietu nr 43: Stół opatrunkowy elektryczny – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół opatrunkowy elektryczny o długości 1950mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 18 dot. pakietu nr 43: Stół opatrunkowy elektryczny – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół opatrunkowy elektryczny o szerokości 700mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 19 dot. pakietu nr 43: Stół opatrunkowy elektryczny – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół opatrunkowy elektryczny z regulacją wysokości w zakresie 550-900mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 20 dot. pakietu nr 43: Stół opatrunkowy elektryczny – 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół opatrunkowy elektryczny z regulacją kąta podglówka w zakresie -20°/+70°?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Zestaw X a**

**Pytanie 1 dot. pakietu nr 23 -Balkonik rehabilitacyjny**

Czy Zamawiający dopuści balkonik 2 - kołowy nie posiadający hamulców



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

## Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści balkonik 4 - kołowy spełniający pozostałe wymagania SIWZ



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Zestaw XI

### Pytanie 1 dot. pakietu nr 18- Wymagania zamawiającego do poz. 1, Pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie systemu grzewczego wyposażonego w alarmy: wysokiej temperatury, alarm maty, alarm odchylenia temperatury, alarm zasilania, alarm niedogrzanania, oraz wyłącznik ciepła w systemie, jako dodatkowe zabezpieczenie, wyłączający funkcję ogrzewania systemu, gdy temperatura maty osiągnie 42 °C - 43 °C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### Pytanie 2 dot. pakietu nr 18- Wymagania zamawiającego do poz. 1, Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej o mocy 350W.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### Pytanie 3 dot. pakietu nr 18- Wymagania zamawiającego do poz. 2, Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie materaca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### Pytanie 3 dot. pakietu nr 18- Wymagania zamawiającego do poz. 2, Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie długości przewodu 3,0 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### Pytanie 3 dot. pakietu nr 18- Wymagania zamawiającego do poz. 2, Pkt. 8,9

Prosimy o dopuszczenie powłoki zewnętrznej materaca szczelnie zamkniętej, ze zgrzewanymi szwami.  
 W komplecie znajduje się dodatkowy pokrowiec zewnętrzny również wykonany z poliuretanu, przeznaczony do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp. 90°C  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## Zestaw XII

**Pytanie 1 dot. pakietu nr 12- safki trzyłóżkowe**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, które posiadają wymiary blatu 450 x 490 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodne z SIWZ.**

**Pytanie 2 dot. pakietu nr 12- safki trzyłóżkowe**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, które posiadają blat boczny o rozmiarze 590 x 340 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 3 dot. pakietu nr 12- safki trzyłóżkowe**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, które posiadają szerokość 490 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 4 dot. pakietu nr 12- safki trzyłóżkowe**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, które posiadają wysokość 880 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 5 dot. pakietu nr 12- safki trzyłóżkowe**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, które posiadają bezstopniowy zakres regulacji blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700 do 1050 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 6 dot. pakietu nr 12- safki trzyłóżkowe**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, które konstrukcję posiadają z blachy nieocynkowanej malowanej proszkowo oraz, która drzwiczki szafki i czolo szuflady posiada z płyty HPL a nie z blachy malowanej proszkowo?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

## Zestaw XIII

**Pytanie 1 dot. załącznika nr 1, pakiet nr 5 (formularz asortymentowo-cenowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 stelaży o parametrach jak w poniższej tabeli? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i równoważne do wymaganego w SIWZ.

|  |   |
|--|---|
| 1  | Stelaż potrójny na odpady lub brudną bieliznę                                   |
| 2  | Stelaż podwójny na odpady lub brudną bieliznę                                   |
| 3  | Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę                                 |
| <b>Ogólne wymagania zamawiającego do poz. 1, 2 i 3</b> |   |
| 1  | pojemność worka 100-120l  |
| 2  | ze stali kwasoodpornej  |
| 3  | obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunieniem się worka |



|    |   |
|----|---|
| 4  | pokrywa ze spawalniczym cichego opadania  |
| 5  | pokrywa podnoszona pedałem; w przypadku stelaży podwójnych i potrójnych każda pokrywa podnoszona oddzielnie               |
| 6  | wyposażony w koła w obudowie z <b>wysokiej jakości tworzywa sztucznego</b> o średnicy 50mm (+/- 5mm), w tym dwa z blokadą |
| 7  | wymiary całkowite: <b>1300x510x910mm</b> [szerxgłxwys] - dotyczy tylko pozycji 1  |
| 8  | wymiary całkowite: <b>860x510x910mm</b> [szerxgłxwys] - dotyczy tylko pozycji 2   |
| 9  | wymiary całkowite: <b>415x510x910mm</b> [szerxgłxwys] - dotyczy tylko pozycji 3   |
| 10 | gwarancja min. 12 miesięcy  |
| 11 | produkt fabrycznie nowy   |

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2 dot. załącznika nr 1, pakiet nr 7 (formularz asortymentowo-cenowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 stolików instrumentalnych o parametrach jak w poniższej tabeli? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i równoważne do wymaganego w SIWZ.

|  |   |
|--|---|
| 1  | <b>Stolik instrumentalny</b>  |
| 2  | <b>Stolik instrumentalny</b>  |
| <b>Wymagania zamawiającego do poz. 1</b> |   |
| 1  | w całości ze stali kwasoodpornej  |
| 2  | 1x blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360° z blokadą obrotu, podnoszony hydraulicznie za pomocą pedała nożnego, regulacja w zakresie: <b>960-1370mm</b> |
| 3  | podstawa na 3 kołach w obudowie z tworzywa sztucznego, pojedynczych o średnicy <b>80mm</b> , wszystkie z hamulcem   |
| 4  | wymiary całkowite: 740x490x960-1370mm [szerxgłxwys]   |
| 5  | wymiary blatu: 740x490mm  |
| 6  | wymiary powierzchni użytkowej blatu <b>680x430mm</b>  |
| 7  | gwarancja min. 12 miesięcy  |
| 8  | produkt fabrycznie nowy   |
| <b>Wymagania zamawiającego do poz. 2</b> |   |
| 1  | w całości ze stali kwasoodpornej  |
| 2  | 1x blat z pogłębieniem, podnoszony ręcznie za pomocą korby, regulacja w zakresie: <b>1000/1400 mm</b>   |
| 3  | podstawa na 4 kołach w obudowie w <b>wysokiej jakości tworzywa sztucznego</b> o średnicy <b>80mm</b> , w tym dwa z blokadą                                      |
| 4  | wymiary całkowite: <b>1270x600x1000/1400 (długość z korbą 1400mm)</b> [szerxgłxwys]   |
| 5  | wymiary blatu: <b>1200x600mm</b>  |
| 6  | wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego: <b>1120x520mm</b>  |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 7 | gwarancja min. 12 miesięcy |
| 8 | produkt fabrycznie nowy    |

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3 dot. załącznika nr 1, pakiet nr 9 (formularz asortymentowo-cenowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 stojaków o parametrach jak w poniższej tabeli? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i równoważne do wymaganego w SIWZ.

|  |  |
|--|--|
| 1  | Stojak z dwoma miskami   |
| 2  | Stojak z jedną miską   |
| <b>Wymagania zamawiającego do poz. 1</b> |  |
| 1  | ze stali kwasoodpornej   |
| 2  | miski na odpadki ze stali nierdzewnej o pojemności do wyboru: 3l, 6l, 9l   |
| 3  | podstawa pięcioramienna na kołach w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą |
| 4  | średnica podstawy: 560mm   |
| 5  | wysokość stojaka: 840mm  |
| 6  | gwarancja min. 12 miesięcy   |
| 7  | produkt fabrycznie nowy  |
| <b>Wymagania zamawiającego do poz. 2</b> |  |
| 1  | ze stali kwasoodpornej   |
| 2  | miski na odpadki ze stali nierdzewnej o pojemności do wyboru: 3l, 6l, 9l   |
| 3  | podstawa pięcioramienna na kołach z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o średnicy 50mm (+/- 5mm), w tym dwa z blokadą  |
| 4  | średnica podstawy: 560mm   |
| 5  | wysokość stojaka: 850mm  |
| 6  | gwarancja min. 12 miesięcy   |

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4 dot. załącznika nr 1, pakiet nr 10 (formularz asortymentowo-cenowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 stojaków o parametrach jak w poniższej tabeli? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i równoważne do wymaganego w SIWZ.

|  |   |
|--|---|
| 1  | Podest operacyjny jednostopniowy  |
| 2  | Podest operacyjny dwustopniowy  |
| <b>Wymagania zamawiającego do poz. 1</b> |   |
| 1  | ze stali kwasoodpornej  |
| 2  | Stopy z możliwością poziomowania, wykonane z tworzywa sztucznego o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniające doskonałe przyleganie do twardych podłoży |
| 3  | blat pokryty materiałem antypoślizgowym   |

|  |  |
|--|--|
| 4  | wymiary: 500x300x120 mm [szerxglxwys]  |
| 5  | gwarancja min. 12 miesięcy   |
| 6  | produkt fabryczne nowy   |
| <b>Wymagania zamawiającego do poz. 2</b> |  |
| 1  | ze stali kwasoodpornej   |
| 2  | Stopy z możliwością poziomowania, wykonane z <b>tworzywa sztucznego</b> o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniające doskonałe przyleganie do twardych podłoży |
| 3  | blat pokryty materiałem antypoślizgowym  |
| 4  | wymiary: 500x650x410 mm [szerxglxwys]  |
| 5  | gwarancja min. 12 miesięcy   |
| 6  | produkt fabryczne nowy   |

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 5 dot. załącznika nr 1, pakiet nr 11 (formularz asortymentowo-cenowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 szafy o parametrach jak w poniższej tabeli? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i równoważne do wymaganego w SIWZ.

|  |  |
|--|--|
| 1  | <b>Szafa dwudrzwiowa</b>   |
| <b>Wymagania zamawiającego do poz. 1</b> |  |
| 1  | 4x półki nierdzewne  |
| 2  | korpus szafy wykonany z blachy nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)              |
| 3  | drzwi szafy przeszklone  |
| 4  | półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przestawne co 45mm |
| 5  | uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach   |
| 6  | elementy stalowe niemalowane   |
| 7  | wymiary całkowite: 1000x470x1800mm [szerxglxwys]                               |
| 8  | gwarancja min. 12 miesięcy   |
| 9  | produkt fabryczne nowy   |

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6 dot. załącznika nr 1, pakiet nr 36 (formularz asortymentowo-cenowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 36 stolika o parametrach jak w poniższej tabeli? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i równoważne do wymaganego w SIWZ.

|  |   |
|--|---|
| 1  | Stolik zabiegowy mobilny  |
| <b>Wymagania zamawiającego do poz. 1</b> |   |
| 1  | solidna i stabilna konstrukcja z profili kwadratowych zamkniętych nierdzewnych kwasoodpornych 25x25mm |
| 2  | stelaż nierdzewny kwasoodporny (stal 1.4301; 304)   |
| 3  | 2 blaty zabiegowe wykonane ze stali kwasoodpornej   |
| 4  | przejezdna podstawa z kółkami kierunkowymi  |
| 5  | 2 kółka z blokadą   |
| 6  | wysokość: 88 cm   |
| 7  | Szerokość zewnętrzna: 76,5 cm<br>Szerokość blatu: 65 cm   |
| 8  | Głębokość zewnętrzna: 47 cm<br>Głębokość blatu: 40cm  |
| 9  | gwarancja min. 12 miesięcy  |
| 10                                       | produkt fabrycznie nowy   |

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 7 dot. załącznika nr 1, pakiet nr 44 (formularz asortymentowo-cenowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 44 stojaka o parametrach jak w poniższej tabeli? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i równoważne do wymaganego w SIWZ.

|  |  |
|--|--|
| 1  | Stojak do kroplówek  |
| <b>Wymagania zamawiającego do poz. 1</b> |  |
| 1  | Stojak wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej (gatunek 1.4301; 304)  |
| 2  | Kolumna ze stali nierdzewnej niemalowanej (gatunek 1.4301; 304), podstawa ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały |
| 3  | Podstawa stojaka wyposażona w 5 kółek o średnicy min 50 mm z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym dwa z blokadą    |
| 4  | Średnica podstawy: 560mm   |
| 5  | Głowica ze stali kwasoodpornej   |
| 6  | Głowica na 4 haczyki   |
| 7  | Dopuszczalne maksymalne obciążenie haczyka: min. 4 kg  |
| 8  | Regulacja wysokości w zakresie 1200/2150mm   |
| 9  | Produkt fabrycznie nowy  |

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 8 dot. załącznika nr 1, pakiet nr 47 (formularz asortymentowo-cenowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 47 taboretu o parametrach jak w poniższej tabeli? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i równoważne do wymaganego w SIWZ.

|  |                  |
|--|------------------|
| 1  | Taboret lekarski |
| <b>Wymagania zamawiającego do poz. 1</b> |                  |

|    |  |
|----|--|
| 1  | Uniwersalny taboret wyposażony w trwałe, podgumowane kółka |
| 2  | Regulacja wysokości siedziska sprężyną gazową              |
|    | -minimalna wysokość siedziska: 490 mm                      |
|    | -maksymalna wysokość siedziska: 630 mm                     |
| 3  | Wymiary  |
|    | -średnica podstawy 480 mm                                  |
|    | -średnica siedziska: 350 mm                                |
| 4  | Konstrukcja ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)    |
| 5  | Podstawa trójramienna z 5 kółkami                          |
| 6  | Kółka z tworzywa niebrudzącego powierzchni, z odbojnikami  |
| 7  | Tapicerka zmywalna   |
| 8  | Produkt fabrycznie nowy                                    |
| 9  | Możliwość montowania wyposażenia dodatkowego               |
| 10 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym                    |
| 11 | Produkt fabrycznie nowy                                    |

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

## Zestaw XIV

### **Pytanie 1 dot. Pakietu nr 13, poz. 1- Wózek transportowy - 1**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek transportowy na zasadzie równoważności posiadający następujące parametry techniczne:

Konstrukcja kolumnowa; Obciążenie robocze 250 kg; Konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo; Hydrauliczna nożna regulacja; Duże koła z możliwością blokowania z dwóch stron; Wyposażony w piąte koło; Obustronny dostęp do hydraulicznej regulacji wysokości; Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową; Materac wyposażony w specjalne elementy (rzepy) do utrzymania materaca na powierzchni leża wózka; Bez wskaźnika kąta nachylenia leża; Składane barierki boczne; Podziałka wzdłuż i wszerz leża; Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym miejscem na butlę z tlenem lub/oraz miejsce na rzeczy pacjenta.

Wymiary zewnętrzne: długość 2170 mm ± 10 mm, szerokość 790 mm ± 10 mm;

Wymiary leża: 620mm x 1930mm; Regulacja przechyłów wzdłużnych: +16°/-16° (± 3°); Regulacja wysokości: 560 mm + 15 mm, -25 mm do 860 mm ± 10 mm; Średnica kół: 200mm; Produkt fabrycznie nowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 2 dot. Pakietu nr 13, poz. 2- Wózek transportowy - 1**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek transportowy na zasadzie równoważności posiadający następujące parametry techniczne:

Konstrukcja wózka ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo

Powierzchnie wózka gładkie, łatwe do dezynfekcji

Hydrauliczna regulacja wysokości, dostępna z obu stron wózka

Pozycjonowanie blatu wózka w pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga

Leże 2-segmentowe, regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej

Blat wózka pokryty odejmowalnym materacem, stabilnie zamontowanym przy pomocy rzepów

Tunel na kasetę RTG na całej długości umieszczony pod segmentami leża

Wózek wyposażony w elementy zabezpieczająco-odbojowe, umieszczone na końcach wózka transportowego od strony głowy oraz od strony nóg

Chromowane, składane barierki boczne

Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym miejscem na butlę z tlenem lub/oraz miejsce na rzeczy pacjenta Koła jezdne o średnicy 200mm Centralna oraz kierunkowa blokada kół

Chromowane, poręczne uchwyty do prowadzenia wózka, umieszczone od strony głowy i nóg

Wymiary zewnętrzne: długość 2170 mm ± 10 mm, szerokość 790 mm ± 10 mm;

Wymiary leża: 620mm x 1930mm;

Regulacja przechyłów wzdłużnych: +16°/-16° (± 3°);

Regulacja wysokości: 610mm +15mm/-25 mm do 910mm±10mm

Regulacja segmentu pleców: 0-90o (+/-5o)

Produkt fabrycznie nowy

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3 dot. pakietu nr 46, poz. 1- Wózek inwalidzki – 20**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości fotel transportowy na zasadzie równoważności posiadający następujące parametry techniczne:

Wózek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo; Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne oraz pełne koła przednie skrętne, bez szybko złączek oraz bez obręczy; Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki bez kólek; Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela; Wózek wyposażony w hamulec; Szerokość całkowita fotela 718 mm; Szerokość siedziska 546mm; Powierzchnia siedziska i oparcia fotela zmywalna; Obciążenie dopuszczalne 227 kg; Możliwość zamontowania: wieszak na kropłówki, uchwyt na butelkę z tlenem; Kolorystyka wózka, kolor biały; Produkt fabrycznie nowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **14.09.2020 r.**, w następujący sposób:

1. § XIV SIWZ (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

ust. 1 „Oferty wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje>.”

ust. 2 „Termin składania ofert upływa dnia **14.09.2020 r. godz. 10.00.**”

ust. 3 „Oferty zostaną otwarte **w tym samym dniu o godz. 11.00** w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1 pok. nr 080 (środkowy pokój) – za pomocą ww. platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy), oraz załącznik nr 6 projekt umowy. Aktualne załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego [www.copernicus.gda.pl](http://www.copernicus.gda.pl).

Zatwierdził

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
*Piotr Wróblewski*  
Piotr Wróblewski

Sporządziła Sekretarz komisji – Magdalena Fuławka