

Pabianice, dnia 19 grudnia 2024 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na realizację zadania pn.: „**Sukcesywna dostawa odczynników biochemiczno-immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatów biochemiczno-immunochemicznymi na potrzeby PCM Sp. z o.o.**”, znak: **43/ZP/PN/D/24**

Zamawiający - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), dalej zwaną ustawą Pzp zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ). W związku z powyższym zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępni poniżej treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

/zachowano oryginalną pisownię pytań/

Pytanie 1

Dotyczy pkt 10 par. 2 projektu umowy

Prosimy o zmianę zapisu na: " Zgłoszenie awarii może nastąpić w formie pisemnej na adres e-mail:, bądź telefonicznie pod numerem Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie

potwierdzić pisemnie **na adres email:** otrzymanie zgłoszenia oraz wskazać szacunkowy czas naprawy. Potwierdzenia następuje najpóźniej w ciągu 3 godzin roboczych.

ODPOWIEDŹ- Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 2 ust. 4 pkt 10 na: " Zgłoszenie awarii może nastąpić w formie pisemnej na adres e-mail:, bądź telefonicznie pod numerem Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić pisemnie **na adres email:** otrzymanie zgłoszenia oraz wskazać szacunkowy czas naprawy. Potwierdzenia następuje najpóźniej w ciągu 3 godzin roboczych

Pytanie 2

Dotyczy pkt 11 par. 2 projektu umowy

Prosimy o zmianę zapisu na: „*Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania czasu przystąpienia do naprawy do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii, z wyłączeniem weekendu, w którym dopuszcza się skorzystanie ze zdalnej pomocy w godzinach 8-21*”.

ODPOWIEDŹ - Zapis SWZ pozostaje bez zmian. Laboratorium pracuje w trybie 24/7/365.

Pytanie 3

Dotyczy pkt 12 par. 2 projektu umowy

Prosimy o odstąpienie żądania dostarczenia w ciągu 24h sprzętu zastępczego, w razie naprawy Sprzętu przekraczającej 24 godziny, liczonej od momentu przystąpienia do naprawy. Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z terenu UE, tak więc termin jest nierealny. Prosimy o pozostawienie możliwości wykonywania badania w podmiocie zewnętrznym na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Jednocześnie w takim wypadku jeśli badania będą wykonywane w laboratorium zewnętrznym prosimy o możliwości naliczania kar umownych.

ODPOWIEDŹ - Zamawiający odstępuje od żądania dostarczenia sprzętu zastępczego. Zamawiający pozostawia w mocy zapisy dotyczące możliwości skorzystania przez Zamawiającego z możliwości nałożenia kar umownych w przypadku konieczności zlecenia badań w zewnętrznym podmiocie.

Zamawiający wskazuje, że wykonanie badań w podmiocie zewnętrznym, jest sytuacją wyjątkową, mającą na celu zachowanie ciągłości przeprowadzania badań dla pacjentów PCM, jednak same w sobie nie jest zjawiskiem pożądanym. Dlatego, możliwość naliczenia kar umownych w tym przypadku ma za zadanie, zmotywowanie wykonawcy do niedopuszczania lub jak najszybszego usunięcia awarii, mając oczywiście na względzie dobro pacjentów PCM. Dodatkowo wskazujemy, że w przypadku zlecenia badań na zewnątrz Zamawiający obciążony jest dodatkową pracą związaną z obsługą takich badań, co jest dla Zamawiającego zjawiskiem niepożądanym, dlatego w przypadkach, których czas naprawy będzie się przedłużał i ilość zdarzeń będzie się powtarzać, Zamawiający skorzysta z prawa naliczenia kar umownych.

Pytanie 4

Dotyczy pkt 14 ppkt 8 par. 2 projektu umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostawy analizatorów z 7 dni na min. 21 dni roboczych. Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z terenu UE

ODPOWIEDŹ - Zamawiający zmienia termin dostawy na 30 dni roboczych. (dzień roboczy Poniedziałek-Piątek). Dodatkowo wskazuje, że uruchomienie Analizatorów w taki sposób aby Zamawiający mógł wykonywać badania wynosi **maksymalnie 7 dni od dnia odbioru (potwierzenia dostawy Sprzętu) dostawy.**

Pytanie 5

Dotyczy pkt 18 i 19 par. 2 projektu umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisów na:

„18. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminom, o których mowa w ust. 4 pkt 7, 8, 12, 13 ust. 8, ust 16 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto miesięcznej raty dzierżawy, za każdy dzień zwłoki. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminom, o których mowa w ust. 4 pkt 10, 11, 12, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto miesięcznej raty dzierżawy za każdą godzinę roboczą zwłoki.

19. W razie niedostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego w wypadkach i na warunkach, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości

0,05% brutto miesięcznej raty dzierżawy, za każdy dzień, w którym Zamawiający będzie z tego tytułu pozbawiony możliwości korzystania z urządzenia”.

ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy pkt 5 par. 3 projektu umowy

Prosimy o odstąpienie żądania powiadamiania Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast po otrzymaniu zamówienia albowiem Zamawiający dopiero w momencie wyjazdu towaru z magazynu otrzymuje powiadomienie na podany przez siebie email o ewentualnych brakach w danej dostawie.

ODPOWIEDŹ- Zamawiający zamienia słowo „natychmiast” na „**bez zbędnej zwłoki**”

Pytanie 7

Dotyczy pkt. 8 i 12 par. 3 projektu umowy

Zamawiający określił minimalny próg wykonania umowy w wysokości 50% wartości umowy

Zgodnie z art. 433 pkt 4 Pzp:

„Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.”

Należy podnieść, że komentowany przepis nie daje Zamawiającemu nieograniczonej swobody w określeniu minimalnego progu wykonania umowy.

Narzucenie tak skrajnie niekorzystnych warunków zamówienia przez Zamawiającego w postaci określenia minimalnego progu wykonania umowy w wysokości 50 % wartości umowy i ograniczenia, w ten sposób, roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego jest przejawem nadużycia przez niego pozycji gospodarza postępowania. Ogranicza to krąg wykonawców, którzy mogą wziąć udział w postępowaniu. Jedynie bowiem podmiot gospodarczy o dużych zasobach finansowych może sobie pozwolić na realizację zamówienia ze stratą, byle tylko wykonać zamówienie i uzyskać z tego tytułu referencyjność, przydatną przy wykazywaniu doświadczenia w wykonaniu tego rodzaju zamówień przy ubieganiu się o kolejne zamówienia publiczne w tym sektorze. Jest to sprzeczne także z celami dyrektywy 2014/24/UE, która promuje udział małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) w zamówieniach publicznych w ramach celów socjalnych dyrektywy.

Ponadto, wykonawca zobowiązany jest ponieść określone koszty stałe, takie jak zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, nabycie i utrzymanie określonej ilości sprzętu do wykonania usługi na podstawie długoterminowych umów z dostawcami, do tego koszty produkcji, kredytu, leasingu itp., zaś nagłe ograniczenia wykonywania usługi powodują niekiedy konieczność zwolnień pracowników, i to w trybie ekonomicznym, za co, zgodnie z ustawą o zwolnieniach ekonomicznych, należne im są odprawy (art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Dzieje się tak, gdyż zgodnie z teorią ekonomii, w krótkim okresie co najmniej jeden czynnik produkcji jest niezmienny, stąd pojawiają się koszty stałe, których w krótkim okresie wykonawca nie jest w stanie wyeliminować w

wypadku ograniczenia wielkości przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. Ponadto, istnieje prawidłowość ekonomiczna, zgodnie z którą im większy przedmiot zamówienia, tym niższe koszty ponosi wykonawca (tzw. ekonomiczny efekt skali – koszty nie rosną wprost proporcjonalnie do wielkości produkcji, lecz maleją), na skutek czego w takim wypadku wykonawca jest w stanie zaoferować niższą cenę. Jeśli jednak już po zawarciu umowy przedmiot zamówienia zmaleje w stopniu znacznym, okaże się, że wykonawca nie jest w stanie osiągnąć efektu skali i otrzymuje wynagrodzenie po cenach niższych od takich, jakie zaoferowałby, gdyby jeszcze przed złożeniem ofert zamawiający zmniejszył przedmiot zamówienia. W dodatku, wykonawca ponosi tzw. koszty alternatywne, czyli koszty „utraconych szans”, gdyż poprzez fluktuacje wielkości przedmiotu zamówienia zobowiązany jest utrzymać w gotowości – w rezerwie – określoną ilość personelu, sprzętu i asortymentu na wypadek nagłego przywrócenia wyłączonej pierwotnej ilości do realizacji, które to zasoby mógłby wykorzystać do świadczenia usług w innym miejscu, pozostawione zaś w gotowości generują tylko koszty, zaś sprzęt dodatkowo ulega utracie wartości.

Zatem Oferent wnosi o zmianę treści § 3 pkt 8 „*Faktyczna ilość zamawianych towarów zależna będzie od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków Zamawiającego, przy czym minimalna wielkość realizacji umowy została określona na poziomie 80% przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 do umowy. Zamawiający przewiduje prawo opcji, które polega na zwiększeniu ilości zamawianego towaru wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ do wartości maksymalnej umowy*”

ODPOWIEDŹ- Zapis SWZ pozostaje bez zmian. Zapis umowy jest skonstruowany zgodnie z przepisami PZP. Biorąc pod uwagę ryzyko, o którym pisze wykonawca Zamawiający rozgraniczył koszty dzierżawy od kosztów dostawy odczynników.

Pytanie 8

Dotyczy pkt 19 par. 3 projektu umowy

Uprzejmie prosimy o wyrażenia zgody na zmianę zapisu na: „*Uwzględnienie reklamacji skutkuje dostarczeniem przez Wykonawcę towaru wolnego od wad lub uzupełniającego zamówienie w terminie 4 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji*”

ODPOWIEDŹ- **Zamawiający zmienia zapis na** „*Uwzględnienie reklamacji skutkuje dostarczeniem przez Wykonawcę towaru wolnego od wad lub uzupełniającego zamówienie w terminie 3 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.*”

Pytanie 9

Dotyczy pkt. 24 i 25 par. 3 projektu umowy

Prosimy o zmianę zapisu na:

„*24. W przypadku niezrealizowania w ciągu 5 dni roboczych w całości złożonego zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% kwoty brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy dzień zwłoki.*

25. W przypadku niedochowania terminu wynikającego z ust. 19 odnośnie dostarczenia towaru

wolnego od wad, do sposobu i wysokości naliczenia kary umownej odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w ust. 24, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% kwoty brutto wartości wadliwego towaru, za każdy dzień zwłoki”.

ODPOWIEDŹ- Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 10

Dotyczy pkt. 6 par. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgody na przysłanie faktury w formacie pdf na podany przez Zamawiającego adres email alternatywnie do sposobów podanych w niniejszym punkcie umowy?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Dotyczy pkt. 6 par. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgody na przysłanie faktury w formacie pdf na podany przez Zamawiającego adres email alternatywnie do sposobów podanych w niniejszym punkcie umowy?

ODPOWIEDŹ- Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta, Wykonawca można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika, która jest wymieniona i wymagana w ulotce odczynnikowej. Zastosowanie wieloparametrowego materiału kontrolnego jest rozwiązaniem wygodniejszym i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

ODPOWIEDŹ – Materiał kontrolny należy zaproponować zgodnie z zapisami w ulotkach producenta.

Pytanie 13

Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta ? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora.

ODPOWIEDŹ - Zamawiający wymaga wszystkich płynów koniecznych do mycia i konserwacji analizatorów.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia soli fizjologicznej do rozcieńczania próbek? W przypadku wymogu dostarczenia roztworu, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie soli fizjologicznej Braun'a do rozcieńczania próbek o stężeniu 0,9%, bez zapisu o takim zastosowaniu w oficjalnej ulotce producenta.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga dostarczenia zgodnie z tym co jest zapisane w ulotce producenta lub innym równoważnym dokumencie producenta.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga aby oferent zaferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora ?

ODPOWIEDŹ - Tak

Pytanie 16

Dotyczy pkt. 45 parametrów granicznych oraz pkt. 8 pod tabelą zał. nr 2 do SWZ

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia możliwości odprowadzania ścieków z analizatora do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sposobów postępowania ze ściekami.

Uzasadnienie:

Zgodnie z lokalnymi przepisami laboratorium jako dostawca ścieków ustala sposób postępowania ze ściekami. Dostawca systemów analitycznych nie jest wytwórcą ścieków, a zatem nie jest uprawniony do wyznaczania i potwierdzania sposobów postępowania ze ściekami powstającymi w wyniku pracy innego podmiotu. Dostawca systemu analitycznego może dostarczyć karty charakterystyki odczynników używanych w systemie oraz raport z analizy ścieków.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że nie narzuca konkretnych rozwiązań jednego producenta. W związku z powyższym oczekuje od Wykonawcy w tym zakresie kompletu dokumentów i przedstawienia zasad postępowania ze ściekami wydobywającymi się z urządzeń i co należy z nimi zrobić.

Pytanie 17

Dotyczy załącznik nr 8 do SWZ

Prosimy o zmianę zapisu na „Posiada „certyfikat”, o którym jest mowa w art. 105 ustawy Pzp wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, dotyczące dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022, poz. 974) lub innym aktem prawnym właściwym dla kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz posiada certyfikat potwierdzający kategorię środka ochrony indywidualnej, **jeśli dotyczy**”.

Uzasadnienie:

Odczynniki oraz aparaty biochemiczno-immunochemiczne będące przedmiotem postępowania oraz oświadczenia są wyrobami medycznymi natomiast nie są klasyfikowane jako środki ochrony osobistej (tj.np. maski chirurgiczne), w związku z czym certyfikacja potwierdzająca kategorię środka ochrony osobistej nie ma do tych wyrobów zastosowania.

ODPOWIEDŹ – Zamawiając zmienia zapis na :Posiada „certyfikat”, o którym jest mowa w art. 105 ustawy Pzp wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, dotyczące dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z

ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022, poz. 974) lub innym aktem prawnym właściwym dla kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Pytanie 18

Dotyczy pkt. 5 parametrów granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który nie ma potrzeby zastosowania jednorazowych końcówek dozujących, ponieważ w analizatorze wykorzystywany jest opatentowany system aktywnego mycia, który zapewnia współczynnik przenoszenia $\leq 0,1$ ppm co stanowi wartość poniżej poziomu czułości metod?

ODPOWIEDŹ – Do badań immunochemicznych Zamawiający wymaga jednorazowych końcówek dozujących.

Pytanie 19

Dotyczy pkt. 7 parametrów granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego, w którym maksymalna wydajność teoretyczna części immunochemicznej wynosi do 100 oznaczeń na godzinę, natomiast maksymalna wydajność teoretyczna części biochemicznej do 800 oznaczeń wraz z ISE na godzinę?

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy pkt. 19 parametrów granicznych

Czy Zamawiający dopuści analizator z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim, posiadającym kolorowy, graficzny interfejs, obsługiwany za pomocą ikon?

ODPOWIEDŹ – Nie

Pytanie 21

Dotyczy pkt. 41 parametrów granicznych

Czy Zamawiający oceni jako równocenne i przyzna maksymalną liczbę punktów w przypadku, gdy wartości referencyjne dla parametrów diagnostyki tarczycy dla noworodków, dzieci i kobiet w ciąży pochodzą z niezależnych opracowań naukowych z wykorzystaniem populacji europejskiej oraz kanadyjskiej.

ODPOWIEDŹ – Tak jeśli wszystkie parametry zostały określone dla populacji europejskiej.

Pytanie 22

Dotyczy pkt. 42 parametrów granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów, w których niektóre roztwory robocze, płynny myjące, czyszczące można uzupełniać po przeprowadzeniu aparatu w określony tryb pracy: gotowości lub zaprogramowanej pauzy?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, jeśli można to zaprogramować jako jedna przerwa techniczna nie trwająca dłużej niż 30 minut w ciągu 24 h.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przy kalkulacji ilości zaoferowanych odczynników została wzięta pod uwagę możliwość okresowego przechowywania odczynnika w lodówce zewnętrznej poza analizatorem?

ODPOWIEDŹ – Nie.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ilość modułów ISE skalkulować w oparciu o praktykę ich realnego zużycia u użytkowników oferowanego systemu biochemicznego, popartą prawidłowymi wynikami kontroli jakości (metoda pod kontrolą), bez uwzględnienia terminu stabilności na pokładzie podanego w ulotce? Jednocześnie zaoferowana ilość modułów ISE zapewni Zamawiającemu wykonanie podanej ilości oznaczeń elektrolitów wraz z kontrolami i kalibracjami.

ODPOWIEDŹ – Nie.

Pytanie 25

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, tabela "Komputer – stacja robocza, porty :

Aktualnie nowe komputery nie posiadają wewnętrznych złączy USB. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nowego komputera bez wewnętrznych złączy USB?

ODPOWIEDŹ – Tak, dopuszcza.

Pytanie 26

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, tabela "Komputer – stacja robocza, Obudowa:

Prosimy Zamawiającego o wskazanie przy jakim obciążeniu zamawiający wymaga sprawności 90%?

ODPOWIEDŹ - zgodnie z definicją sprawność zasilacza podawana jest dla 3 poziomów obciążenia, tj. 20%, 50% oraz 100%. Zamawiający wskazując sprawność na poziomie 90% wymaga jej dla każdego z podanych obciążeń.

Pytanie 26.1

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, tabela "Komputer – stacja robocza, Obudowa:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera z firmowym zasilaczem zapewniającym poprawną i stabilną pracę komputera?

ODPOWIEDŹ Zgodnie z załącznikiem: Obudowa wolnostojąca z zasilaczem o sprawności 90%, zgodność z normą Energy Star 5.0, aktywne PFC

Pytanie 27

Dotyczy pkt. 10 parametrów granicznych sprzętu lub urządzeń, Zestawienie parametrów granicznych oraz kryteria oceny ofert na analizatory biochemiczno-immunochemiczne wraz z aparatem zastępczym, Załącznik nr 2 do SIWZ:

Z uwagi na fakt, że płyny z jam ciała z reguły są pochodzenia surowiczego i stężenia poszczególnych analitów oznacza się w obu materiałach (surowica, płyn z jam ciała) w oparciu o tą samą metodykę, czy Zamawiający dopuści aby oznaczenia te zaoferować w oparciu o protokoły aplikacyjne oraz odczynniki dla surowicy?

ODPOWIEDŹ- Tak, dopuszcza.

Pytanie 28

Dotyczy pkt. 22 parametrów granicznych sprzętu lub urządzeń, Zestawienie parametrów granicznych oraz kryteria oceny ofert na analizatory biochemiczno-immunochemiczne wraz z aparatem zastępczym, Załącznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli analizator wyposażony jest w modem serwisowy z możliwością monitorowania pracy aparatu przez serwis dystrybutora producenta?

ODPOWIEDŹ- Tak

Pytanie 29

Dotyczy pkt. 42 parametrów granicznych sprzętu lub urządzeń, Zestawienie parametrów granicznych oraz kryteria oceny ofert na analizatory biochemiczno-immunochemiczne wraz z aparatem zastępczym, Załącznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony kiedy uzupełnianie odczynników odbywa się bez przerywania procesu analizy, w trybie "wstrzymanie pobierania statywów" trwającym nie dłużej niż 5 min., a tylko jeden z płynów należy wymienić w trybie standby-należy zaznaczyć iż nie częściej niż raz dziennie np podczas rozruchu? Natomiast w przypadku wielorazowych kuwet nie ma konieczności uzupełniania ich w trakcie pracy i działanie to wymaga zatrzymania aparatu

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, jeśli można to zaprogramować jako jedna przerwa techniczna nie trwający dłużej niż 30 minut w ciągu 24 h.

Pytanie 30

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ pkt 43 - liczba badań

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

ODPOWIEDŹ- Zamawiający wymaga aby test beta-HCG był stosowany także jako marker nowotworowy.

Pytanie 31

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ pkt 49-liczba badań

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany odczynnik do oznaczania PTH był odczynnikiem 3 generacji, który gwarantuje wiarygodne oznaczenie aktywnej formy parathormonu 1-84?

ODPOWIEDŹ- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ pkt 44-liczba badań

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym i umożliwił zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego, z potwierdzeniem w ulotce metodycznej producenta odczynnika? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTk oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga.

Pytanie 33

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ pkt 39-liczba badań

Czy Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytoninę w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga.

Pytanie 34

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ: Rodzaj i ilości wykonywanych badań biochemicznych oraz immunochemicznych pkt 36-rodzaj badania:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Ferrytyna ma być oznaczana na module biochemicznym czy immunochemicznym?

ODPOWIEDŹ - Immunochemicznym

Pytanie 35

Dotyczy załącznika nr 2 Arkusz cenowy, Tab. 1a. formularz cenowy odczynników biochemicznych i immunochemicznych:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w kolumnach:

- Ilość op na 1 rok szt.
- Wartość na 1 rok netto PLN
- Wartość na 1 rok brutto PLN

podać ilości i wartości dotyczące 3 lat?

Uzasadnienie: zaoferowanie ilości na 1 rok wymaga zaokrąglenia do pełnych opakowań, co zawyży ofertę w skali 3 lat.

ODPOWIEDŹ - Zamawiający wyraża zgodę. Dokonuje zmian w załączniku. Dokonuje zmian obliczania również w tabeli 1.b. W arkuszu Formularz_cenowy_bioch i Formularz_cenowy_cz_immuno oraz stosownych zmian w arkuszu FC. Zmiany kolorem czerwonym czcionki.

Pytanie 36

Dotyczy Zestawienie parametrów granicznych oraz kryteria oceny ofert na analizatory biochemiczno-immunochemiczne wraz z aparatem zastępczym, Załącznik nr 2 do SIWZ: Informacje o pracy aparatów: "Aparaty biochemiczno-immunochemiczne będą pracowały równolegle, aparaty obciążone będą w stosunku 70% i 30% aparat back-up."

Prosimy o doprecyzowanie, które parametry będą wykonywane równolegle na obu aparatach?

ODPOWIEDŹ -Następujące badania będą wykonywane jednocześnie na dwóch aparatach: tropomina, beta-HCG, glukoza, mocznik, kreatynina, elektrolity, pozostałe badania na jednym aparacie.

Pytanie 37

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ: Arkusz cenowy: Zapis:

"Dla testów poniżej 100 miesięcznie kontrola będzie prowadzona raz w tygodniu na 2 poziomach. Dla testów powyżej 100 miesięcznie kontrola będzie prowadzona codziennie na 2 poziomach"

Prosimy o doprecyzowanie czy dla testów powyżej 100 miesięcznie kontrola będzie prowadzona codziennie na 2 poziomach zamiennie?

ODPOWIEDŹ – Tak dla testów biochemicznych i immunochemicznych.

Pytanie 38

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ: Rodzaj i ilości wykonywanych badań biochemicznych oraz immunochemicznych

Prosimy o informację, czy "przewidywana liczba badań" zawiera ilości potrzebne do przeprowadzenia kontroli i kalibracji?


ODPOWIEDŹ – Tak

Pytanie 39

Dotyczy wymagań ogólnych

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczytnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

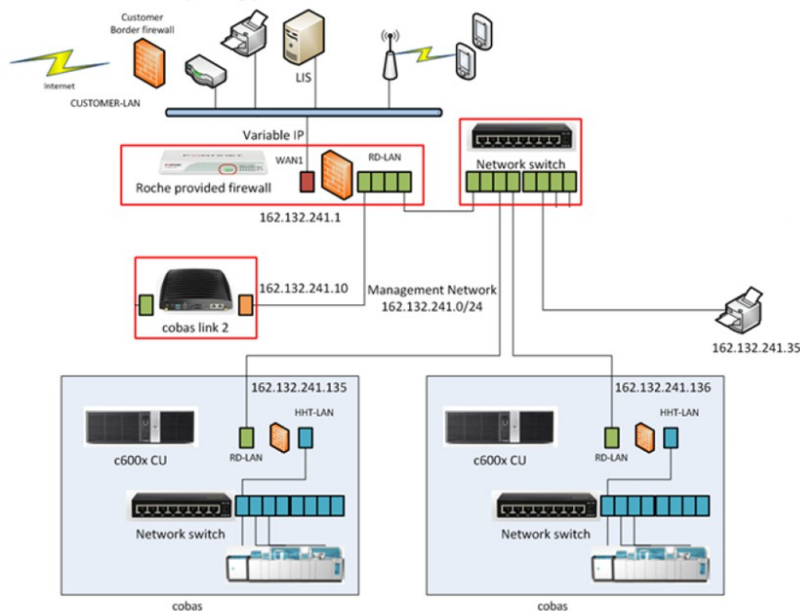

URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający zapewnia.

Pytanie 40

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający zmienia zapis w powyższym zakresie i określa termin na w ciągu 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

Pytanie 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

ODPOWIEDŹ – Tak.

Pytanie 42

Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium.

ODPOWIEDŹ – Tak.

Pytanie 43

Czy Zamawiający

Dotyczy Rozdział 28 pkt 5 swz wyrazi zgodę na wykonanie wizji lokalnej?

ODPOWIEDŹ – Tak. Szczegóły uzgodnione z Wykonawcami po chęci odbycia wizji zgłoszonej przez platform zakupową, przez WIADOMOŚĆ, do Zamawiającego.

Pytanie 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych dokumentów, folderów, prospektów, materiałów informacyjnych itp. Wykonawca przedstawił przed podpisaniem umowy oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca załączy oświadczenie o posiadaniu wymaganych dokumentów do oferty z podaniem adresu strony internetowej, na której znajdują się ww dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać.

ODPOWIEDŹ – Tak, wyraża zgodę i jednocześnie Zamawiający nie żąda załączenia oświadczenia o posiadaniu wymaganych dokumentów do oferty z podaniem adresu strony internetowej, na której znajdują się ww dokumenty.

Pytanie 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie deklaracji zgodności UE wyłącznie w języku angielskim?

Uzasadnienie: Przedstawienie deklaracji zgodności UE jedynie w języku angielskim spełnia obowiązujące normy prawne. Zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, nie ma bowiem konieczności dostarczania deklaracji zgodności UE w języku polskim. W przypadku wyrobów przeznaczonych bądź udostępnionych do stosowania przez użytkowników niebędących laikami, deklaracja zgodności UE może być wyrażona w języku polskim lub języku angielskim. Wyjątkiem są informacje przeznaczone dla pacjenta, które podaje się jedynie w języku polskim lub wyraża się za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Podkreślamy, że informacje wyrażone w języku angielskim w ww. dokumencie są przedstawione w sposób czytelny i w pełni zrozumiały, co zapewnia zgodność z wymaganiami prawnymi oraz nie wpływa na czytelność i przejrzystość dokumentów. Takie podejście może również przyczynić się do zwiększenia efektywności i uproszczenia procesu przetargowego.

ODPOWIEDŹ – Tak, wyraża zgodę.

Pytanie 46

Wnioskujemy od odstąpienie, na każdym etapie postępowania, od wymogu dostarczania dokumentów potwierdzających udostępnienie wyrobu na rynku tj. przedstawienia potwierdzenia dokonania notyfikacji w URPL.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) dokonywanie notyfikacji w formie papierowej zostało zastąpione dokonywaniem rejestru w systemie informatycznym "wykaz dystrybutorów", w którym dystrybutor obowiązkowo dokonuje wpisu o każdym sprowadzonym po raz pierwszy wyrobie, systemie lub zestawie zabiegowym. Dane gromadzone w powyższy systemie informatycznym dostępne są dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający określa zapis § 3 ust 14. Wykonawca bezwzględnie gwarantuje Zamawiającemu, że sprzedawany towar spełnia wymagane prawem warunki dopuszczenia ich do stosowania oraz posiada wymagane prawem dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań. Dokumenty mogą być przedstawione w wersji elektronicznej również w systemie informatycznym na każde żądanie Zamawiającego

Pytanie 47

Dotyczy zał. nr 5 projektowane postanowienia umowy

par. 2 ust. 4 pkt 2) lit. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zrezygnować z wersji pisemnej instrukcji i pozostać przy formie elektronicznej tj. pliku przesyłanego w email lub udostępnionego na stronie internetowej?

Rozwiązanie takie należy uznać za optymalniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, zapewniające Zamawiającemu bieżący i nieograniczony dostęp, zwłaszcza wobec postępującego procesu elektronicznej.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 48

par. 2 ust. 4 pkt 7), 8) i 13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słów "dni kalendarzowe" na "dni robocze"?

ODPOWIEDŹ -Nie

Pytanie 49

par. 2 ust. 4 pkt 11) i pkt 12) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

ODPOWIEDŹ -Nie

Pytanie 50

par. 2 ust. 4 pkt 12) Czy Zamawiający również w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy, a tym samym wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności dostarczenia urządzenia zastępczego?

ODPOWIEDŹ -Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3

Pytanie 51

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

ODPOWIEDŹ -Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3

Pytanie 52

par. 2 ust. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji urządzeń do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury celne z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy w zaproponowany w sposób.

ODPOWIEDŹ -Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4

Pytanie 53

par. 2 ust. 12 i ust. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 54

par. 2 ust. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego? Wskazujemy, iż wszelkie ryzyka finansowe związane z możliwością obciążenia Wykonawcy karami umownymi będą podlegały wkalkulowaniu do ceny ofertowej, co nie jest finalnie zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ -Nie

Pytanie 55

par. 2 ust. 19 Czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy oraz odstąpienia od naliczenia wskazanej kary umownej?

W przypadku braku zgody, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Wskazujemy, iż wszelkie ryzyka finansowe związane z możliwością obciążenia Wykonawcy karami umownymi będą podlegały wkalkulowaniu do ceny ofertowej, co nie jest finalnie zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ -Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3

Pytanie 56

par. 2 ust. 21 oraz par. 7 ust. 2 i ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

ODPOWIEDŹ – Nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57

par. 3 ust. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie, iż wynagrodzenie za wadliwy asortyment należy się po dostarczeniu towaru wolnego od wad zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym paragrafie?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 58

par. 3 ust. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez wskazanie, iż wysokość kary umownej naliczana będzie od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Uzasadnienie: Funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu,

ponadto mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną. To w konsekwencji mogłoby narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty choćby postępowania sądowego, którego przedmiotem byłoby miarkowanie.

ODPOWIEDŹ – Nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 59

par. 3 ust. 32 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie wskazanych dokumentów drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można dokumenty w tej formie wysłać?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. Adres zostanie wskazany w umowie

Pytanie 60

par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Konsekwencje finansowe nieprawidłowego wykonania umowy zostały już szczegółowo określone poprzez zastrzeżenie kar umownych a także rozszerzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody wyższej niż te kary.

ODPOWIEDŹ – Nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 61

par. 5 ust. 6 i par. 6 ust. 8 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

ODPOWIEDŹ – Nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 62

par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 63

par. 6 ust. 8 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

ODPOWIEDŹ -Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3

Pytanie 64

par. 6 ust. 8 pkt 6) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia katalogu/cennika asortymentu, do którego dystrybucji Wykonawca jest uprawniony, w formie elektronicznej (arkusz kalkulacyjny Excel, Word, PDF itp.) na wskazany adres mailowy lub w formie aneksu, każdorazowo po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o potrzebie dostarczenia Zamawiającemu ww. katalogu/cennika dostępnych produktów?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

par. 6 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu wydłużenia umowy do 44 miesięcy?

Uzasadnienie: Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.

ODPOWIEDŹ – Nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 66

par. 6 ust. 13 W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Czy wobec powyższego Zamawiający wprowadziłyby do wzoru umowy zaproponowaną poniżej treść postanowień waloryzacyjnych zgodnych z art. 439 PZP, które dzielą koszty wzrostu cen pomiędzy zamawiającego i wykonawcę?

1. *Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §5 Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).*
2. *Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).*
3. *Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.*
4. *Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.*
5. *Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.*
6. *W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.*
7. *W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.*

8. *W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.*
9. *Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy.*
10. *Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca prześle Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.*

ODPOWIEDŹ – Nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 67

par. 7 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Uzasadnienie: Funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu, ponadto mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną. To w konsekwencji mogłoby narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty choćby postępowania sądowego, którego przedmiotem byłoby miarkowanie.

ODPOWIEDŹ – Nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 68

par. 7 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

ODPOWIEDŹ – Nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 69

par. 7 ust. 1 pkt 2) oraz par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od „niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.

ODPOWIEDŹ – Nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 70

par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie przesłanek uprawniających do odstąpienia?

Odstąpienie od umowy bez wskazania jakiejkolwiek przyczyny powoduje narażenie Wykonawcy na straty, które Wykonawca może w kalkulować w cenę oferty co ostatecznie jest zjawiskiem niekorzystnym dla Zamawiającego. Ponadto zgodnie z art. 433 pkt 4) PZP w umowach należy określić minimalną wielkość świadczenia.

ODPOWIEDŹ – Nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie celem zawarcia długoterminowej umowy. Celem Zamawiającego nie jest zawieranie umowy i jej rozwiązywanie bez zaistnienia przesłanek do jej rozwiązania.

Pytanie 71

par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 72

par. 8 ust. 2 pkt 2) i pkt 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 73

par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanej kary umownej z „20%” do 10%”?

ODPOWIEDŹ – Nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 74

par. 11 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu roku, w(dalej: „Umowa”) pomiędzy:

..... **z siedzibą w** wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowypod nr KRS:, o kapitale zakładowym w wysokości:....., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP....., REGON nr....., reprezentowaną przez:

-,

zwaną dalej „Przetwarzającym”

a

..... **z siedzibą w** wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowypod nr KRS:, o kapitale zakładowym w wysokości:....., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP....., REGON nr....., reprezentowaną przez:

-,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

łącznie zwanych „Stronami”

Mając na uwadze, że:

- w dniu Strony zawarły umowę (zwaną dalej „Umową główną”), której przedmiotem jest,
- usługi świadczone przez Przetwarzającego w ramach Umowy głównej są związane z wykonywaniem przez Przetwarzającego operacji na danych osobowych w imieniu Zamawiającego,
- Zamawiający jako administrator danych osobowych jest obowiązany zapewnić, iż przetwarzanie przez Przetwarzającego danych osobowych w jego imieniu będzie odbywało się zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

§ 1

Definicje

Użyte w umowie określenia będą miały następujące znaczenie:

- 1) Rozporządzenie (UE) 2016/679** – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 2) Umowa główna** – oznacza zawartą przez Strony umowę, do której niniejsza Umowa stanowi załącznik;
- 3) Usługi** – oznaczają usługi, o których mowa w Umowie głównej;
- 4) administrator** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
- 5) dane osobowe** – oznacza dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
- 6) naruszenie ochrony Danych Osobowych** – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 7) organ nadzorczy** – oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
- 8) przetwarzanie** – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 9) podmiot przetwarzający** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
- 10) państwo trzecie** – oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 2

Przedmiot umowy

- 1.** Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych, które Przetwarzający przetwarza w imieniu Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy (dalej jako „Dane Osobowe”).
- 2.** Strony są zobowiązane być w stanie wykazać zgodność z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 3

Dane osobowe przetwarzane przez Przetwarzającego w imieniu Zamawiającego

1. Zamawiający jako administrator, działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679, powierza Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby świadczenia Usług, do których realizacji Przetwarzający zobowiązał się w Umowie głównej. Kategorie osób, których dotyczą Dane Osobowe oraz rodzaje powierzanych Przetwarzającemu Danych Osobowych wskazano w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przetwarzający przyjmuje Dane Osobowe do przetwarzania i zobowiązuje się je przetwarzać w imieniu Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. Przetwarzający jest uprawniony do wykonywania na Danych Osobowych wszelkich zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych operacji przetwarzania uzasadnionych i niezbędnych dla realizacji Usług, które obejmują w szczególności: przechowywanie, pobieranie, kopiowanie, przeglądanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.
4. Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług świadczonych Zamawiającemu na podstawie Umowy głównej.
5. Zamawiający oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania Danych Osobowych.
6. Zamawiający powierza Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych w jego imieniu przez okres obowiązywania niniejszej umowy.
7. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony poniżej wyznaczają osoby właściwe do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy, po jednej osobie z każdej ze Stron oraz ich zastępców w przypadku nieobecności:
 - a. Osoby kontaktowe po stronie Zamawiającego
 1., e –mail – jako główna osoba kontaktowa
 2., e-mail – jako osoba zastępująca
 - b. Osoby kontaktowe po stronie Przetwarzającego
 1., e-mail – jako główna osoba kontaktowa
 2., e-mail – jako osoba zastępująca

§ 4

Dalsze powierzenie przetwarzania danych

- 1.** Przetwarzający jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego w trakcie realizacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy (tzw. podmiotu podprzetwarzającego), pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących podmiotów podprzetwarzających, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu podprzetwarzającego przez innego usługodawcę lub o rezygnacji z usług podmiotu podprzetwarzającego, oraz z zastrzeżeniem ust. 2.
- 2.** Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych usługodawcy wskazanemu przez Przetwarzającego w terminie 7 dni od otrzymania od Przetwarzającego informacji o planowanym dalszym powierzeniu ich przetwarzania innemu podmiotowi

podprzetwarzającemu lub o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu podprzetwarzającego przez innego usługodawcę. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego podmiotowi objętemu sprzeciwem jest niedopuszczalne.

- 3.** Przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, iż podmiot podprzetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu Danych Osobowych daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
- 4.** Dalsze powierzenie czynności przetwarzania podmiotowi podprzetwarzającemu, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez Przetwarzającego na ten podmiot podprzetwarzający na mocy umowy tych samych obowiązków ochrony danych jakie spoczywają na Przetwarzającym w ramach niniejszej umowy, w szczególności obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
- 5.** W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych podmiotowi podprzetwarzającemu wiąże się z transferem tych danych do państwa trzeciego, taki transfer danych odbywa się zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia (UE) 2016/679. Jeżeli państwo trzecie, w którym zlokalizowany jest podmiot podprzetwarzający nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium i jednocześnie brak jest innych podstaw umożliwiających transfer Danych Osobowych do tego państwa trzeciego, Przetwarzający podpisze z takim podmiotem podprzetwarzającym umowę opartą o standardowe klauzule umowne (moduł trzeci klauzul: Przekazywanie między podmiotami przetwarzającymi) przyjęte decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Niniejsza umowa sama w sobie nie zapewnia wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazywaniem danych zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia (UE) 2016/679.
- 6.** Umowa, wskazana w ust. 4 i ust. 5 powyżej zawierana jest w formie przewidzianej w art. 28 ust. 9 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
- 7.** Przetwarzający ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków ochrony danych spoczywających na podmiocie podprzetwarzającym, któremu powierzył przetwarzanie Danych Osobowych. W przypadku niewywiązania się przez taki podmiot podprzetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych Osobowych, Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania korzystania przez Przetwarzającego z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych Osobowych.
- 8.** Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Przetwarzający jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 3. Zmiana w zakresie podmiotów podprzetwarzających następuje w sposób przewidziany w ust. 1 i 2 powyżej i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

§ 5

Obowiązki Przetwarzającego

- 1.** Przetwarzający jest obowiązany przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym za udokumentowane polecenie Zamawiającego uważa się polecenia

przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji gdy wymóg przetwarzania Danych Osobowych nakłada na Przetwarzającego prawo Unii Europejskiej lub prawo lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający poinformuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Przetwarzający jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych. Przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych. Przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Zapewnienie bezpieczeństwa Danych Osobowych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych Osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Mając na uwadze, że środki techniczne i organizacyjne są uzależnione od postępu technicznego i dalszego rozwoju, bez wpływu na jakiegokolwiek przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679, Przetwarzający może wdrożyć odpowiednie alternatywne środki do tych wskazanych w Załączniku nr 2. Czyniąc to, Przetwarzający zapewnia, że poziom bezpieczeństwa określonych środków nie może zostać zmniejszony. Przetwarzający będzie okresowo monitorował procesy wewnętrzne oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że przetwarzanie Danych Osobowych w jego zakresie odpowiedzialności jest zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa oraz ochrony praw osób, których dane dotyczą.
- Przetwarzający zapewnia, że w dostęp do Danych Osobowych jest udzielany członkom jego personelu jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Przetwarzający zapewnia, aby osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy Danych Osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.
- Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
- Na żądanie Zamawiającego, Przetwarzający poinformuje Zamawiającego o lokalizacji przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego oraz inne podmioty przetwarzające, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
- Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, jest obowiązany w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności Przetwarzający jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich otrzymanych pytaniach lub żądaniach osób, których dotyczą Dane Osobowe (podmiotów danych). Przekazanie przez Przetwarzającego wyżej wskazanych informacji następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania pytania lub żądania od podmiotu danych. Przetwarzający nie jest uprawniony do samodzielnego – w szczególności bez konsultacji z Zamawiającym – udzielania odpowiedzi na pytania i podejmowania działań w związku z żądaniem podmiotów danych.

7. Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
8. Przetwarzający jest obowiązany udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania, iż spełnia obowiązki określone w niniejszym paragrafie umowy oraz umożliwia Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy i przyczynia się do nich.
9. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 8 powyżej Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub kraju jego siedziby w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto Dane Osobowe powierzone Przetwarzającemu na podstawie niniejszej umowy.
11. Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłosić je Zamawiającemu wskazując w zgłoszeniu:
 - a. charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - b. opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;
 - c. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Przetwarzającego w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym opis działań podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.

Jeżeli przekazanie wszystkich wyżej wymienionych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie Przetwarzającego zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji Przetwarzający przekazuje je bez zbędnej zwłoki.

§ 6

Prawo audytu

1. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych Osobowych w celu zweryfikowania, czy Przetwarzający spełnia obowiązki określone w § 5 niniejszej umowy.
2. Strony ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:
 - a. Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10:00 do 16:00, po uprzednim

poinformowaniu Przetwarzającego drogą elektroniczną na adres e-mail: [●] o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem audytu.

b. Zamawiający prowadzi audyt osobiście lub za pośrednictwem niezależnych audytorów zewnętrznych, którzy zostali upoważnieni przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytu w jego imieniu.

3. Czynności kontrolne prowadzone w toku audytu, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a, mogą polegać w szczególności na sporządzeniu:

- a. notatek z przeprowadzonych czynności (w szczególności notatek z odebranych wyjaśnień i przeprowadzonych oględzin),
- b. kopii dokumentów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych,
- c. wydruków Danych Osobowych z systemów informatycznych,
- d. wydruków kopii obrazów wyświetlanych na ekranach urządzeń wchodzących w skład systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania Danych Osobowych,
- e. kopii zapisów rejestrów systemów informatycznych,
- f. zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń systemów informatycznych, w których odbywa się przetwarzanie Danych Osobowych,

z zastrzeżeniem, że nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Przetwarzającego, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Przetwarzającego środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

4. Audyt obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie Danych Osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Przetwarzającego.

5. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Przetwarzającego.

6. Czynności audytowe nie mogą nadmiernie utrudniać działalności Przetwarzającego, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Przetwarzającego.

7. Zamawiający dostarcza Przetwarzającemu kopię raportu z przeprowadzonego audytu. W przypadku stwierdzenia w toku audytu niezgodności działań Przetwarzającego z niniejszą umową lub przepisami o ochronie danych osobowych, do których stosowania Przetwarzający jest obowiązany, Przetwarzający niezwłocznie zapewni zgodność przetwarzania Danych Osobowych z postanowieniami umowy lub przepisami, których naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu.

§ 7

Odpowiedzialność Stron

1. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego niniejszej umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Wypowiedzenie Umowy głównej skutkuje równoczesnym wypowiedzeniem niniejszej umowy.
3. W przypadku gdy wyniki audytu, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy lub kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru u Przetwarzającego lub innego podmiotu przetwarzającego, któremu Przetwarzający powierzył przetwarzanie Danych Osobowych wykażą, iż Przetwarzający w sposób zawiniony naruszył postanowienia niniejszej umowy, lub w przypadku nieuwzględnienia przez Przetwarzającego żądania, o którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Przetwarzający zależnie od decyzji Zamawiającego usuwa lub zwraca Zamawiającemu powierzone Dane Osobowe, w tym (jeżeli dotyczy) wszelkie nośniki zawierające Dane Osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających Dane Osobowe – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju siedziby Przetwarzającego nakazują Przetwarzającemu dalsze przechowywanie Danych Osobowych. W takim przypadku za przetwarzanie ww. danych po rozwiązaniu niniejszej umowy Przetwarzający odpowiada jak administrator.
5. Przetwarzający jest obowiązany niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania niniejszej umowy, jak również na żądanie Zamawiającego potwierdzić na piśmie jego wykonanie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania. Przetwarzający zapewnia przestrzeganie niniejszej umowy do czasu usunięcia lub zwrotu Danych Osobowych do Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia (UE) 2016/679.
8. Postanowień niniejszej umowy nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.
9. Jeśli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej umowy stanie się lub zostanie uznane za nieważne, nielegalne lub niemożliwe do wykonania przez jakikolwiek właściwy sąd, pozostałe części umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne.

10. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
12. Integralną część umowy stanowią załączniki:
 - a. Załącznik nr 1: Kategorie osób, których dotyczą Dane Osobowe oraz rodzaje powierzanych Przetwarzającemu Danych Osobowych,
 - b. Załącznik nr 2: Środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 - c. Załącznik nr 3: Lista zaakceptowanych podmiotów podprzetwarzających

ODPOWIEDŹ – W przypadku konieczności zawarcia takiej umowy, strony zawrą umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami na wzorze zaproponowanym przez Zamawiającego. W załączeniu do odpowiedzi, plik o nazwie *Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych*

Jednocześnie zamawiający zamieszcza zmiany w projekcie umowy wynikające z udzielonych odpowiedzi i zauważonych koniecznych korekt (zmiany zaznaczone czcionką czerwoną)

Tekst jednolity projektu umowy zamieszczany pomocniczo. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo ma pierwotna wersja projektu umowy wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Dodatkowo w załączeniu zmieniony *Załącznik 2, 2a, 2b,2c Formularz asortymentowo-cenowy_zmiana19122024 po pyt i odp*

oraz

Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie zgodności z ustawą o wyrobach medycznych_19122024_zmiana

**Z upoważnienia
Kierownik Działu Zamówień Publicznych**