

Znak: ZOZ.V.010/DZP/38/22

Sucha Beskidzka dnia 29.04.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:  
ZOZ.V.010/DZP/38/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pakiet 2, pozycja 11-12**

Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do dobowej zbiórki moczu w opakowaniu a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu wg poniższych parametrów:

- bezlateksowy worek o pojemności 2000ml wykonany z PCV o grubości 0,40mm (podwójna ścianka)
- samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek
- skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120cm (dostępne również długości 90, 110, 130, 150cm)
- dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml
- wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków
- tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualną ocenę moczu
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia ?

## Odp. Zamawiający dopuszcza.

### Pakiet 2, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu 14-dniowy wg poniższych parametrów:

- worek o pojemności 2000ml wykonany z medycznego PVC
- biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualną ocenę moczu
- skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezwrotna)
- szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką z możliwością podwieszenia w twardej pochewce
- komora kropłowa typu Pasteur'a tworząca „suchą” barierę powietrzną
- dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnątrz systemu
- dren długości 120 cm o dużej średnicy, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym
- samouszczelniający się, bezigłowy port do pobierania próbek na zakończeniu drenu
- dren wyposażony w przesuwny zacisk oraz zapinkę do stabilizacji drenu
- w miejscu połączenia drenu z komorą dodatkowy element wzmacniający zapobiegający zaginaniu i skręcaniu drenu
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml od 25 do 100 ml i co 100 ml od 100 do 2000 ml
- na worku nazwa producenta, miejsce do opisu danych pacjenta oraz daty
- zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
- dodatkowe mocowanie za pomocą sznurka
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia


?

## Odp. Zamawiający dopuszcza.

### Pakiet 2, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pomiaru diurezy wg poniższych parametrów:

- Komora pomiarowa 500 ml, umożliwiająca bardzo dokładny pomiar diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml)
- Wyposażona w obrotowy zawór przelewowy, filtr hydrofobowy oraz podwójny system podwieszania
- Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml skalowany co 100 ml
- Wyposażony w zastawkę bezwrotną, filtr hydrofobowy, kranik spustowy typu „T”
- Dwuświatłowy dren o długości 120 cm, wzmocniony spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory
- Wyposażony w klamrę zatraskową, bezpieczny łącznik do cewnika z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu oraz zastawkę jednokierunkową zabezpieczającą przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

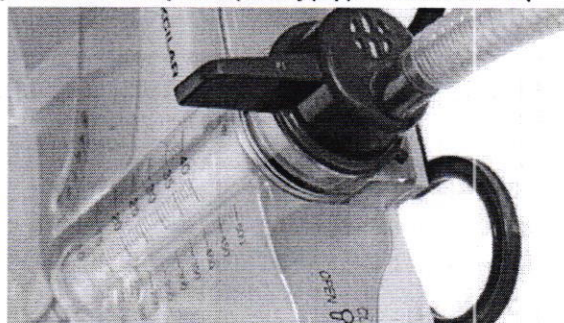

?

## Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Zadanie 2, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskacza do pępowiny w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchoj Beskidzkiej  
mgr Janusz Baczyński

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek