



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 15.10.2020r.

EZP 457/2020

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy przetargu M-52/2020 na dostawy aparatu do terapii nerkozastępczej, dwóch aparatów do dializoterapii oraz sterylizatora parowego przelotowego o pojemności 8 STE dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.**

**Zamawiający udziela sprostowania do udzielonych wcześniej odpowiedzi:**

### Pytanie1

odpowiedź pkt. 14 - automatyczny wbudowany elektroniczny test Bowie Dick. Czy Zamawiający podda ocenie posiadanie wbudowanego automatycznego elektronicznego testu Bowie Dick z archiwizacją raportu testów wdostarczonym wraz z urządzeniem jednolitym programie archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia:

- urządzenie z wbudowanym automatycznym elektronicznym testem, Bowie-Dick - 20 pkt
- urządzenie bez wbudowanego automatycznego elektronicznego testu Bowie-Dick - 0 pkt.

### Odpowiedź

Zamawiający dodaje pkt. 30a w załączniku 2.3 do SIWZ o następującej treści :


- urządzenie z wbudowanym automatycznym elektronicznym testem, Bowie-Dick - 20 pkt
- urządzenie bez wbudowanego automatycznego elektronicznego testu Bowie-Dick - 0 pkt.

### Pytanie2

odpowiedź 35- zawory bezpieczeństwa. Czy Zamawiający ponownie wprowadzi wymagania parametru pkt. 6 z Załącznika 2.3 dla sterylizatora - zawory bezpieczeństwa i wprowadzi punktację:

- jeden zawór bezpieczeństwa - 20 pkt



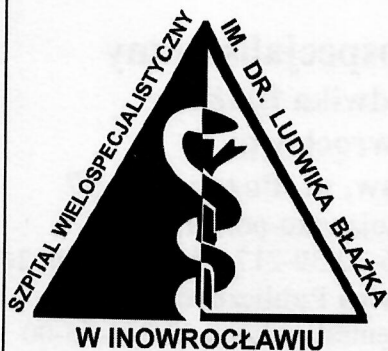

## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

- dwa oddzielne zawory bezpieczeństwa - 10 pkt.

- trzy oddzielne zawory bezpieczeństwa - 0 pkt.

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź na pytanie nr 35.

### Pytanie3

pkt. 40 - wymaganie dotyczące ekranu obok komory. Uzasadnienie - w wąskich urządzeniach wielu producentów ekran jest zlokalizowany ponad komorą i nie ma to wpływu na jakość i bezpieczeństwo pracy. Wymóg ten wyraźnie ogranicza konkurencję, a inne dopuszczone rozwiązania obniżyły standard i nowoczesność rozwiązań.

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga ekranu obok komory załadowniczej.

### Pytanie4

pkt. 39 - uszczelka dociskana sprężonym powietrzem. Czy w związku z odpowiedzią dopuszczającą uszczelkę dociskaną sprężonym powietrzem, Zamawiający wymaga detektora gazów niekondensujących?

### Odpowiedź

Zamawiający wymaga detektora gazów niekondensujących.

Jednocześnie informujemy , że maksymalna ilość punktów dla Zadania Nr. 3 w pkt XIII SIWZ wynosi 110 pkt.

Ponadto zamawiający dokonuje przesunięcia terminu sływania i otwarcia ofert:

1. Termin sływania ofert upływa 23.10.2020r o godz. 11:25
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020r., o godzinie 11:30

KIEROWNIK DZIAŁU  
Zamówień Publicznych  
Ewa Sempowicz