



PODDEBICKIE
CENTRUM ZDROWIA®
SP. Z O.O.

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddebice, dn. 11.09.2023 r.

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem**

PCZ/ZP/419/2023

Dotyczy: „Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”.

PCZ/ZP/3330/12/2023

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o modyfikacji postanowień ogłoszenia i SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 3 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji postanowień dotyczących ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”:

- Pytanie 1.** Dotyczy Pakiet nr 64: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 2.** Dotyczy Pakiet nr 64: W przypadku zgody na inną wielkość opakowania prosimy o określenie, czy w razie otrzymania w wyniku przeliczeń ułamkowej ilości, wycenić ułamkową ilość czy dokonać zaokrąglenia do pełnych opakowań/rolek (w górę bądź zgodnie z zasadami matematyki)?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 3.** Pakiet nr 23: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników skalowanych co 5 cm, prowadnica 150 cm, Ch 4,7 w pozycji 1 i CH 6 w pozycji 2, pozostałe parametry według opisu.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 4.** Pakiet nr 34: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów o długości ramion 9,0 mm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 5.** Pakiet nr 92: Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie siatek o wymiarach 32 mm x 60 mm, długość narzędzia 240 cm, średnica narzędzia 2,4 mm oraz pętli o wymiarach 40 x 65 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica narzędzia 2,5 mm.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 6.** Pakiet nr 53: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na rolce, podfoliowane, szerokość 33 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 7.** **Pytanie 1 – pakiet nr 7, pozycja 1:** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania, jako produkt równoważny, worków do dobowej zbiórki moczu z zaworem prostym, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 8.** **Pytanie 5 – pakiet nr 85, pozycja 1:** Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego, markera chirurgicznego do skóry z dwustronną końcówką 0,5 mm oraz 1,0 mm, szybkoschnący, odporny na środki dezynfekujące, w zestawie giętka

99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

linijka o dł. 15cm/6',zapewniająca dokładne odmierzenie nawet na nierównych powierzchniach, dodatkowa skala pomiarowa o dł. 6 cm na markerze, fioletowy atrament /fiolet gencjanowy/, sterylizowany radiacyjnie. Zaoferowany marker chirurgiczny jest powszechnie stosowany w placówkach opieki zdrowotnej. Dopuszczenie powyższego możliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 33 - Mankiet infuzyjny wielokrotnego użytku. Mankiet do szybkiego przetaczania o poj. 500 ml przezroczysty z manometrem umieszczonym w górnej części o zakresie 0-300 mmHg. Od mankieta odchodzi dren łączący gruszkę z zaworem ręcznym. Całość pozbawiona lateksu.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 38 poz. 1 Zestaw do drenażu przezskórnego, jednorazowy jałowy, metoda jednostopniowa 6FR, dł. 25 cm; poz. 2 Zestaw do drenażu przezskórnego, jednorazowy jałowy, metoda jednostopniowa 8FR lub 10FR, dł. 25 cm.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11. Pytanie do wzoru umowy: W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12. Pakiet 83, pozycja 3:Czy Zamawiający dopuści elektrodę -Pętłę dł. 120 mm, śr.4 mm, 15x15mm lub 20x20mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13. **Pakiet 3, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł typu Atraucan 26G bez przewodnicy?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14. **Pakiet 3, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł 25Gx90mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 3 poz. 2 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

2.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (typu PENCAN) 25G x 88-90 mm pakowana razem z przewodnicą. W obsadce igły pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmianą barwy. Uchwyt o eliptycznym przekroju z 4 okienkami.	szt.	1 500
----	---	------	-------

Pytanie 15. **Pakiet 3, poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł 25G (0,5x120mm) z przewodnicą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 3 poz. 3 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

3.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 25G 0,5-0,53x120mm, 26G 0,45-0,47x88-90mm, 27G 0,4-0,42x88-90mm jednorazowa typu Spinocan. W obsadce igły pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmianą barwy. Uchwyt o eliptycznym przekroju z 4 okienkami.	szt.	50
----	--	------	----

Pytanie 16. **Pakiet 3, poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł 26G (0,45x90mm)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 3 poz. 3 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

3.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 25G 0,5-0,53x120mm, 26G 0,45-0,47x88-90mm, 27G 0,4-0,42x88-90mm jednorazowa typu Spinocan. W obsadce igły pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmianą barwy. Uchwyt o eliptycznym przekroju z 4 okienkami.	szt.	50
----	--	------	----

Pytanie 17. **Pakiet 3, poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł 27G (0,4x90mm)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 3 poz. 3 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

3.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 25G 0,5-0,53x120mm, 26G 0,45-0,47x88-90mm, 27G 0,4-0,42x88-90mm jednorazowa typu Spinocan. W obsadce igły pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmianą barwy. Uchwyt o eliptycznym przekroju z 4 okienkami.	szt.	50
----	--	------	----

Pytanie 18. Pakiet 5, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igieł z prowadnicą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19. Pakiet 7, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 20. Pakiet 18, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawkę z pojedynczą skalą?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 21. Pakiet 18, poz. 1, 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 22. Pakiet 18, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawkę z igłą 29Gx 12,7mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 18 poz. 2 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

2.	Strzykawka trzyczęściowa do insuliny 1 ml, bezpieczna, z wbudowaną igłą w rozmiarze 29 G x 12,5-12,7 mm wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt.	op.	2
----	---	-----	---

Pytanie 23. Pakiet 18, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawkę 50/60ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 18 poz. 5 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

5.	Strzykawka j.u. 50ml lub 50/60ml bursztynowa do pomp infuzyjnych luer-lock w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, podwójne uszczelnienie tłoka, z tłokiem pozwalającym na całkowite opróżnienie zawartości strzykawki, szczelny lekko przesuwający się tłok, opakowanie folia/papier	szt.	1 000
----	---	------	-------

Pytanie 24. Pakiet 19, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie drenu CH30 – 7,00mm/10,00mm (śr. wewn./śr.zewn.)?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25. Pakiet 27, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stazy taktycznej w rozmiarze w stanie złożonym: 16cm x 6cm x 4cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26. Pakiet 40, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do operacji laparoskopowych z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm

1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 27. Pakiet 41, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji urologicznych z serwetą główną o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bezłateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów? Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 41 poz. 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw do operacji urologicznych 2-warstwowy. Skład zestawu: 1) serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, 2) taśma przylepna, 3) 1 serweta TUR 175-270 x 170-225 cm zintegrowana z nogawicami, z przylepnym otworem o średnicy 5-7 cm, z torbą na płyny z filtrem i poretem do ssaka oraz otworem nadłonowym 5-8cm. Tolerancja wymiarów +/- 10%. Opakowanie papier - folia, przynajmniej dwie naklejki do wklejenia do dokumentacji.	zestaw	200
----	--	--------	-----

Pytanie 28. Pakiet 42, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego o składzie i parametrach:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 29. Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca z końcówką zwężaną, perforowaną?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 30. Pakiet 45, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 31. Pakiet 48, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 32. Pakiet 48, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 33. Pakiet 48, poz. 3, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'30 z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do całych opakowań dla pozycji 4?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 34. Pakiet 48, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'25 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 35. Pakiet 54, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 36. Pakiet 55, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. a’120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 37. Pakiet 85, poz. 1 – Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 38. Pakiet 99, poz. 1 – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje skali co 100ml do 2000ml, a wartość 200ml pojawiła się w OPZ omyłkowo?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 39. Pakiet 101, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów z precyzyjnym regulatorem przepływu o następującym opisie:

- Regulacja przepływu: od 5 do 250ml/h (niebieskie cyfry na białym tle), jest przeznaczona do niskich rozwiązań lepkości
- Regulacja przepływu: od 5 do 200ml/h (białymi cyframi na niebieskim tle) jest przeznaczona do roztworów o lepkości od 10 do 40%
- Zakres błędu wynosi +/- 15%
- Komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów (DEHP free)
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0,1ml
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- Kolec z odpowietrzeniem
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową kłapką
- Długość drenu 145cm
- Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren
- Port Y
- Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- Nie zawiera lateksu ani ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka, papier-folia?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 40. Pakiet 103, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ginekologicznego o składzie:
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 103 poz. 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw ginekologiczny, sterylny jednorazowy min. 2-warstwowy. Pakiet musi zawierać min. 1) 1. Serwetę na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2) 1 serwetę 75cm x 90-120cm pod pacjenta 3) 1 serwetę 160-180/240-260 cm z otworem na krocze 10x15 cm i zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne. Pakiet opakowany w co najmniej jedną warstwę papier/folia, oznaczony metryczkami.	szt.	200
----	--	------	-----

Pytanie 41. PAKIET 33: Prosimy o dopuszczenie manometru ze skalą w zakresie 0-300 mmHg.



Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 42. PAKIET 80: Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych niż do strzygarki Medline DYND70800EU, pod warunkiem bezpłatnego użyczenia strzygarki kompatybilnej z nimi na czas trwania umowy. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie potrzebnej liczby strzygarek.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 43. PAKIET 80: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności (wymóg dyrektywy MDR 2017/745)?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 44. Pakiet 41 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji urologicznych TUR z serwetą główną o rozmiarze 215x180cm z otworem nadłonowym o rozmiarze 5cm z dodatkowymi serwetkami do wytarcia rąk 20x40cm – 2 sztuki? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 41 poz. 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw do operacji urologicznych 2-warstwowy. Skład zestawu: 1) serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, 2) taśma przyklepna, 3) 1 serweta TUR 175-270 x 170-225 cm zintegrowana z nogawicami, z przyklepnym otworem o średnicy 5-7 cm, z torbą na płyny z filtrem i poretem do ssaka oraz otworem nadłonowym 5-8cm. Tolerancja wymiarów +/- 10%. Opakowanie papier - folia, przynajmniej dwie naklejki do wklejenia do dokumentacji.	zestaw	200
----	--	--------	-----

Pytanie 45. Pakiet 42 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra wykonany z włókniny dwuwarstwowej, o następującym składzie:

serweta z wycięciem U 100x20cm z przyklepcem	1	260x240
Serweta z przyklepcem	1	240x150
serweta	1	90x75
serweta	3	250x160
pokrowiec na nogę	1	120x37
kieszka na płyny z kształtką	2	40x30
taśma medyczna	7	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 46. Pakiet 42 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra, o następującym składzie:

Serweta z laminatu 2-warstwowego z warstwą chłonną, wycięciem U 100x20 cm i przyklepcem	1	260x230 (120x80)
Serweta z laminatu 2-warstwowego z warstwą chłonną i przyklepcem	1	240x150 (37,5x70)
pokrowiec na nogę	1	120x37
kieszka na płyny z kształtką	1	40x30
taśma medyczna	6	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 47. Pakiet 45 poz. 5: Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli 100 cm długości (w SZW 10cm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli 100cm długości. Pakiet nr 45 poz. 5 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

5.	Plaster z opatrunkiem na tkaninie 6-8cm x 100cm. Plaster dobrze się przykleja, posiada dobre napięcie, mocny klej i dobrą przyczepność.	szt.	100
----	---	------	-----

Pytanie 48. Pakiet 46 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny, podfoliowany z taśmą samoprzylepną o chłonności 617%? Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49. Pakiet 48 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści opatrunek pooperacyjny o rozmiarze 8x10cm lub 8x15cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 50. Pakiet 49 poz. 1: Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie pasa 75-110cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 49 poz. 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jednorazowe pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni rozmiar „M” obwód pasa od 70-75 do 110 cm o anatomicznym kształcie, zapinane na cztery przylepcorzepty po dwa z każdej strony dla optymalnego dopasowania pieluchomajtki do ciała, bez ściągaczy taliowych. Wyposażone we wskaźnik chłonności pokazujący stopień nasączenia pieluchomajtki. Podwójny wkład chłonny z superabsorbentem (SAP) zapobiega przykremu zapachowi, elastyczne barierki boczne zabezpieczają przed przeciekaniem. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna wykonana z delikatnej oddychającej laminatu/ włókniny . Nie wybielane chlorem. Nie zawierają lateksu. Chłonność przebadana wg ISO-11948 (Rothwell) nie mniej niż 2200 ml – na wezwanie Zamawiającego wymagany protokół z badania ISO .	szt.	200
----	--	------	-----

Pytanie 51. Pakiet 49 poz. 3: Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie pasa 130-170cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 49 poz. 3 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

3.	Jednorazowe pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni rozmiar „XL” obwód pasa od 110-130 do 170 cm o anatomicznym kształcie, zapinane na cztery przylepcorzepty po dwa z każdej strony dla optymalnego dopasowania pieluchomajtki do ciała, bez ściągaczy taliowych. Wyposażone we wskaźnik chłonności pokazujący stopień nasączenia pieluchomajtki. Podwójny wkład chłonny z superabsorbentem (SAP) zapobiega przykremu zapachowi, elastyczne barierki boczne zabezpieczają przed przeciekaniem. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna wykonana z delikatnej oddychającej laminatu/ włókniny . Nie wybielane chlorem. Nie zawierają lateksu. Chłonność przebadana wg ISO- 11948 (Rothwell) nie mniej niż 2500 ml – na wezwanie Zamawiającego wymagany protokół z badania ISO .	szt.	2 500
----	--	------	-------

Pytanie 52. Pakiet 49 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2500 oraz o obwodzie pasa 130-170cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 49 poz. 3 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

3.	Jednorazowe pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni rozmiar „XL” obwód pasa od 110-130 do 170 cm o anatomicznym kształcie, zapinane na cztery przylepcorzepty po dwa z każdej strony dla optymalnego dopasowania pieluchomajtki do ciała, bez ściągaczy taliowych. Wyposażone we wskaźnik chłonności pokazujący stopień nasączenia pieluchomajtki. Podwójny wkład chłonny z superabsorbentem (SAP) zapobiega przykremu zapachowi, elastyczne barierki boczne zabezpieczają przed przeciekaniem. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna wykonana z delikatnej oddychającej laminatu/ włókniny . Nie wybielane chlorem. Nie zawierają lateksu. Chłonność przebadana wg ISO- 11948 (Rothwell) nie mniej niż 2500 ml – na wezwanie Zamawiającego wymagany protokół z badania ISO .	szt.	2 500
----	--	------	-------

Pytanie 53. Pakiet 49: Czy nie nastąpiła omyłka w podaniu jednostki chłonności. W formularzu cenowym jednostką chłonności są mililitry, natomiast norma ISO-11948 wymaga określania chłonności w gramach.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 54. Pakiet 96 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści sterylne antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m², rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log₁₀; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa.

Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m²x24h?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 55. Pakiet 97 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści sterylne wzmocnione antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocnione dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłoną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m², łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m². W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 38cm(L), min. 40cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 300cmH₂O, mniej krytycznej min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log₁₀ ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 56. Pakiet 103 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych o składzie:
serweta z otworem i zintegrowanymi
nogawicami, przylepiec wokół

otworu – serweta z trójwarstwowego laminatu 1 245x180

serweta przeznaczona pod pośladki – serweta z dwuwarstwowego laminatu 1 90x75

taśma medyczna 2 50x9

serweta na stół instrum. 1 190x150

serweta na stół Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 40x20

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 103 poz. 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw ginekologiczny, sterylne jednorazowy min. 2-warstwowy. Pakiet musi zawierać min. 1) 1. Serwetę na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2) 1 serwetę 75cm x 90-120cm pod pacjenta 3) 1 serwetę 160-180/240-260 cm z otworem na krocz 10x15 cm i zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne. Pakiet opakowany w co najmniej jedną warstwę papier/folia, oznaczony metryczkami.	szt.	200
----	---	------	-----

Pytanie 57. **Pakiet 1, poz. 1:** Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym zamiast zastawki antyzwrotnej.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 58. **Pakiet 1, poz. 1:** Proszę o odstąpienie od wymogu kapilar.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 59. **Pakiet 1, poz. 1:** Proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarach:

Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm
14G	Orange	270	2.10	45
16G	Grey	180	1.70	45
17G	White	126	1.40	45
18G	Green	85	1.30	32
18G	Green	85	1.30	45
20G	Pink	55	1.10	32
22G	Blue	33	0.90	25
24G	Yellow	18	0.70	19

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 60.** **Pakiet 18, poz. 2, 4:** Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 61.** **Pakiet 96:** Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS, o odporności na przenikanie cieczy min. 33 cm H₂O, spełniający pozostałe parametry SWZ? Dostępne rozmiary M/L, XL, XXL.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 62.** **Pakiet 96:** Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS, o odporności na przenikanie spełniający pozostałe parametry SWZ? Dostępne rozmiary S/M, XL, XXL.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- Pytanie 63.** **Pakiet 97:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy w których wzmocnienia w części przedniej przyklejone są na całej długości boków i od góry dostępne w rozmiarach M/L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- Pytanie 64.** **Pakiet 97:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy w których wzmocnienia w części przedniej przyklejone są na całej długości boków i od góry dostępne w rozmiarach S/M, L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- Pytanie 65.** Czy Zamawiający w **pak.60 poz.1** dopuści rękawice nitylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe, teksturowane na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, w kolorze niebieskim, AQL 1,5, długość min.240mm, grubość na palcu 0,08±0,03mm, na dłoni 0,08±0,03mm, zgodne z EN 455-1,2,3,4, EN 420, EN ISO 374-1(typB) i EN ISO 374-5, przebadane na min.5 substancji chemicznych wg EN 16523, odporne przez min.30 min na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: 1-propanol, etanoloamina-potwierdzone wynikami badań wg EN 16523 z jednostki niezależnej, odporne na przenikanie min.10 cytotatyków (m.in.5-Fluorouracil 50 mg/ml, Cyclophosphamide 20 mg/ml, Doxorubicin 2mg/ml, Taxol 6 mg/ml, Cisplatin 1.0 mg/ml, Carmustyna 3,3 mg/ml na 5 poziomie) - potwierdzone wynikami badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej i nadrukiem na opakowaniu, op. a100szt, rozm. XS-XL ?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 66.** Czy Zamawiający w **pak.60 poz.2** dopuści rękawice diagnostyczne i ochronne, nitylowe, bezpudrowe, długość min.280 mm, chlorowane od wewnątrz, o grubości: na palcu 0,14 +/-0,02mm, na dłoni 0,09 +/- 0,02mm, teksturowane na palcach, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, siła zrywu min.8N- potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej wg EN 455, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5, odporne przez min.30 min na alkohole: izopropanol 70% i etanol 70% - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min.60 min na min.10 cytotatyków (m.in.5-Fluorouracil 50 mg/ml, Cyclophosphamide 20 mg/ml, Doxorubicin 2mg/ml, Taxol 6 mg/ml, Cisplatin 1.0 mg/ml, Carmustyna 3,3 mg/ml) – wyniki badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej, posiadające certyfikat ergonomiczny z jednostki niezależnej (nadruk na opakowaniu), dopuszczone do kontaktu z żywnością, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnętrznego, Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu, Op. a'100 sztuk, rozm. XS-XL ?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 67.** Czy Zamawiający w **pak.79 w pozycji 1** dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 350 ml napełniony sterylną wodą do terapii oddechowej i zawierający mikrodyfuzory . Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów i niepirogenny. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno)?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 68.** Czy Zamawiający w **pak.79 w pozycji 2** dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 550 ml napełniony sterylną wodą do terapii oddechowej i zawierający mikrodyfuzory . Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów i niepirogenny. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno)?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 69.** Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 70.** W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 71.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:
 - 1.1. w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego zamówienia**. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z §2 ust. 6 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych składników zamówienia, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości **1,5%** ich wartości brutto.
 - 1.2. w wysokości **0,5%** wartości niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy**. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 6 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych składników dostawy, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości **1,5%** ich wartości brutto;
 - 1.3. gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od danej części umowy lub całości umowy lub w inny sposób ją zakończy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości **10%** wartości brutto niezrealizowanej całości umowy lub odpowiednio w wysokości **10%** wartości brutto niezrealizowanej danej części umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy;
 - 1.4. w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty**.
- Odpowiedź:** Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 72.** Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 1 poz. 1: bezpieczną kaniulę do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik" domykany standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie folia plus papier klasy medycznej zabezpieczające przed utratą jałowości, sterylizowaną tlenkiem etylenu, z badaniami laboratoryjnymi potwierdzającymi biokompatybilność poliuretanu , bez PVC i lateksu, dostępną w rozmiarach:
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
 - 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
 - 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
 - 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
 - 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
 - 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min?
 - 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?
- Odpowiedź:** Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 73.** Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści koreczki tego samego producenta co kaniule, pakowane w najmniejsze opakowanie - blistry po 4 sztuki oddzielone z zachowaniem sterylności, z wewnętrznym trzpieniem wychodzącym powyżej krawędzi koreczka, z informacjami o nr kat., lot, dacie ważności, oznakowaniem producenta na blistrach i opakowaniu zbiorczym?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 74.** **Dotyczy Pakietu nr 42:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
1 osłona na kończynę 36 x 120 cm
1 serweta 100 x 150 cm
1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łącznie gramatura 140g/m2). Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z min. nr REF, LOT i datą ważności.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 75.** **Dotyczy Pakietu nr 48:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunków o niżej opisanych wymiarach?
- poz. 1 – 5x7cm
- poz. 2,3,4 – 10x10cm
- poz. 5 10x20cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 76.** **Dotyczy Pakietów nr 96 i 97:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMMS, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- Pytanie 77.** **Pakiet 103:** Czy Zamawiający dopuści Zestaw ginekologiczny, sterylny jednorazowy min. 2-warstwowy o parametrach:
2 szt. osłona na kończynę 75x120cm
1 szt. obłożenie chirurgiczne do zabiegu TUR 100/152x220cm, otwór 9x18cm, z sitkiem 20x25cm
1 szt. serweta na stół (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm
Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 78.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pakiecie nr 60** wyników z badań posiadających cechy raportu, dotyczących odporności na przenikanie płynnych cytotatycznych substancji chemicznych.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 79.** Pakiet nr 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści igłę typu Pencil-Point?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 80.** Pakiet nr 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 20G x 38mm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 81.** **Pakiet nr 3, pozycja 2:** Czy Zamawiający dopuści zaferowanie równoważnej igły?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 82.** Pakiet nr 3, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści igłę nie posiadającą 4 okienek?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 83.** Pakiet nr 3, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści igłę z lejkiem posiadającym „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 84.** Pakiet nr 3, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści igłę typu Pencil-Point w rozmiarze 25G 0,5x120mm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 85.** Pakiet nr 3, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści igłę Quincke w rozmiarach:
- 26G 0,45x88mm
- 27G 0,4x88mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w rozmiarów, przy zachowaniu pozostałych opisów SWZ

3.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 25G 0,5-0,53x120mm, 26G 0,45-0,47x88-90mm, 27G 0,4-0,42x88-90mm jednorazowa typu Spinocan. W obsadce igły pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmianą barwy. Uchwyt o eliptycznym przekroju z 4 okienkami.	szt.	50
----	--	------	----

Pytanie 86. Pakiet nr 3, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści igłę nie posiadającą 4 okienek?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 87. Pakiet nr 3, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści igłę z lejkiem posiadającym „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 88. Pakiet nr 4, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści igłę typu Pencil-Point w rozmiarze 25G 0,5x120mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 89. Pakiet nr 6, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń o składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80mm
- Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatraskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 90. **Pakiet nr 17, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej jamy ustnej zawierający 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny oraz 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% nadtleniem wodoru, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 17 poz. 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw do 24 - godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny lub 0,12% roztworem chlorheksydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,1%-1,5% roztworem nadtlenu wodoru, 6 gąbek - aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. LUB Dwa osobne opakowania każde zawierające: - Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, - płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających w wyciskanej saszetce, 7ml Cztery osobne opakowanie zawierające: -Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu, z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, - płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających w wyciskanej saszetce, 7ml Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.	zestaw	150
----	--	--------	-----

Pytanie 91. Pakiet nr 19, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści dren o wymiarach 8 x 5mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 92. Pakiet nr 19, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści dren o wymiarach 10 x 7mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 93. Pakiet nr 33, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści mankiet infuzyjny z manometrem umieszczonym w dolnej części o zakresie 0-300mmHg?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 94. Pakiet nr 99, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek skalowany co 25ml do 100ml i co 100ml do 2000ml?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 95. Pakiet nr 101, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu 5-250ml/h?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 96. Pakiet nr 38 poz.2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na zestawy z igłą w rozmiarze 15Gx29 cm.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 97. **Pakiet nr 23, Poz.1:** Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaferowanie 6-miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów o rozmiarze 4.7 F, skalowanych co 5 cm, popychacz sterowalny o długości 50 cm (popychacz połączony z cewnikiem nawet po usunięciu przewodnicy) lub popychacz do URS o długości 70 cm do wyboru Zamawiającego, przewodnica 145 cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 98. **Pakiet nr 23, Poz. 2:** Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaferowanie 6-miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów o rozmiarze 6.0 F, skalowanych co 5 cm, popychacz sterowalny o długości 50 cm (popychacz połączony z cewnikiem nawet po usunięciu przewodnicy) lub popychacz do URS o długości 70 cm do wyboru Zamawiającego, przewodnica 145 cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 99. **Pakiet nr 30, Poz. 1:** Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaferowanie zestawu rozszerzań o rozmiarach od 6.0 do 30.0 Fr?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 100. **PAKIET NR 23:** Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Pigtail otwarty/ zamknięty z poliuretanu, cewnik skalowany co 1cm, przewodnica 150cm, popychacz 40cm, kłamra, CH 4,8 dł. 26 cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 101. **PAKIET NR 23:** Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Pigtail otwarty/ zamknięty z poliuretanu, cewnik skalowany co 1cm, przewodnica 150cm, popychacz 40cm, kłamra, CH 6 dł. 26 cm?


Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 102. **Pakiet 94:-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie hemostatycznych tamponów donosowych pakowanych po 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 103. **Dotyczy zadania 41:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie zestawów o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezłateksową osłonę na palec o średnicy 3,5cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm



185×260cm
1 szt./pcs./szt.



140×190cm
1 szt./pcs./szt.



9×50cm
1 szt./pcs./szt.



30×40cm
2 szt./pcs./szt.

Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 41 poz. 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:


1.	Zestaw do operacji urologicznych 2-warstwowy. Skład zestawu: 1) serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, 2) taśma przylepna, 3) 1 serweta TUR 175-270 x 170-225 cm zintegrowana z nogawicami, z przylepnym otworem o średnicy 5-7 cm, z torbą na płyny z filtrem i poretem do ssaka oraz otworem nadłonowym 5-8cm. Tolerancja wymiarów +/- 10%. Opakowanie papier - folia, przynajmniej dwie naklejki do wklejenia do dokumentacji.	zestaw	200
----	--	--------	-----

Pytanie 104. **Dotyczy zadania 42:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 nieprzylepna serweta 75x90cm,
- 1 serweta przylepna 180x300cm,
- 1 osłona na kończynę 35x120cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. Materiał: laminat folii PE i włókniny PP serwety: PP/PE 62g/m² plus dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej : Spunlace 70g/m².

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

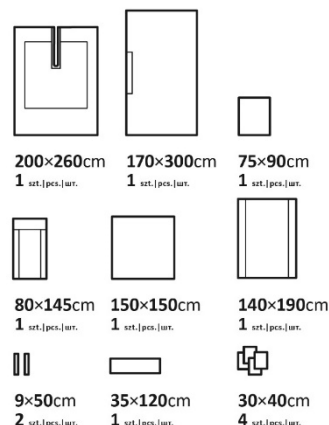

Pytanie 105. Dotyczy zadania 96: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z 2 naklejkami typu TAG służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 96 poz. 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Fartuch operacyjny, chirurgiczny, jednorazowy, jałowy wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tylne części fartucha zachodzące na siebie, u góry zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, sposób założenia fartucha zapewnia zachowanie sterylności z przodu i z tyłu, gramatura min. 35 g/m ² , odporność na penetrację płynów ≥ 35 H ₂ O, odporność na rozzerwanie na sucho ≥ 80 kPa, wytrzymałość na mokro ≥ 80 N. Opakowanie papier - folia, posiadające min. 2 naklejki, służące do wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiar: M, XL, XXI.	szt.	3 500
----	---	------	-------

Pytanie 106. Dotyczy zadania 97: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych o wytrzymałości na rozciąganie na mokro min 41 N. Pozostałe zgodnie z SWZ.


Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 107. Dotyczy zadania 97: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z włókniny typu SMMMS o wytrzymałości na rozciąganie na mokro min 88 N. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 108. **Dotyczy zadania 103:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 x czerwona osłona na stolik Mayo,
- 1 x główna serweta 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przyklepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem.
- 1 x nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,
- 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 1 x ręcznik celulozowy 30x40cm

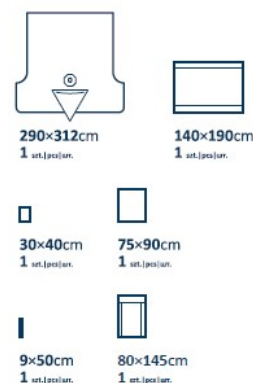

Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 109. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 92, Pętla z siateczką, jednorazową, do bezpiecznego wychwytywania polipów i ciał obcych. Siatka poliestrowa rozpostarta na niebieskiej pętli z metalowego drutu o wymiarach 30x55 mm, dł. narzędzia 230cm, średnica cewnika 2,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 92 poz. 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Pętla z siateczką jednorazowa do bezpiecznego wychwytywania polipów i ciał obcych. Siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30x55-60 mm dł. narzędzia 230cm, średnica cewnika 2,5-2,6 mm, obrotowa	szt.	40
----	---	------	----

Pytanie 110. Czy w pakiecie nr 4 igła typu Spinocan oznacza to samo co w pakiecie nr 3 czyli „jednorazowa typu Spinocan. W obsadce igły pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmianą barwy. Uchwyt o eliptycznym przekroju z 4 okienkami”?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 111. Pakiet 101. Czy przyrząd ma być z zastawką na końcu drenu, która zapobiega cofaniu się krwi do linii?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 112. Pakiet nr 6. Proszę o dopuszczenie zestawu bez grota do nacinania skóry jeżeli przednia krawędź igły Tuohy jest wystarczająco ostra.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 113. **PAKIET NR 40:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laparoskopowych wykonanego z laminatu 2- warstwowego z dodatkowym wzmocnieniem (padem chłonnym) stanowiącym trzecią warstwę i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne	320 x 250/180 cm
1 taśma przylepna	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 114. **PAKIET NR 41:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocz (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezłateksowa do badania per rectum	185 x 200/280 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 41 poz. 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw do operacji urologicznych 2-warstwowy. Skład zestawu: 1) serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, 2) taśma przyklepna, 3) 1 serweta TUR 175-270 x 170-225 cm zintegrowana z nogawicami, z przyklepnym otworem o średnicy 5-7 cm, z torbą na płyny z filtrem i poretem do ssaka oraz otworem nadłonowym 5-8cm. Tolerancja wymiarów +/- 10%. Opakowanie papier - folia, przynajmniej dwie naklejki do wklejenia do dokumentacji.	zestaw	200
----	--	--------	-----

Pytanie 115. **PAKIET NR 42:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 x serweta na stolik Mayo	80 x 145 cm
4 x ręczniki celulozowe	33 x 30 cm
2 x taśma przyklepna	10 x 50 cm
1 x serweta extra wzmocniona, U przyklepne 10 x 95 cm (pad z wiskozy)	245 x 280 cm
1 x serweta wzmocniona przyklepna z warstwą przyklepną 100 cm	300 x 170 cm
1 x serweta 2- warstwowa nieprzyklepna	90 x 75 cm
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona	190 x 150 cm
1 x osłona na kończynę 2- warstwowa	35 x 120 cm

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 116. **PAKIET NR 44:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania polietylenowej osłony zabezpieczającej kable video i optykę endoskopową w rozmiarze: 13 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 44 poz. 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Pokrowiec na przewody 15-17 x 240cm. Tolerancja wymiarów +/- 20%. Elastyczna końcówka. Wykonany z folii (polietylenu).	szt	2 750
----	--	-----	-------

Pytanie 117. **PAKIET NR 48:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pooperacyjnego powleczzonego klejem kauczukowym?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 118. **PAKIET NR 48 – pozycja nr 4:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pooperacyjnego w rozmiarze 8 x 15 cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 119. **PAKIET NR 96:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha zapinanego pod szyją na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu, o wytrzymałości na rozciąganie podłużne na mokro (md): min. 100 N i o wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne na mokro (cd): min. 40 N, w opakowaniu papier-folia z 2 naklejkami służącymi do wklejenia w dokumentację medyczną, w rozmiarach: M, XL, XXL?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 120. **PAKIET NR 97:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha zapinanego pod szyją na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu, o wytrzymałości na rozciąganie podłużne na mokro (md): min. 130 N i o wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne na mokro (cd): min. 80 N?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 121. **PAKIET NR 98:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej, poliuretanowej opatrunku do opatrywania i mocowania kaniul dożylnych do naczyń obwodowych, w rozmiarze: 12 x 10 cm? Silna przyczepność oraz dołączone paski mocujące zapewniają niezawodne mocowanie opatrunku w trakcie jego noszenia. Opatrunek wykonany jest z miękkiej włókniny oraz powlekanego laminatu, który stanowi materiał podłoża.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 122. **PAKIET NR 103:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy	150 x 100 cm
1 serweta operacyjna do ginekologii/ cystoskopii nieprzyklepna z otworem (8 x 12 cm)	75 x 200 cm
1 serweta nieprzyklepna	75 x 90 cm
2 osłony na kończynę długie	75 x 140 cm
2 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 123. **PROJEKT UMOWY 1. § 7, ust. 1-** wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych w następującym zakresie:

- §7 ust. 1, pkt 1.1 do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia,
- §7 ust. 1, pkt 1.2 do kwoty 0,5% wartości reklamowanej części zamówienia
- §7 ust. 1, pkt 1.3 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy
- §7 ust. 1, pkt 1.4 – wykreślenie zapisu umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 124.** **Pakiet 1 poz.2:** Czy Zamawiający dopuści koreczek, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi korka, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 125.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści wycenę za opakowanie a’ 100 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.
- Pytanie 126.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści koreczek z trzpieniem minimalnie powyżej krawędzi?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 127.** Pakiet 1: Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Wydzielenie umożliwi stworzenie pakietów, gdzie każdy z nich będzie spójny pod względem kategorii i rodzaju oferowanych materiałów, co a tym idzie umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 128.** Pakiet 1: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 129.** Pakiet 1 poz. 2 Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 130.** Pakiet 18: Czy zamawiający wydzieli poz. 1,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Wydzielenie umożliwi stworzenie pakietów, gdzie każdy z nich będzie spójny pod względem kategorii i rodzaju oferowanych materiałów, co a tym idzie umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 131.** PAKIET 52: Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 132.** PAKIET 52: Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 133.** PAKIET 99: Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek 2 litry do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 134.** **Pakiet 31:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Zamknięty, niskociśnieniowy zestaw do drenażu pooperacyjnego składający się poliuretanowej komory ssącej o poj. 110 ml z własnym systemem podwieszania, z 2 zastawkami antyzwrotnymi na wejściu i wyjściu, generującego podciśnienie 75 mmHg, z drenu łączącego z kłamrą i łącznikiem do

dedykowanego drenu pooperacyjnego; z wymiennego worka na drenaż wolnego od PVC o poj. 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem hydrofobowym; z drenu pooperacyjnego typu Redon, dł. 75 cm, w rozmiarach 10/14/18CH do wyboru. Zestaw pakowany podwójnie.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 135. **Pakiet 37:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maty antypoślizgowej zawierającej pod spodem dwie taśmy lepne o szerokości 2,5 cm, umożliwiające mocowanie maty w dowolnym miejscu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 136. **Pakiet 40:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny zestaw do laparoskopii. Skład zestawu:

1 x osłona na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części centralnej

2 x ręcznik chłonny 60x40 +/-2cm

1 x serweta do laparoskopii 255x300 cm +/- 2cm z otworami: brzuszny 34x38 cm z folią operacyjną wokół brzegów oraz rektalny 11x14cm z klapką, ze wzmocnieniem chłonnym 55x70cm +/- 1cm. Wraz z serwetą zintegrowane osłony na kończyny, 2 dwudzielne torby na narzędzia oraz 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego trójwarstwowego laminatu (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max.66 g/m², pozbawionego pyjących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤1,9 log₁₀). Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). Wokół otworów wzmocnienie chłonne 55x70cm +/- 1cm z niepyjących włókien sztucznych (gramatura łączna 140 g/m²), odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (>570kPa). I klasa palności.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 137. **Pakiet 41 Pyt 1.** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie **Zestaw do zabiegów urologicznych**. Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem

1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm, z nieprzylepnymi końcami z obu stron

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, dzięki której podczas rozpięcia nie spowoduje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna zaokrąglona 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 14cm

2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przylepcami do fiksacji, z przylepnym otworem brzuszny ∅ 8 cm, z przylepnym otworem na pręcie ∅ 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepną do fiksacji z fartuchem operatora. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max.58g/m² pozbawionego pyjących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log₁₀ i wysokiej odporności na przenikanie płynów min. 165 cm H₂O. I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 138. **Pakiet 41: Pyt 2.** Czy Zamawiający oczekuje aby worek na płyny był wyposażony w troki i taśmę lepną do fiksacji serwety z fartuchem operatora?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 139. **Pakiet 42 :** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: **Sterylny zestaw do operacji biodra. Skład zestawu:**

1x serweta na stół narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem

1x serweta na stół Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

5x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm

1x osłona na kończynę 34x120cm 2-warstwową, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

1 x serweta 190x190 cm długość przylepca 85 cm

1x serweta górna 300x220 +/-2cm długość przylepca 130 cm

1x serweta do operacji biodra 230x305 +/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm, z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzone w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie i obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o gramaturze max. 58g/m², niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log₁₀, wysokiej odporności na przenikanie płynów > 175 cm H₂O. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze >121g/m² i wysokiej absorpcji > 700ml/m². I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm

zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 140. **Pakiet 44 :** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony z dodatkową taśmą lepną 1,8x20 cm do fiksacji na głowicy i dodatkowym przylepcem paskowym 15 cm z drugiej strony osłony.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141. **Pakiet 46:** Prosimy o dopuszczenie podkładu w rozmiarze ok.60x90 cm, o chłonności 1600 ml.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 142. **Pakiet 46 :** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu zachowania komfortu i bezpieczeństwa pacjenta oraz suchości produktu wymaga szybkiego odprowadzania wilgoci, tj. min. 65 mm w czasie 1 minuty, zgodne z ISO 9073-6?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 143. **Pakiet 46:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana chłonność ma być potwierdzona badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z aktualnie obowiązującą normą ISO 9073-6?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 144. **Pakiet 56 poz.1-2 :** Prosimy o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego (min.200 mmH₂O) i oddychający (min. 3800 g/m²/24h) na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m². Przebadany na przenikanie min. 14 cytostatyków (wyniki badań załączone do oferty). Oznakowany jako wyrób medyczny klasy Is oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodny z EN 14605.

Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha scalone podłużnym zgrzewem. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny min. 65x35 cm. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w 2 rozmiarach.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 145. **Pakiet 58 :** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: maska ochronna dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65 % , penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,45 mbar. Op. 10szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 146. **Pakiet 85:** Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje markera z linijką wykonaną z papieru syntetycznego, która utrzymuje stabilność nawet, gdy staje się mokra.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147. **Pakiet 96 :** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o szwach wykonanych metodą klejoną które zapewnią lepszą barierowość niż szwy ultradźwiękową, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 148. **Pakiet 96 :** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o rozmiarze S/M odpowiadającym rozmiarowi M, pozostałe rozmiary zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149. **Pakiet 96:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z ręcznikami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m². Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811 ≥20cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥40kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥20N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 2,9IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 ≤4,0 log₁₀, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-

123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękami do rąk. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 150. **Pakiet 97:** Pyt. 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o szwach wykonanych metodą klejoną które zapewnia lepszą barierowość niż szwy ultradźwiękową, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 151. **Pakiet 97:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o rozmiarze S/M odpowiadającym rozmiarowi M, pozostałe rozmiary zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 152. **Pakiet 97 :** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z rękami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m² z dodatkowym wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 66g/m² w części przedniej i na rękawach. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN ISO 811 ≥ 100 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥ 40 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥ 20 N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6,0IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0$ log₁₀, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1 ≤ 300 . Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękami do rąk. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 153. **Pakiet 103:** Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu ginekologiczno – urologicznego. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej

1 x osłona na stolik Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88 cm

2 x rękawik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta ginekologiczna przylepna 35/40x114 cm z otworem przylepnym w kształcie serca 9x12cm

1 x serweta ginekologiczna 175/280x242 cm z otworem 12x25 cm z osłonami na kończy.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max. 58g/m², pozbawionego pyjących włókien celulozy i jej pochodnych o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7$ log₁₀, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H₂O, odpornego na rozerwanie mokro/sucho powyżej 145 kPa. I klasa palności Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 154. **Pakiet 17:** W związku ze zmianami wprowadzonymi przez producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur o składzie:

Dwa osobne opakowania każde zawierające:

- Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu,

- płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml

Cztery osobne opakowanie zawierające:

-Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu, z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką,

- płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 17 poz. 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	<p>Zestaw do 24 - godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny lub 0,12% roztworem chlorheksydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,1%-1,5% roztworem nadtlenu wodoru, 6 gąbek - aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.</p> <p>LUB</p> <p>Dwa osobne opakowania każde zawierające: - Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, - płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających w wyciskanej saszetce, 7ml</p> <p>Cztery osobne opakowanie zawierające: -Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu, z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, - płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających w wyciskanej saszetce, 7ml Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.</p>	zestaw	150
----	---	--------	-----

Pytanie 155. **Pakiet 2** Poz1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli bez portu bocznego, z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia, w roz. 26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min 26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min opakowanie folia-papier .

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 156. **Pakiet 2** Poz2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli bez portu bocznego, z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia, w roz. 24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ 16 ml/min. Opakowanie folia – papier.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 157. **Pakiet 20:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego Tiemann o długości 74 cm z mandrynem poliesterowym, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 158. **Pakiet 23** Poz.1-2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw powinien posiadać maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy oraz czy cewnik powinien być wstępnie połączony z popychaczem sterowalnym?

Czy Zestaw powinien posiadać popychacz sterowalny umożliwiający zmianę położenia cewnika nawet po usunięciu przewodnik z układu moczowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 159. **Pakiet 30:** Prosimy o sprecyzowanie czy w skład zestawu rozszerzadef powinny wchodzić rozszerzadła w rozmiarze CH6; 8; 10; 12; 14?

Odpowiedź: Tak. Pakiet nr 30 poz. 1 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw rozszerzadef prostych (dostęp przezskórny do nerki) CH 6;8;10; 12;14	zestaw	20
----	---	--------	----

Pytanie 160. **Pakiet 82:** Prosimy o sprecyzowanie czy w skład zestawu powinny wchodzić rozszerzadła o rozmiarach CH6; 8; 10?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 161. **Pakiet 79:** Poz.1 i 2: 1.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowana woda do nawilżania tlenu ma posiadać termin przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od daty produkcji, co pozwoli na wykorzystanie wody zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 162. **Pakiet 79:** Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy na opakowaniu jednostkowym mają się znajdować oryginalnie nadrukowane napisy w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 163. **Pakiet 79:** Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym tj. 58 op po 340ml), ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenu etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H₂O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim. Instrukcja użycia dołączona do kartonu zbiorczego lub pojedynczego opakowania.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 164. **Pakiet 79:**
Poz.2: 1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 6500ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym tj. 47 op po 650ml), ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenu etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H₂O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim. Instrukcja użycia dołączona do kartonu zbiorczego lub pojedynczego opakowania.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 165. **Pakiet 79:** Poz.2: 2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H₂O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. Instrukcja użycia dołączona do kartonu zbiorczego lub pojedynczego opakowania.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin:

- składania ofert: 14.09.2023 r. godz. 10:00;
- otwarcia ofert: 14.09.2023 r. godz. 10:30;
- termin związania ofertą: 13.10.2023 r.

Zamawiający zwraca się z prośbą aby w przypadku dopuszczenia parametrów/postanowień innych niż opisane w SWZ, Wykonawca zaznaczył, iż parametry/postanowienia zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem się na datę oraz numer udzielonych odpowiedzi.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTU.

DOKUMENT W ORYGINALE PODPISANY PRZEZ

WICEPREZEZ ZARZĄDU PODDĘBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

– LEK. MED. URSZULĘ MARIJAŃSKĄ