

Pruszków, dnia 21.10.2021 r.

Nr postępowania: ZP.272.15.2021

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SPZZOZ w Pruszkowie w ramach zadania: „Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym Centralnej Sterylizacji dla BO)”

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Umowa – par. 2, pkt 4.

Prosimy o doprecyzowanie jakie dokumenty zobligowany jest dostarczyć wykonawca na wezwanie zamawiającego - czy te wymienione w ust. 8) powyżej czy też jakiegokolwiek, jakie zamawiający sobie zażyczy.

Odpowiedź:

Zamawiający w paragrafie 2 w punkcie 3 ppkt 8 dokładnie wylistował oczekiwane dokumenty,

Zatem Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Umowa – par. 2, pkt 5 - sprzęt do wyposażenia Centralnej Sterylizatorni jest na tyle powszechnym i wymiennym sprzętem, że można go prosto zastąpić w 48 godzin? Prosimy o zmianę SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z Dotacją celową zamawiający musi odebrać sprzęt wolny od wad,.

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Umowa – par. 4 - Zgodnie z art. 436 pkt 1) ustawy Pzp termin realizacji umowy powinien być określony jako ilość dni/ tygodni/ miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający o ile nie ma uzasadnienia, a my mamy konkretną dotację z określoną datą rozliczenia.

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Umowa – par. 6. Pkt 12 - Zazwyczaj w postępowaniach tego typu wymianę na nowy zastrzega się po 3-krotnej nieudanej naprawie tego samego podzespołu. W niniejszym przypadku są tylko 2 takie naprawy, a w dodatku dotyczą nie podzespołu a całego sprzęt - 2-krotna naprawa jakiegokolwiek usterki w sprzęcie = konieczności wymiany sprzętu na nowy. Prosimy o zmianę zapisu na „trzykrotnej”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Umowa – kary: par. 7 – prosimy o zmniejszenie kar do 0,5%. Kara 5 % jest relatywnie wysoką karą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Umowa – kary: par. 7 - Prosimy o naliczanie kar od wartości niedostarczonego sprzętu, nie od wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Umowa – kary – par. 7, pkt. 1, 4) – prosimy o zmniejszenie kar z 15 do 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Umowa – kary – par. 7, pkt. 1, 5) – jest to kara niezwiązana z przedmiotem umowy, wobec czego stanowi klauzulę abuzywną w rozumieniu art. 433 pkt 2) ustawy Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje montażu i zniszczenia lub uszkodzenia mogą mieć miejsce i dlatego przewidziano za nie kary.

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Umowa – par. 7 – pkt. 3 – limit kar umownych - prosimy o zmniejszenie z 30 do 20 %.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 1

Prosimy o zmianę we wzorze umowy:

§6 Rękojmia za wady i gwarancja punkt 3 z :

W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi za wady lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 48 godzin od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że wystąpienie określonej wady lub usterki wymaga podjęcia natychmiastowego działania z uwagi na zagrożenie zdrowia pacjentów i wówczas czas przystąpienia do naprawy wynosi do 24 godzin.

Na:

W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi za wady lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że wystąpienie określonej wady lub usterki wymaga podjęcia natychmiastowego działania z uwagi na zagrożenie zdrowia pacjentów i wówczas czas przystąpienia do naprawy wynosi do 24 godzin w dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 2

Prosimy o zmianę we wzorze umowy:

§6 Rękojmia za wady i gwarancja punkt 4 z:

Każda naprawa gwarancyjna nie może trwać dłużej niż 5 dni od dnia zgłoszenia wystąpienia wady lub usterki.

Na:

Każda naprawa gwarancyjna nie może trwać dłużej niż 5 dni robocze od dnia zgłoszenia wystąpienia wady lub usterki a jeśli zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych spoza granic Polski czas naprawy wydłuża się do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia wystąpienia wady lub usterki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 3

Prosimy o wykreślenie punktu 8 §6 Rękojmia za wady i gwarancja o brzmieniu: „Jeżeli czas naprawy przekroczy 5 dni Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach niż sprzęt, który wymaga naprawy oraz spełniającego wymagania Umowy. Dostarczenie sprzętu zastępczego nastąpi najpóźniej w dniu, w którym upływa termin dokonania naprawy wadliwego sprzętu.,,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Prosimy o zmianę punktu 12 §6 Rękojmia za wady i gwarancja z:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy po dwóch naprawach gwarancyjnych tego samego sprzętu w przypadku dalszego wadliwego działania sprzętu. Procedura opisana w niniejszym ustępie nie dotyczy uszkodzeń powstałych z winy użytkownika”

Na:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu w przypadku dalszego wadliwego działania sprzętu. Procedura opisana w niniejszym ustępie nie dotyczy uszkodzeń powstałych z winy użytkownika”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia na 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada konkretną dotację i nie może określać terminu w tygodniach, bo ma wskazaną datę rozliczenia dotacji.

Pytania dotyczące: STERYLIZATOR PAROWY PRZELOTOWY 8 STU

Pytanie 6 Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Pozioma przelotowa komora sterylizatora, z pierścieniowym płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, drzwi i komora wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L, izolowane termicznie." ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 7 Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Dwa oddzielne zawory bezpieczeństwa, jeden na komorze, drugi wspólny dla płaszczka grzejnego oraz wytwornicy pary sterylizatora, elementy mające styczność z parą wodną wykonane ze stali kwasoodpornej, korpus z mosiądzu ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 8 Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Wytwornica pary z system automatycznego podgrzewania wody w zbiorniku głównym, wykonanie kotła, armatury i grzałek ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L, automatyczny system spustu wody z wytwornicy, izolowana termicznie. ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza i nie wymaga.

Pytanie 9 Dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści w zamian: 3 programy testowe i przygotowawcze (Bowie Dick, szczelności, program rozgrzewający). ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 10 Dot. pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Po stronie załadowniczej analogowa (wartości parametrów) i graficzna (wskaźnik postępu cyklu) prezentacja przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym na ekranie sterownika z wyświetlaniem informacji o numerze i nazwie aktualnego programu, etapie cyklu, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, informacji o błędach, wszystkie komunikaty w języku polskim ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 11 Dot. pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Wyłączniki bezpieczeństwa na panelach czołowych po stronie załadowniczej i wyładowniczej oraz wyłącznik zasilania elektrycznego na ścianie w pobliżu urządzenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 12 Dot. pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Rejestracja parametrów cyklu w języku polskim, wydruk parametrów cyklu na wbudowanej w sterylizator drukarce panelowej, wydruk wartości ciśnienia i temperatury w komorze, wydruk wykresu temperatury i ciśnienia w funkcji czasu ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 13 Dot. pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Program serwisowy/diagnostyczny w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz możliwością w trybie serwisowym aktywowania lub dezaktywowania podzespołów poprzez dotknięcie odpowiednich pól na ekranie dotykowym ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 14 Dot. pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści w zamian: W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz w wytwornicy pary. ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 15 Dot. pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Zawory procesowe sterowane pneumatycznie i wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 z przyłączami gwintowymi zabezpieczającymi przed przypadkowym odłączeniem elementów i wypływem gorącej pary wodnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza i nie wymaga.

Pytanie 16 Dot. pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Drzwi komory napędzane pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrąfią one na opór oraz z możliwością otwarcia awaryjnego przy zaniku zasilania elektrycznego. Bez widocznych elementów napędu

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza i nie wymaga.

Pytanie 17 Dot. pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą systemu próżniowego, z dwustopniową pompą z pierścieniem wodnym i napędem silnikiem elektrycznym, zapewniającego niski poziom hałasu poniżej 70 dB (zgodnie PN-EN 285 oraz PN-EN 3746) i wytworzenie próżni min. 40 mbar, bezobsługowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 18 Dot. pkt. 41

Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego Centralnej Sterylizatorni, o którym Zamawiający wspomina w SWZ – rozdział IV, Opis przedmiotu zamówienia, zawierający wszystkie rysunki branżowe (wod-kan, wentylacja, elektryka, gazy medyczne, teletechnika)

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia rysunki branżowe.

Pytanie 19 Dot. pkt. 41

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o innych gabarytach jeśli Wykonawca na własny koszt przystosuje miejsce instalacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wymaga dostosowania pomieszczeń, instalacji, infrastruktury na koszt Wykonawcy.

Pytanie 20 Dot. pkt. 41

Kto będzie ponosił koszty dostosowania instalacji doprowadzających media do urządzeń jeśli takie dostosowanie będzie konieczne ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wszelkich dostosowań do potrzeb oferowanego sprzętu po stronie Wykonawcy, o ile zaistnieje taka potrzeba.

Pytania dotyczące: MYJNIA DEZYNFEKTOR PRZELOTOWA

Pytanie 21 Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Podgrzewanie elektryczne, grzałki w komorze spustowej w celu higienicznego oczyszczania komory. Moc grzałek komory 18 kW ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ,.

Pytanie 22 Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Pojemność na jeden wsad: 18 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480x250x50 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 23 Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez kontroli pracy ramion natryskowych w myjni i wózkach wsadowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 24 Dot. pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Po stronie załadowniczej analogowa (alfanumeryczna) i graficzna (wskaźnik postępu cyklu) prezentacja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym z wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, wartości A0 i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 25 Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Rejestracja parametrów cyklu w języku polskim, wydruk parametrów cyklu na wbudowanej drukarce panelowej, wydruk wartości temperatury w komorze ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 26 Dot. pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Program serwisowy/diagnostyczny w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz możliwość w trybie serwisowym aktywowania lub dezaktywowania podzespołów poprzez dotyk ikony podzespołu ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 27 Dot. pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści w zamian: dopuści Pompa o wydajności 750 l/min, do natrysku wody oddzielnie w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 28 Dot. pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Min.4 pompy dozujące środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy w mililitrach/gramach środka chemicznego bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu oddzielnie ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 29 Dot. pkt. 41

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Maksymalne wymiary zewnętrzne myjni: 1110 x 990 x 2000 mm (sxgxw) ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza pod warunkiem dostosowania na koszt dostawy wszelkich instalacji, infrastruktury i pomieszczeń.

Pytanie 30 Dot. pkt. 43, 44

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki wymagając aby myjnię zgodne były z dokumentem ISO/TS 15883-5, który dotyczy: Zanieczyszczeń testowych i metod stosowanych do demonstracji skuteczności mycia ? ISO/TS 15883-5 wciąż jest jedynie niezatwierdzoną propozycją normy.

Prosimy o usunięcie tego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Zamawiający zwraca uwagę że odwołanie zawarte w SWZ dotyczy **CEN ISO/TS 15883-5**: i jest to ogólnie obowiązująca specyfikacja techniczna a nie jak sugeruje pytający „ niezatwierdzona propozycja normy „

Pytanie 31 Dot. pkt. 63

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Górny poziom wózka z 48 przyłączami do narzędzi rurowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 32 Dot. pkt. 68

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Taca z uchwytami na 2 optyki sztywne, z zamykaną pokrywą, wykonana z drutu ze stali kwasoodpornej, taca o wymiarach – 52 x 80 x 460 (WxSxD) – 4 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza nie wymaga, pod warunkiem zachowania parametrów użytkowych zapisanych w SWZ.

Pytanie 33 Dot. pkt. 68

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Taca z uchwytami na 2 optyki sztywne, z zamykaną pokrywą, wykonana z drutu ze stali kwasoodpornej, taca o wymiarach – min. 80 x 150 x 480 (WxSxD) – 4 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza nie wymaga, pod warunkiem zachowania parametrów użytkowych zapisanych w SWZ.

Pytanie 34 Dot. pkt. 69

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Koszyk z drobnej siatki o wymiarach min. 80x80x40mm – 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza nie wymaga, pod warunkiem zachowania parametrów użytkowych zapisanych w SWZ.

Pytania dotyczące: STERYLIZATOR PLAZMOWY PRZELOTOWY

Pytanie 35 Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemność użytkową komory 160 litrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza i nie wymaga.

Pytanie 36 Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści wymiary użytkowe komory 460 x 710 x 500 mm (SxGxW)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości użytkowych pomieszczeń, zachowania dogodnych warunków eksploatacji urządzeń oraz dostosowania wszelkich instalacji i pomieszczeń na koszt dostawcy.

Pytanie 37 Dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ

Pytanie 38 Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści jeden pojemnik z nadtleniem wodoru na 14 cykli sterylizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza i nie wymaga.

Pytanie 39 Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wstępnie podgrzewające i osuszające wsad zamiast czujnika wilgotności ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 40 Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie niewymagające sprężonego powietrza a tym samym bez wbudowanego kompresora ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 41 Dot. pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Trzy cykle sterylizacyjne: szybki – ok. 31 min, standardowy – ok. 48 min, intensywny – ok. 57 min.) ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 42 Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Zasilanie elektryczne – trójfazowe 380-415 V; VAC/16A/50Hz; moc 3,2 kW ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 43 Dot. pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: 680 x 864 x 1910 mm (SxGxW) ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości użytkowych pomieszczeń, zachowania dogodnych warunków eksploatacji urządzeń oraz dostosowania wszelkich instalacji i pomieszczeń na koszt dostawcy.

Pytanie 44 Dot. pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści w zamian: Wyposażony w 2 kosze wsadowe, o wymiarach dopasowanych do komory urządzenia, wykonane ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości użytkowych pomieszczeń, zachowania dogodnych warunków eksploatacji urządzeń oraz dostosowania wszelkich instalacji i pomieszczeń na koszt dostawcy.

Pytanie 45 Dot. pkt. 18

Czy Zamawiający ma na myśli odczyt po maks. 20 minutach?

Odpowiedź:

TAK -szybki odczyt

Pytanie 46 Dot. pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści inkubator z większą ilością celi niż 3?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza i nie wymaga.

Pytania dotyczące: KONTENERY STERYLIZACYJNE

Pytanie 47

Dot. pkt. 1-16

Czy Zamawiający dopuści w zamian kontenery o poniższych parametrach:

Kontenery przeznaczone do sterylizacji narzędzi chirurgicznych oraz bielizny operacyjnej

Pracujące w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji

Wyposażone w automatyczny wskaźnik sterylności i 1000szt plomb/1 kontener

Konstrukcja: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową,

Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa.

Kontenery wyposażone w tabliczki opisowe po obu stronach wanny umożliwiające identyfikację kontenera

Pokrywy lub rączki wanny w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim lub szarym do wyboru przez Zamawiającego.

Wymiary i ilości kontenerów:

Szerokość x głębokość x wysokość (mm):

600x300x272 – 10 szt.

450x300x164 – 5 szt.

300x300x122 – 5 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 48 dotyczące: TACA NARZĘDZIOWA 1/1 DIN

Dot. pkt. 1-6

Czy Zamawiający dopuści tace sterylizacyjne z siatki z drutu ze stali kwasoodpornej AISI304, z chowanymi uchwytami, o wymiarach długość 480 mm x wysokość 50mm x szerokość 240 mm, z bokami z perforowanej blachy ze stali kwasoodpornej AISI304 z zaokrąglonymi narożnikami, z pokrywą z siatki ze stali kwasoodpornej AISI304 ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 49 dotyczące: TACA NARZĘDZIOWA 1/2 DIN

Dot. pkt. 1-6

Czy Zamawiający dopuści tace sterylizacyjne z siatki z drutu ze stali kwasoodpornej AISI304, z chowanymi uchwytami, o wymiarach długość 250 mm x wysokość 50mm x szerokość 240 mm, z bokami z perforowanej blachy ze stali kwasoodpornej AISI304 z zaokrąglonymi narożnikami, z pokrywą z siatki ze stali kwasoodpornej AISI304 ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pyt. 1. Dotyczy wózek na worki na odpadki (Strefa brudna 0/21, Strefa czysta 0/15.) Czy zamawiający dopuści do oceny wózek pojedynczy do worków foliowych 120L, z pokrywą, 440x440x985 mm, wymiar nie zmienia funkcjonalności wózka. Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 2. Dotyczy wózek do transportu z podwójnym blatem (Strefa brudna 0/21, Strefa czysta 0/15, Strefa sterylna, 0/09.)

Czy zamawiający do oceny wózek z podwójnym blatem zagłębionym, wym. blatów 750x600 mm, wym. 880x600x880 mm, wymiar nie zmienia funkcjonalności wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 3. Dotyczy stół roboczy z dwoma komorami zlewozmywakowymi (Strefa brudna 0/21.) Czy zamawiający dopuści stół o wymiarach komór 500x400x250 mm, zaproponowany wymiar komór nie zmieni funkcjonalności mebla.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 4. Dotyczy System komputerowy: Komputer All In One (ekran dotykowy, FullHD, procesor minimalna wydajność obliczeniowa 12,488 w teście Single CPU Systems wynik potwierdzony wydrukiem ze strony www.cpubenchmark.net, RAM 8GB, dysk SSD 500GB, Ethernet, System operacyjny aktywnie wspierany przez producenta systemu aktualizacjami i poprawkami bezpieczeństwa, współpracujący z domena Active Directory).

Czy Zamawiający z uwagi na brak dostępności na rynku dopuści komputery o niższym współczynniku Single CPU System (www.cpubenchmark.net) przy zachowaniu pozostałych parametrów? Zamiana nie powoduje zmiany mającej wpływ na właściwości użytkowe i funkcjonalne systemu komputerowego opisanych w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza niższy współczynnik Single CPU System (www.cpubenchmark.net) w zakresie +/- 20% przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Dotyczy: załącznika nr 5 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia),

Asortyment: KOSZ 1 STE, ilość 50 sztuk. Strefa sterylna 0/09:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszy o wymiarach: 575x280x265mm?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Wymiary koszy są zależne od zaproponowanych przez Wykonawcę/ Oferenta urządzeń – np. autoklawy.

Asortyment: KOSZ 0,5 STE, ilość 20 sztuk. Strefa sterylna 0/09:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszy o wymiarach: 575x280x135mm?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Wymiary koszy są zależne od zaproponowanych przez Wykonawcę/ Oferenta urządzeń – np. autoklawy.

Asortyment: WÓZEK DO PRZEWOZU MATERIAŁÓW STERYLNYCH, ilość 6 sztuk.

Mycie wózków 0/18, Suszenie wózków 0/17, Przyjmowanie materiału 0/26, Ekspedycja 0/08.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w kółka fi 160mm?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z drzwiami podwójnymi, otwieranymi skrzydłowo na 270 stopni?
3. Czy Zamawiający może bardziej szczegółowo opisać, co ma na myśli pisząc „wyposażenie w postaci pianki do zabezpieczenia na 72 h – karton (min. 1 szt)?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie zaznaczając jednocześnie, że wymiary są zależne od dostarczonego pozostałego wyposażenia Centralnej Sterylizacji.

Asortyment: WÓZEK NA PAPIER, ILOŚĆ: 3 SZT. Strefa czysta 0/15, Pakowanie tekstyliów 0/16

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w poręcze wykonane z profili kwadratowych?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Asortyment: STÓŁ ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ, ILOŚĆ: 2 SZT. Strefa czysta 0/15, Pakietowanie tekstyliów 0/16

1. Czy Zamawiający może podać, jakiej długości ma być szafka z 3 szufladami? Proszę o potwierdzenie, że na pozostałej części stół ma mieć półkę dolną

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ. Zamawiający nie przewiduje precyzowania rozmiarów szafek z szufladami.

Asortyment: STÓŁ ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ, ILOŚĆ: 1 SZT. Ekspedycja 0/08

1. Czy Zamawiający może podać, jakiej długości ma być szafka z drzwiczkami? Proszę o potwierdzenie, że na pozostałej części stół ma mieć półkę dolną

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ. Zamawiający nie przewiduje precyzowania rozmiarów szafek z drzwiczkami.

Asortyment: STÓŁ ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ, ILOŚĆ: 1 SZT. Przyjmowanie materiału 0/26

1. Czy Zamawiający może podać, jakiej długości ma być szafka z drzwiczkami? Czy na całej długości pod blatem czy tylko na części?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ. Zamawiający nie przewiduje precyzowania rozmiarów szafek z drzwiczkami.

Asortyment: STÓŁ OCIEKOWY, ILOŚĆ: 1 SZT. Strefa brudna 0/21

1. Czy Zamawiający może podać, jakiej wysokości ma być fartuch z blachy wywinięty na ścianę? Standardowy 40mm czy wyższy?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ. Zamawiający nie przewiduje precyzowania wysokości fartucha.

Asortyment: STÓŁ ROBOCZY Z 2 KOMORAMI ZLEWOZMYWAKOWYMI, ILOŚĆ: 1 SZT. Strefa brudna 0/21

1. Czy Zamawiający może podać, jakiej wysokości ma być fartuch z blachy wywinięty na ścianę? Standardowy 40mm czy wyższy?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ. Zamawiający nie przewiduje precyzowania wysokości fartucha.

Asortyment: STÓŁ ROBOCZY Z PODŚWIETLANYM BLATEM, ILOŚĆ: 1 SZT Pakietowanie tekstyliów 0/16

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w nowoczesniejsze oświetlenie Ledowe?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w szybę bezpieczną o grubości 6.4mm?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu w którym blat wyposażony jest w szybę bezpieczną, mleczną bez dodatkowego wsparcia na płycie z plexi?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, dopuszcza i nie wymaga.

Asortyment: REGAŁ LISTWOWY NAŚCIENNY, ILOŚĆ: 2 SZT. Śluza 0/14, Śluza 0/20.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieszaka na 6 par obuwia?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, dopuszcza i nie wymaga.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półki wg poniższego opisu i wizualizacji?
Półka pełna. Półka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), zakończona galeryjką. Półka wykonana z blachy 1,5mm. Wymiary: 580x260x145 mm

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ,



dopuszcza i nie wymaga.

3. Czy Zamawiający może wyjaśnić, jakie ma być przeznaczenie i wygląd wieszaka uniwersalnego?

Odp.:


Wieszak uniwersalny przeznaczony na ubrania dla min. 5 osób.

Asortyment: PÓŁKA DŁ. 80CM, ILOŚĆ: 3 SZT. Strefa sterylna 0/09, Strefa czysta 0/15.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półki wg poniższego opisu i wizualizacji?
Półka pojedyncza, ścienna wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 30 mm, pozostałe boki proste. Półka z profili 25x25x1,5mm, blacha 1,2mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, dopuszcza i nie wymaga.

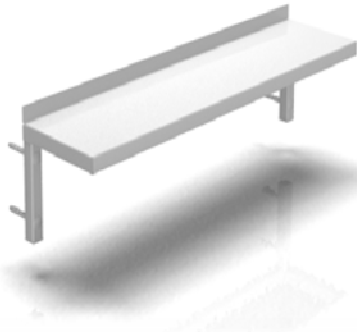

Asortyment: ZLEW JEDNOKOMOROWY, ILOŚĆ: 1 SZT Magazyn chemii 0/23

1. Czy Zamawiający może zweryfikować podane wymiary zlewu tj. dwa razy podano wysokość? Proszę też o podanie pożądanej wysokości fartucha oraz na którą stronę ma odchyłać się krata.

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ i doprecyzowuje wymiar 40cm dotyczy głębokości..

Zamawiający oczekuje

2. Czy komora zlewozmywakowa ma być na całej długości wyrobu?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, komora zlewozmywakowa nie stanowi dla Zamawiającego wartości istotnej, zatem Zamawiający nie precyzuje czy z wywinieściami bo bokach, czy bez.

Asortyment: ZLEW GOSPODARCZY, ILOŚĆ: 1 SZT Pomieszczenie porządkowe 0/25

1. Proszę o podanie pożądanej wysokości fartucha oraz na którą stronę ma odchyłać się krata.

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ. Zamawiający nie przewiduje precyzowania wysokości fartucha, a kratka powinna odchyłać się ergonomicznie dla pracy.

Asortyment: ZLEW JEDNOKOMOROWY, ILOŚĆ: 1 SZT Pomieszczenie mycie wózków 0/18

1. Proszę o podanie pożądanej wysokości fartucha oraz na którą stronę ma odchyłać się krata.

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ. Zamawiający nie przewiduje precyzowania wysokości fartucha, a kratka powinna odchyłać się ergonomicznie dla pracy.

2. Czy komora zlewozmywakowa ma być na całej długości wyrobu?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, komora zlewozmywakowa nie stanowi dla Zamawiającego wartości istotnej, zatem Zamawiający nie precyzuje czy z wywinieściami bo bokach, czy bez.

3. Proszę o podanie głębokości komory.

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, komora zlewozmywakowa nie stanowi dla Zamawiającego wartości na tyle istotnej, aby Zamawiający precyzował głębokość, skoro określił wysokość 90cm.

Asortyment: KRZESŁO ROBOCZE, ILOŚĆ: 11 SZT. Strefa brudna0/21, Strefa czysta 0/15 , Ekspedycja 0/08,Przyjmowanie materiału 0/26, Pakietowanie tekstyliów 0/16

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu z zakresem regulacji wysokości 490/630mm?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, dopuszcza i nie wymaga.

2. Proszę o modyfikację opisu, poprzez usunięcie zapisu o blokowaniu pokrywy. Zapis ten nie dotyczy taboretu.

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

3. Proszę o potwierdzenie, że zapis „regulacja położenia sprężyną gazową” dotyczy regulacji wysokości taboretu.

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Asortyment: WÓZEK DO TRANSPORTU Z PODWÓJNYM BLATEM
ILOŚĆ: 4 SZT. Strefa brudna0/21, Strefa czysta 0/15 , Strefa sterylna, 0/09

1. Czy Wykonawca ma zaoferować wózek z rączką do prowadzenia czy bez?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ. Zamawiający akceptuje oba rozwiązania.

2. Czy Zamawiający może podać pożądaną wysokość wózka?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ. Wózek musi być kompatybilny z pozostałym wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni

3. Czy Wykonawca ma zaoferować blat i półkę proste, czy zagłębione?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ. Zamawiający nie wie jak blat na wózku i półki miałyby być zagłębione.

Dotyczy terminu wykonania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do połowy stycznia 2022r? Proszę swoją motywację zbliżającym się końcem roku i spiętrzeniem zamówień na produkcji, jak również wydłużonymi terminami dostaw na podzespoły do gotowych wyrobów od naszych poddostawców.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada konkretną dotację i nie może określać terminu w tygodniach, bo ma wskazaną datę rozliczenia dotacji.

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

3. IV punkt 9 prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie asystent ma być dostępny dla Zamawiającego. Czy wsparcie telefoniczne jest wystarczające?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, Asystent powinien być dostępny na miejscu w naszej Centralnej Sterylizacji.

Dotyczy Umowy:

4. §1 ust 8 Prosimy o doprecyzowanie jakie prace wykończeniowo-instalacyjne są na tą chwilę planowane w tym samym czasie co montaż.

Montaż urządzeń medycznych powinien odbywać się w pomieszczeniach wykończonych, w których nie przebiegają żadne „prace brudne” czy powodujące zapylenie powietrza, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na stan techniczny urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż chodzi o dobrostan urządzeń, zatem do czasu zakończenia prac „brudnych” nie możemy prowadzić instalacji urządzeń, a Wykonawca na ten czas powinien je zabezpieczyć u siebie.

5. §2 ust 3 punkt 8 Prosimy o doprecyzowanie jaką dokumentację techniczną Zamawiający ma na myśli

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż chodzi o dokumentację wymienioną w SWZ,

6. §4 ust 1 punkt 1 oraz 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 12 tygodni od podpisania umowy.

Urządzenia medyczne są zamawiane u producenta według konkretnej specyfikacji i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający posiada konkretną dotację i nie może określać terminu w tygodniach, bo ma wskazaną datę rozliczenia dotacji.

7. §6 ust 3 Prosimy o dodanie, iż wskazany czas dotyczy dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody,

8. §6 ust 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody,

9. §6 ust 5 Prosimy o dodanie, iż ewentualne naprawy będą zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta.

Serwis przedmiotu zamówienia musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza zlecenie naprawy zastępczej osobie o ile posiada autoryzację producenta urządzenia.

10. §6 ust 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

11. §6 ust 12 Prosimy o modyfikację zapisu, tak aby dwie naprawy części/podzespołu stanowiły podstawę do wymiany danej części/podzespołu na nową w zamian za wymianę całego urządzenia.

Urządzenia tego typu składają się z setek i tysięcy części, oprogramowania i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, w tej sytuacji o ile będzie to wnioskowane przez Wykonawcę, dopuszczamy nowe brzmienie postanowienia:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany części sprzętu na nową po dwóch naprawach gwarancyjnych tej samej części sprzętu w przypadku jej dalszego wadliwego działania. Procedura opisana w niniejszym ustępie nie dotyczy uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.”

12. §7 ust 1 punkt 1-3 oraz 5-6 Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,1% wartości umowy.

Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis.

„§7 ust. 1 Wykonawca zapłaci kary umowne:

1) za zwłokę w dostawie, montażu i uruchomieniu Towaru w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 – w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”

poprzez zmianę wysokości kary z 5% na 2,5% co i tak jest karą znaczącą ale proszę uzgodnijmy to jeszcze z Kierownik KGP (dlatego też dodaję ją do wątku) bowiem w wypadku tej umowy każdy dzień zwłoki oznacza zapewne katastrofę dla terminu zakończenia zadania głównego (15.12.) a to z kolei realnie wiąże się z zagrożeniem dla wypłaty dofinansowania. Zatem zamysł był taki aby przypadkiem żaden wykonawca nie skalkulował późniejszej dostawy i obciążenia karami jako formy realizacji tego zamówienia. W tym wypadku inny termin realizacji przełoży się na termin odbioru budowy a Generalny Wykonawcy tylko czeka na pretekst do żądania wydłużenia terminu.

Dotyczy Parametry Techniczne:

12 Jako autoryzowany przedstawiciel Firmy BELIMED, który jest jednym z wiodących producentów rozwiązań systemowych w obszarze mycia dezynfekcji i sterylizacji, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania urządzeń firmy BELIMED, które to urządzenia swoimi parametrami technicznymi gwarantują najwyższą jakość mycia dezynfekcji i sterylizacji. Szereg rozwiązań technicznych zapisanych przez Użytkownika wskazuje na urządzenia jednego konkretnego producenta i poprzez jego indywidualne rozwiązania uniemożliwia złożenie oferty na urządzenia równoważne oraz lepsze.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i nie wymaga.

13 Dotyczy ASORTYMENT: STERYLIZATOR PAROWY PRZELOTOWY 8 STU

Czy Zamawiający zamiast parametrów wymienionych w postępowaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego urządzenia o poniższych parametrach:

- sterylizator parowy z drzwiami przesuwными w pionie,
- zwarta konstrukcja urządzenia nie wymagająca dostępu serwisowego bocznego,
- ergonomiczna wysokość załadunku komory 785 mm,
- obsługa urządzenia poprzez panel dotykowy przeszklony po stronie załadunku i rozładunku,
- kolorowy wyświetlacz 5,7” po stronie załadunku,
- pierścieniowy płaszcz parowy umożliwiający kontrolę podczas próby wodnej,
- orurowanie ze stali kwasoodpornej,

- uszczelka drzwiowa o zwiększonej wytrzymałości do 3500 cykli,
- wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej,
- wielostopniowy system wytwarzania próżni gwarantujący idealne suszenie najcięższych wsadów,
- krótkie czasy programów sterylizacyjnych,
- programy sterylizacyjne dla ciężkich załadunków zwalidowane dla sterylizacji narzędzi o wadze do 20kg/StE
- funkcja automatycznego uruchamiania o zadanej godzinie, w celu skrócenia czasu przygotowania urządzenia do pracy,
- wbudowana drukarka,
- zdalny dostęp serwisowy za pomocą łącza internetowego,
- łatwa konserwacja i oszczędność miejsca (dostęp serwisowy wyłącznie od frontu),
- wbudowana wytwornica pary (opcjonalnie),
- wymiary komory (WxSxG) 660 x 660 x 1350 mm,
- wymiary urządzenia (WxSxG) 1970 x 990x 1750 (1775) mm,
- pojemność komory 8 StU,
- pojemność komory 585 l?

Odpowiedź:

Według wiedzy zamawiającego zapisy SWZ są sformułowane w sposób ogólny, pozwalający na złożenie ofert wielu wykonawcom. Wykonawca nie zadał pytań o konkretne parametry techniczne danego urządzenia, narzuca natomiast swoje gotowe rozwiązania.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w przypadku potrzeby zmian w wybudowanym obiekcie oczekuje wszelkich dostosowań instalacji, infrastruktury, czy wykończenia obiektu do potrzeb oferowanego sprzętu od Wykonawcy – czyli wszelkie związane z tym koszty leżą po stronie Wykonawcy zamówienia.

14 Dotyczy ASORTYMENT: MYJNIA DEZYNFEKTOR PRZELOTOWA

Czy Zamawiający zamiast parametrów wymienionych w postępowaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego urządzenia o poniższych parametrach:

Myjnia-dezyniektor opracowana w celu osiągnięcia najwyższego poziomu czystości, dezynfekcji i suszenia produktów medycznych przy minimalnym zużyciu zasobów.

- 2 intuicyjne w obsłudze ekrany 10,4" po stronie załadunku i wylądunku, działające niezależnie, z możliwością wyświetlenia niestandardowych informacji,
- funkcje inteligentnego napełniania, sterowania pompą myjącą i zbiornik magazynowy zmniejszające zużycie mediów do 45%,
- pojemność 18 tac DIN oraz kontenerów sterylizacyjnych 1 STE,
- dostęp serwisowy wyłącznie od frontu urządzenia,
- zautomatyzowane mycie wstępne narzędzi w komorze,
- system antypianowy,
- system DynamicFilling (dynamiczna kontrola poziomu wody w celu zmniejszenia zużycia wody, środków chemicznych i energii we wszystkich fazach procesu odpowiednio do wielkości załadunku),
- wysokowydajna pompa myjąca 950 l/min,
- automatyczna regulacja prędkości obrotowej pompy myjącej oraz monitorowanie ciśnienia systemu filtrującego komory w celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu,
- wysokowydajny agregat suszący z regulacją w zakresie 136-650 m³/h, z wymuszonym suszeniem przez obwód mycia,
- do 5 pomp dozujących z czujnikami przepływu – precyzyjne odmierzanie zadanego stężenia środka chemicznego,
- dezynfekcja termiczna wg zadanej wartości A0 i/lub temperatury,
- przepustnica powietrza wyziewanego zamknięta w fazach mycia w celu zmniejszenia zużycia energii,
- odprowadzenie kondensatu po stronie urządzenia na separatorze kondensatu,
- zgodność z wymaganiami normy EN ISO 15883 cz.1 i cz.2,
- wymiary zewnętrzne (WxSxG) 1840/2215 x 900 x 940 mm,
- objętość komory myjącej 350 l?

Odpowiedź:

Według wiedzy zamawiającego zapisy SWZ są sformułowane w sposób ogólny, pozwalający na złożenie ofert wielu wykonawcom. Wykonawca nie zadał pytań o konkretne parametry techniczne danego urządzenia, narzuca natomiast swoje gotowe rozwiązania.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w przypadku potrzeby zmian w wybudowanym obiekcie oczekuje wszelkich dostosowań instalacji, infrastruktury, czy wykończenia obiektu do potrzeb oferowanego sprzętu od Wykonawcy – czyli wszelkie związane z tym koszty leżą po stronie Wykonawcy zamówienia.

15 Jako autoryzowany przedstawiciel Firmy RENOSEM, który jest jednym z wiodących producentów rozwiązań systemowych w obszarze mycia dezynfekcji i sterylizacji, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania urządzeń firmy RENOSEM, które to urządzenia swoimi parametrami technicznymi gwarantują najwyższą jakość mycia dezynfekcji i sterylizacji. Szereg rozwiązań technicznych zapisanych przez Użytkownika wskazuje na urządzenia jednego konkretnego producenta i poprzez jego indywidualne rozwiązania uniemożliwia złożenie oferty na urządzenia równoważne oraz lepsze.

Odpowiedź:

Według wiedzy zamawiającego zapisy SWZ są sformułowane w sposób ogólny, pozwalający na złożenie ofert wielu wykonawcom. Wykonawca nie zadał pytań o konkretne parametry techniczne danego urządzenia, narzuca natomiast swoje gotowe rozwiązania.

16 Dotyczy ASORTYMENT: STERYLIZATOR PLAZMOWY PRZELOTOWY S90

Czy Zamawiający zamiast parametrów wymienionych w postępowaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego urządzenia o poniższych parametrach:

- niskotemperaturowy sterylizator plazmowy,
- przyjazny interfejs, łatwy w użyciu,
- kolorowy ekran dotykowy,
- przestronna komora z dwoma demontowalnymi, wysuwanymi półkami,
- automatyczne usuwanie kaset bez dodatkowych materiałów eksploatacyjnych do usuwania zużytych kaset,
- uniwersalny system zbierania danych,
- jednorazowa kaset sterylizacyjna,
- drukarka termiczna,
- 4 blokowane koła,
- wymiary zewnętrzne (WxSxG) 1537 x 700 x 986 mm,
- waga 395 kg,
- wymiary komory (WxSxG) 340 x 380 x 700 mm,
- komora o pojemności 90,4 l, prostokątna, wykonana ze stali nierdzewnej,
- dawka środka sterylizującego 8 ml (50%),
- wydajność środka sterylizującego 1 kasetę/cykl,
- temperatura procesu poniżej 55 stopni Celsjusza,
- całkowity czas trwania cyklu 28-53 min,
- zasilanie 230V, 50 Hz,
- sterownik mikroprocesorowy PLC,
- akustyczny i wizualny alarm,
- filtr antybakteryjny HEPA, o wydajności 99,97% przy 0,3 mikrona.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

17 Czy Zamawiający wyraża zgodę na tolerancję wymiarową $\pm 5\%$ w parametrach dotyczących wymiarów, w których tolerancja wymiarowa nie została wyznaczona?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na tolerancję wymiarową $\pm 5\%$ w parametrach dotyczących wymiarów, w których tolerancja wymiarowa nie została wyznaczona.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w przypadku potrzeby zmian w wybudowanym obiekcie oczekuje wszelkich dostosowań instalacji, infrastruktury, czy wykończenia obiektu do potrzeb oferowanego sprzętu od Wykonawcy – czyli wszelkie związane z tym koszty leżą po stronie Wykonawcy zamówienia.

18 Dotyczy ASORTYMENT: MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA

Czy Zamawiający zamiast parametrów wymienionych w postępowaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego urządzenia o poniższych parametrach:

Myjnia wolnostojąca ultradźwiękowa nablutowa firmy Bandelin Model: Sonorex Digitec DT 1028 Hz
Parametry techniczne:

- Komora mycia wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Pojemność komory: 28l
- Wymiary komory: 500 x 300 x 200 mm (dł. x szer. x wys.)
- Programowanie czasu mycia 1-30 min
- Częstotliwość ultradźwięków 35kHz
- Moc ultradźwięków 1200 na okres impulsu
- Moc układu grzania 1300 W
- Regulacja temperatury 20-80oC
- Automatyczny układ odgazowania kąpeli mycia
- Pokrywa komory mycia ze stali nierdzewnej ze sprężyną gazową i uszczelką EPDM, na zawiasach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w przypadku potrzeby zmian w wybudowanym obiekcie oczekuje wszelkich dostosowań instalacji, infrastruktury, czy wykończenia obiektu do potrzeb oferowanego sprzętu od Wykonawcy – czyli wszelkie związane z tym koszty leżą po stronie Wykonawcy zamówienia.

19 Dotyczy ASORTYMENT: PISTOLET DO MYCIA I SUSZENIA Z ZESTAWEM KOŃCÓWEK, pkt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z przewodem zasilającym o długości 3m?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

20 Dotyczy ASORTYMENT: URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA RĘKAWÓW PAPIEROWO FOLIOWYCH

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wydajności zgrzewania 4700 torebek/h?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w przypadku potrzeby zmian w wybudowanym obiekcie oczekuje wszelkich dostosowań instalacji, infrastruktury, czy wykończenia obiektu do potrzeb oferowanego sprzętu od Wykonawcy – czyli wszelkie związane z tym koszty leżą po stronie Wykonawcy zamówienia.

21 Dotyczy ASORTYMENT: URZĄDZENIE DO CIŚNIENIOWEGO MYCIA NARZĘDZI PARĄ WODNĄ

Czy Zamawiający zamiast parametrów wymienionych w postępowaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego urządzenia o poniższych parametrach:

Urządzenie Multisteam do mycia narzędzie medycznych parą wodną. Parametry techniczne:

- pojemność zbiornika wody: 5,0 l
- ciśnienie robocze pary: 0-6 bar
- ciśnienie robocze sprężonego powietrza: max. 4 bar
- temperatura robocza pary: 160°C
- moc: 2500 W
- wymiary zewnętrzne (wys./szer./głęb.): 420 x 300 x 350 mm
- obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

22 Dotyczy ASORTYMENT: SYSTEM DO MYCIA PIANĄ I DEZYNFEKCJI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z podłączeniem do baterii ciepła/zima woda 3/4"?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, dopuszcza i nie wymaga.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w przypadku potrzeby zmian w wybudowanym obiekcie oczekuje wszelkich dostosowań instalacji, infrastruktury, czy wykończenia obiektu do

potrzeb oferowanego sprzętu od Wykonawcy – czyli wszelkie związane z tym koszty leżą po stronie Wykonawcy zamówienia.

23 Dotyczy ASORTYMENT: STACJA UZDATNIANIA WODY

Prosimy o doprecyzowanie czy rozprowadzenie wody do urządzeń ze stacji uzdatniania wody jest po stronie Inwestora czy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wykona rozprowadzenie wody, po stronie wykonawcy jest dostawa, montaż i rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniu SUW .

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w przypadku potrzeby zmian w wybudowanym obiekcie oczekuje wszelkich dostosowań instalacji, infrastruktury, czy wykończenia obiektu do potrzeb oferowanego sprzętu od Wykonawcy – czyli wszelkie związane z tym koszty leżą po stronie Wykonawcy zamówienia.

24 Dotyczy ASORTYMENT: STACJA UZDATNIANIA WODY

Czy Zamawiający dopuszcza zainstalowanie zbiorników o większej wydajności (zbiorniki mogą różnić się wymiarami i pojemnością) w celu zapewnienia optymalnego działania urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, dopuszcza i nie wymaga, zaproponowanego rozwiązania. Zwraca natomiast uwagę na niewielkie gabaryty pomieszczenia SUW, informując jednocześnie o braku możliwości jego powiększenia.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w przypadku potrzeby zmian w wybudowanym obiekcie oczekuje wszelkich dostosowań instalacji, infrastruktury, czy wykończenia obiektu do potrzeb oferowanego sprzętu od Wykonawcy – czyli wszelkie związane z tym koszty leżą po stronie Wykonawcy zamówienia.

25 Dotyczy ASORTYMENT: SYSTEM KOMPUTEROWY REJESTRACJI OBIEGU NARZĘDZI ZE STANOWISKAMI KOMPUTEROWYMI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu komputerowego bez możliwości wewnętrznego przesyłania informacji pomiędzy użytkownikami systemu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ. Komunikacja wewnątrz komórek organizacyjnych szpitala jest niezbędna.

26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu komputerowego z możliwością wykonania integracji z oprogramowaniem HIS potwierdzona wykonaniem minimum 2 wykonanych i działających integracji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pyt. 1. Dotyczy wózek na worki na odpadki (Strefa brudna 0/21, Strefa czysta 0/15.)

Czy zamawiający dopuści do oceny wózek pojedynczy do worków foliowych 120L, z pokrywą, 440x440x985 mm, wymiar nie zmienia funkcjonalności wózka.

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 2. Dotyczy wózek do transportu z podwójnym blatem (Strefa brudna 0/21, Strefa czysta 0/15, Strefa sterylna, 0/09.)

Czy zamawiający do oceny wózek z podwójnym blatem zagłębionym, wym. blatów 750x600 mm, wym. 880x600x880 mm, wymiar nie zmienia funkcjonalności wózka.

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 3. Dotyczy stół roboczy z dwoma komorami zlewozmywakowymi (Strefa brudna 0/21.)

Czy zamawiający dopuści stół o wymiarach komór 500x400x250 mm, zaproponowany wymiar komór nie zmieni funkcjonalności mebla.

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 4. Dotyczy System komputerowy: Komputer All In One (ekran dotykowy, FullHD, procesor minimalna wydajność obliczeniowa 12,488 w teście Single CPU Systems wynik potwierdzony wydrukiem ze strony www.cpubenchmark.net, RAM 8GB, dysk SSD 500GB, Ethernet, System operacyjny aktywnie wspierany przez producenta systemu aktualizacjami i poprawkami bezpieczeństwa, współpracujący z domena Active Directory).

Czy Zamawiający z uwagi na brak dostępności na rynku dopuści komputery o niższym współczynniku Single CPU System (www.cpubenchmark.net) przy zachowaniu pozostałych parametrów? Zamiana nie powoduje zmiany mającej wpływ na właściwości użytkowe i funkcjonalne systemu komputerowego opisanych w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, ale dopuszcza niższy współczynnik Single CPU System (www.cpubenchmark.net) w zakresie +/- 20% przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Grzegorz Bełowski