



Ap4.1
00.152
A

$\frac{330}{120} = 2.75$
 $2.75 \times 180 = 495$
 $495 + 90 = 585$


$$\begin{array}{r} 140 \\ 200 \end{array}$$

RYSUNEK NR 4

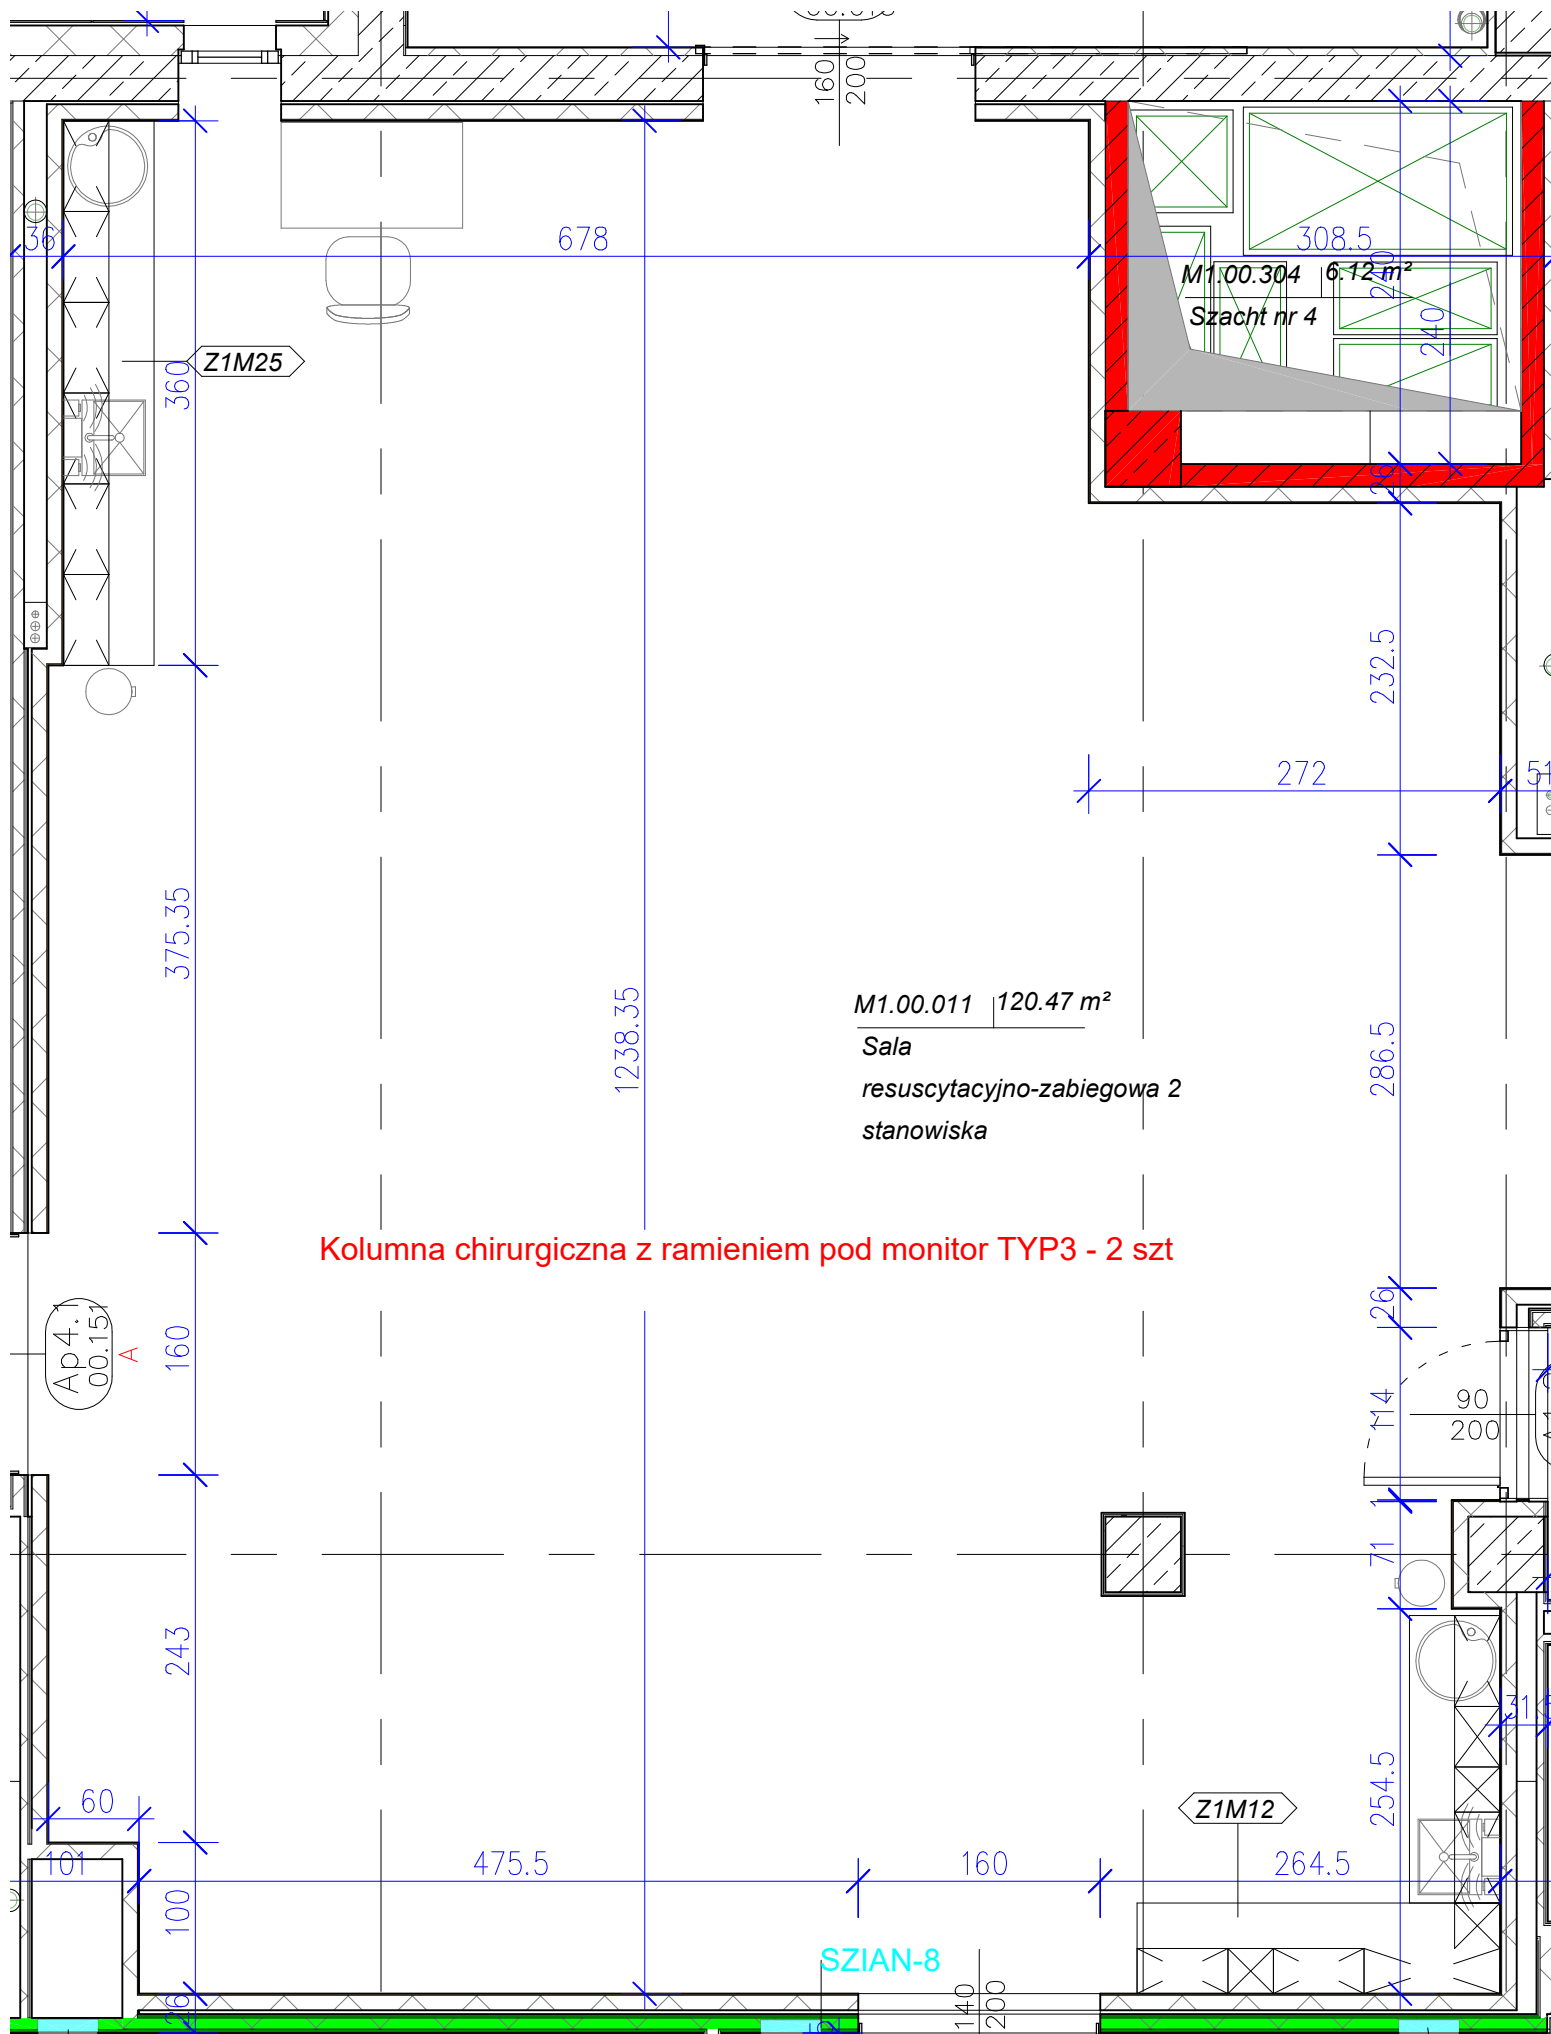





Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt




Lampa zabiegowa - 1 szt




Lampa zabiegowa - 1 szt



Lampa zabiegowa - 1 szt




Lampa zabiegowa - 1 szt




Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt


Kolumna pojedyncza TYP2 - 1 szt




Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP2 - 1 szt




Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP2 - 1 szt




Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP2 - 1 szt




Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP2 - 1 szt

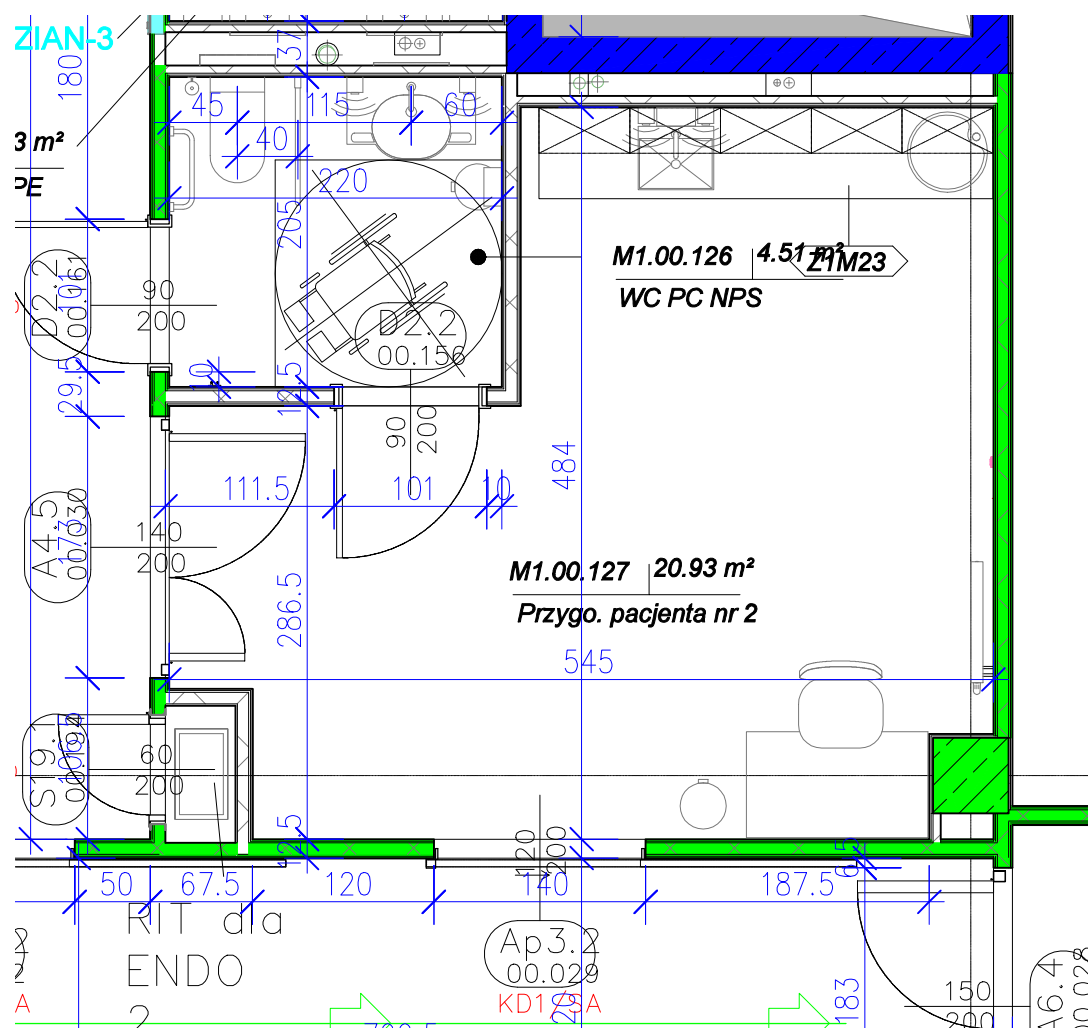


~~Lampa zabiegowa - 1 szt~~

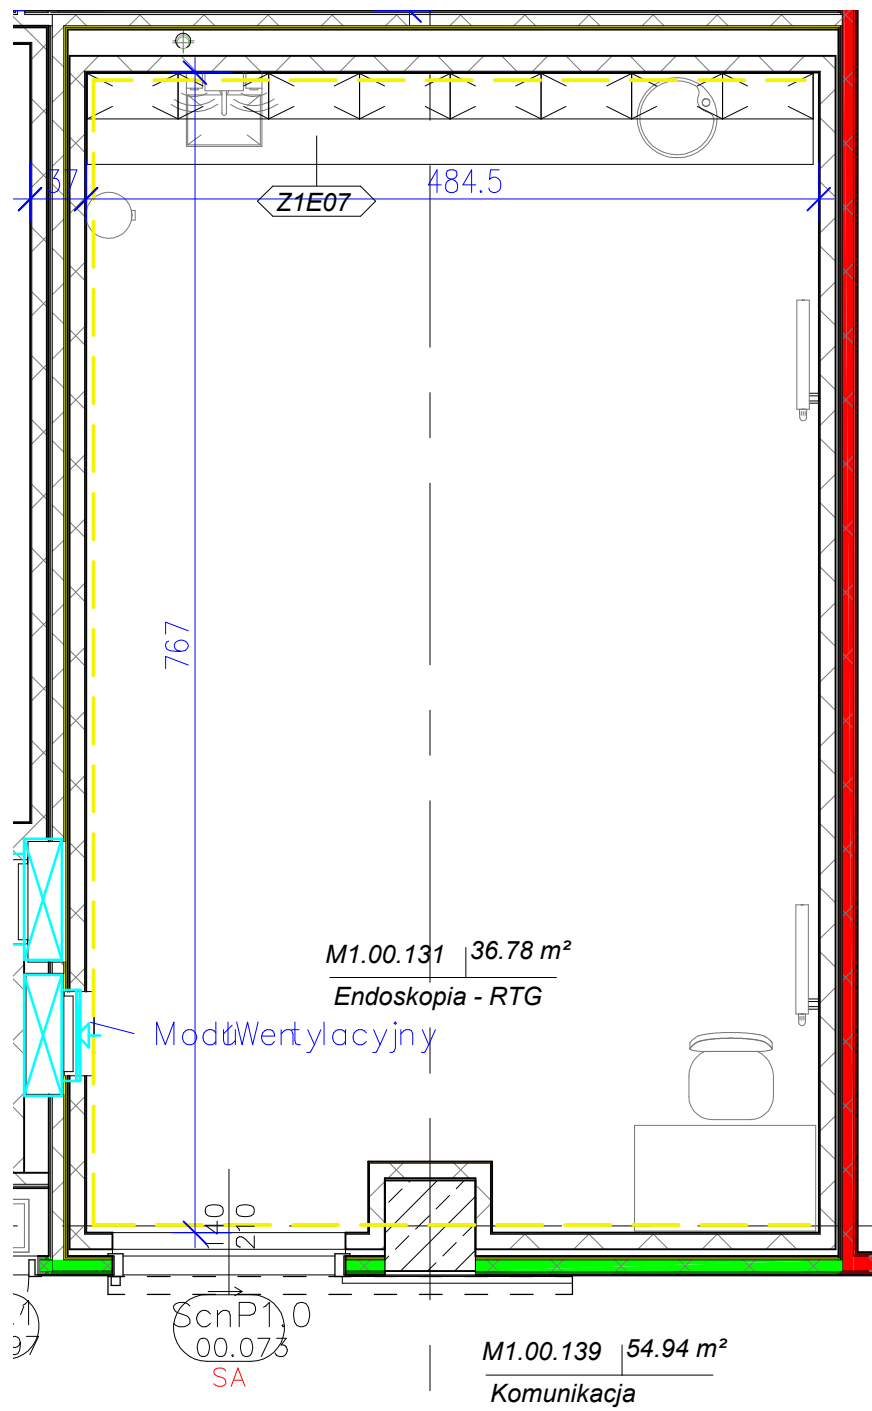


Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP2 - 1 szt

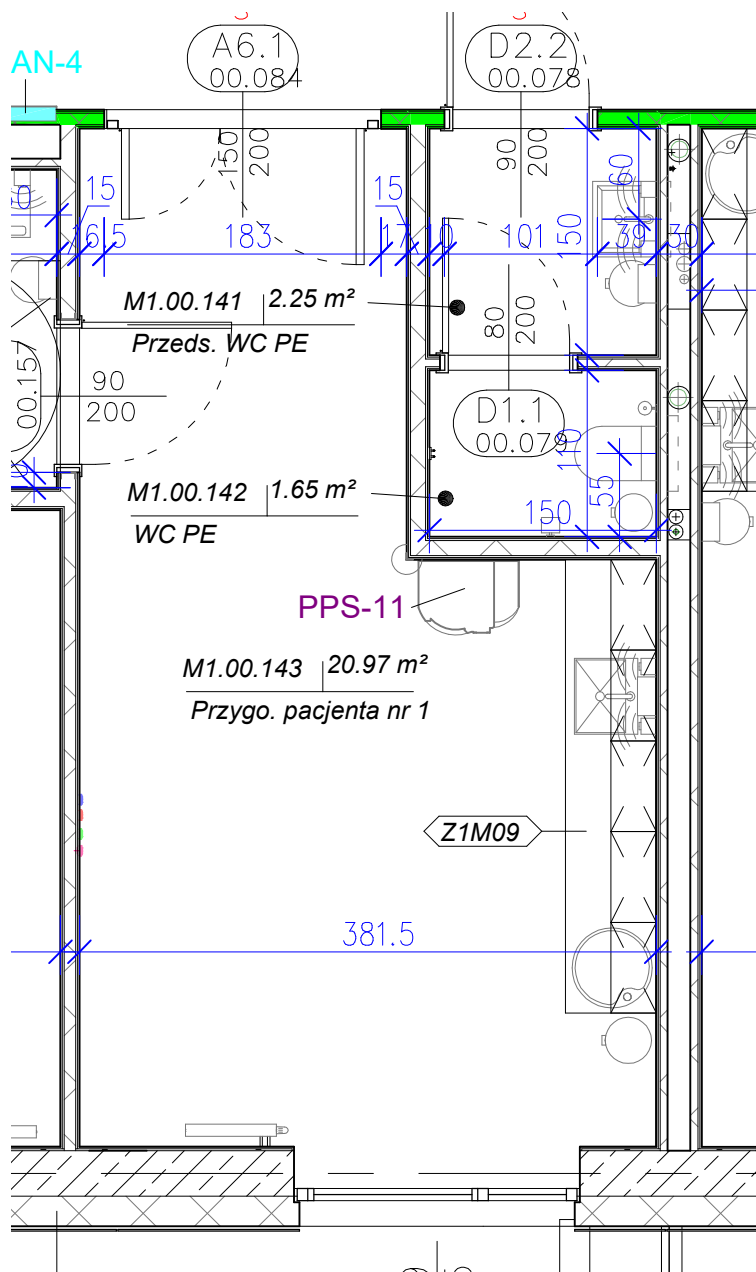


Lampa zabiegowa -- 1 szt

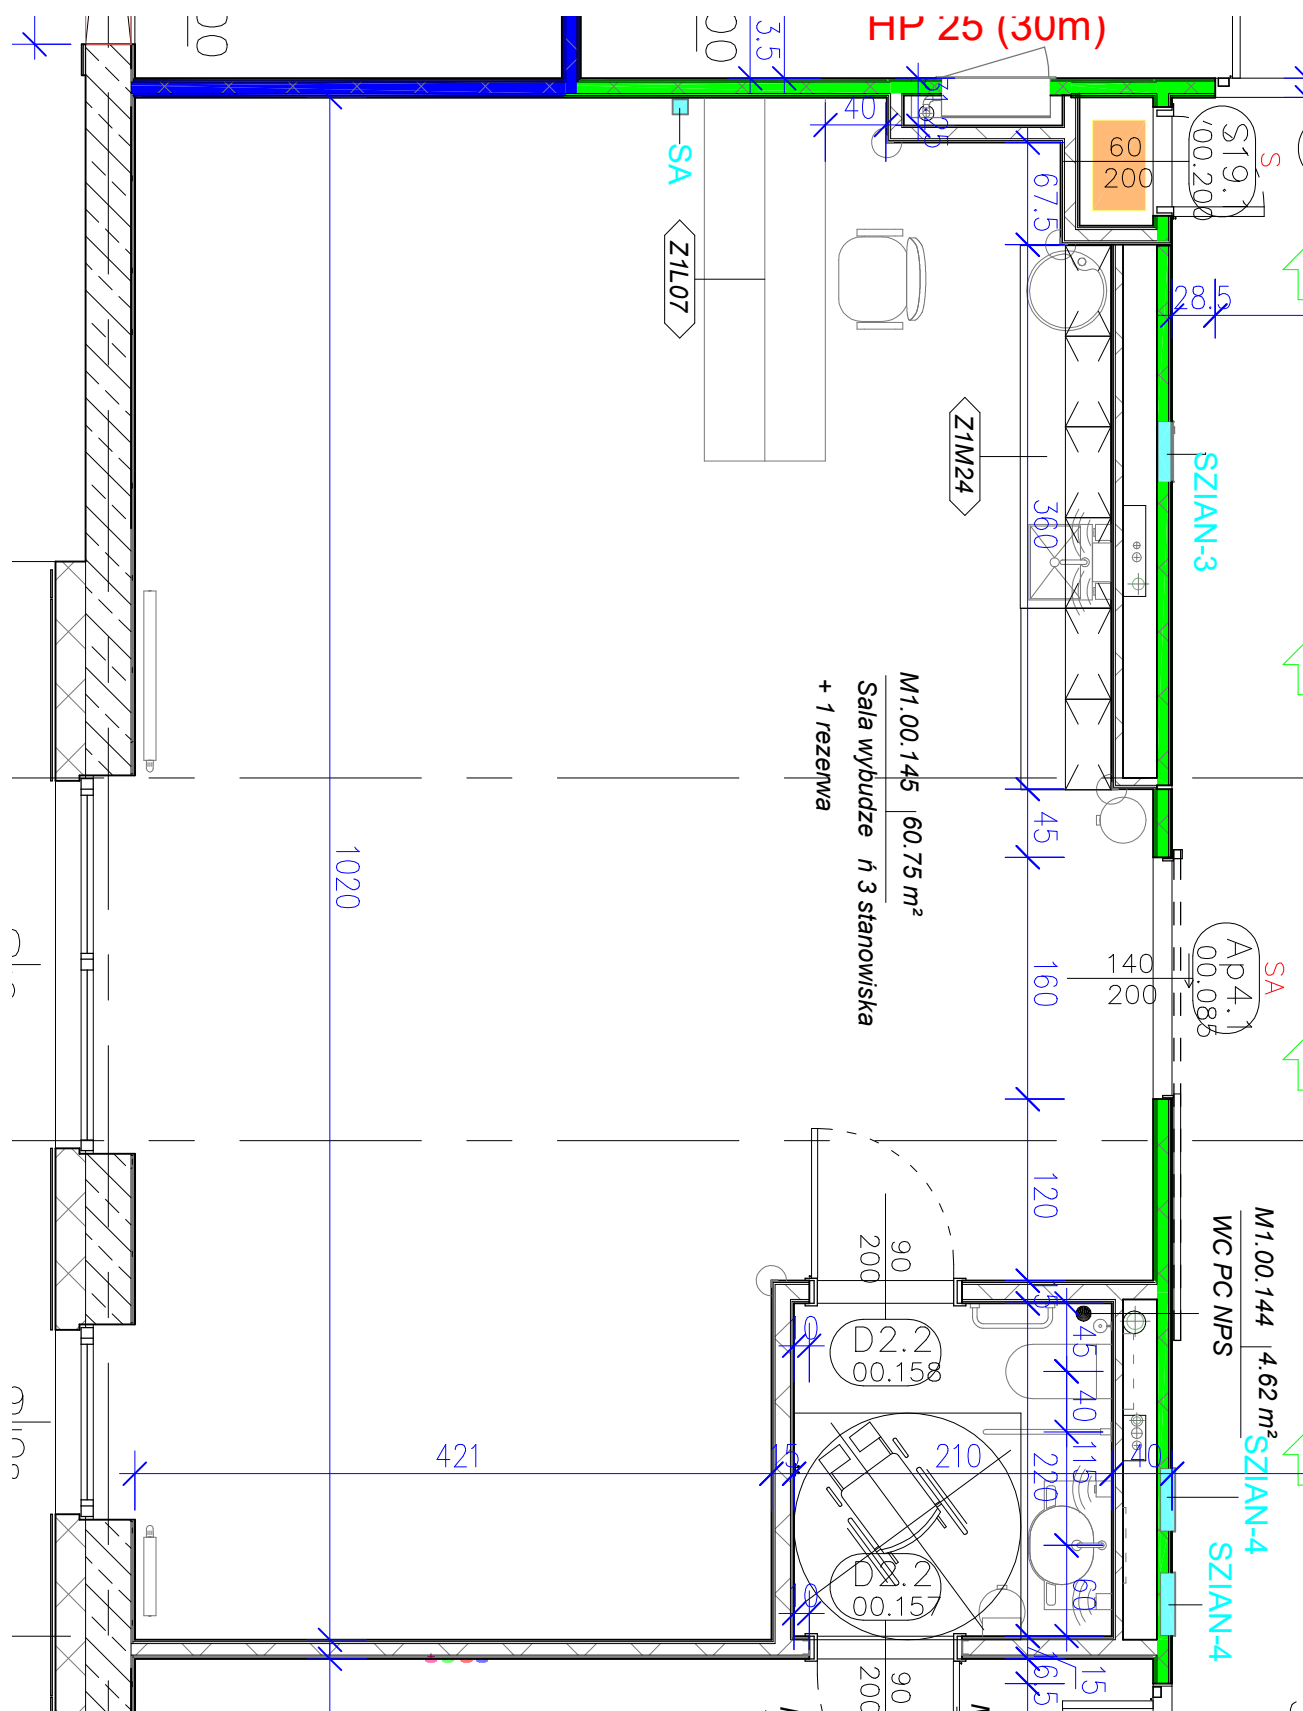


Kolumna pojedyncza dwustanowiskowa TYP2 - 2 szt

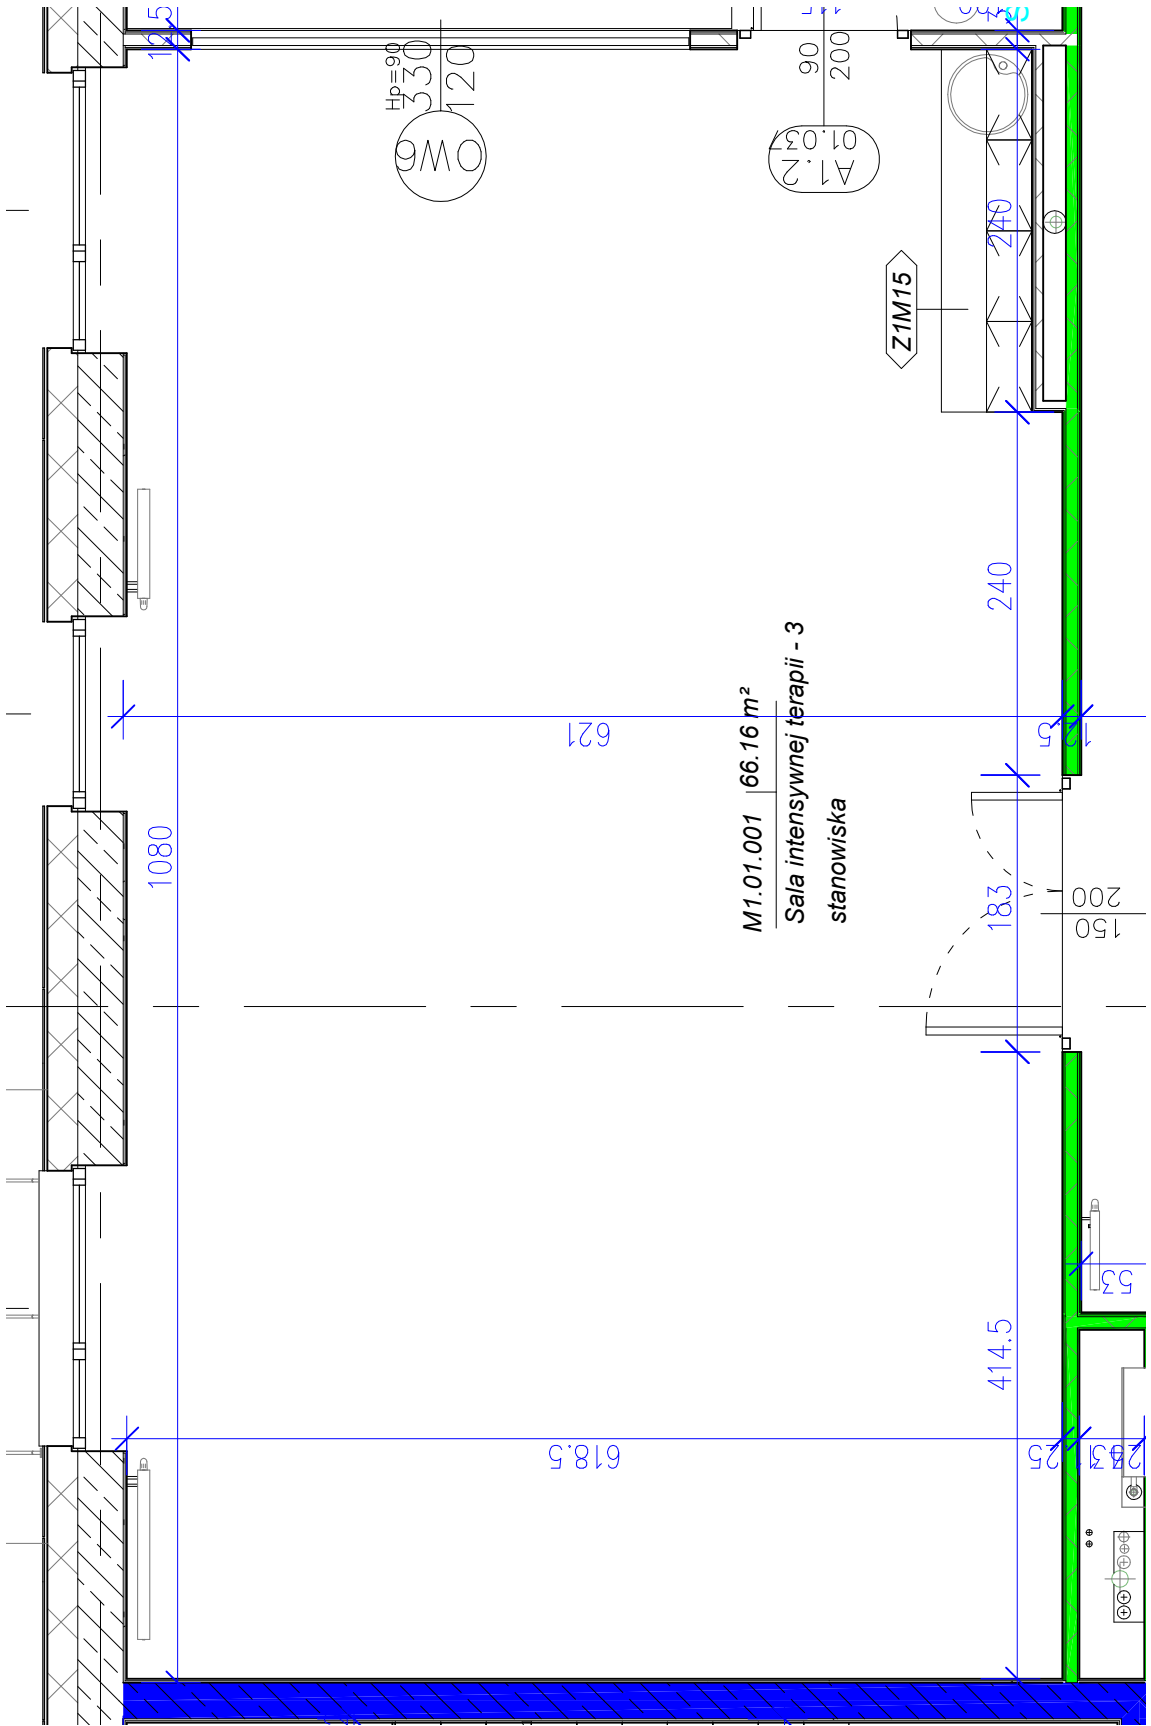

Most medyczny trzystanowiskowy - 1 szt

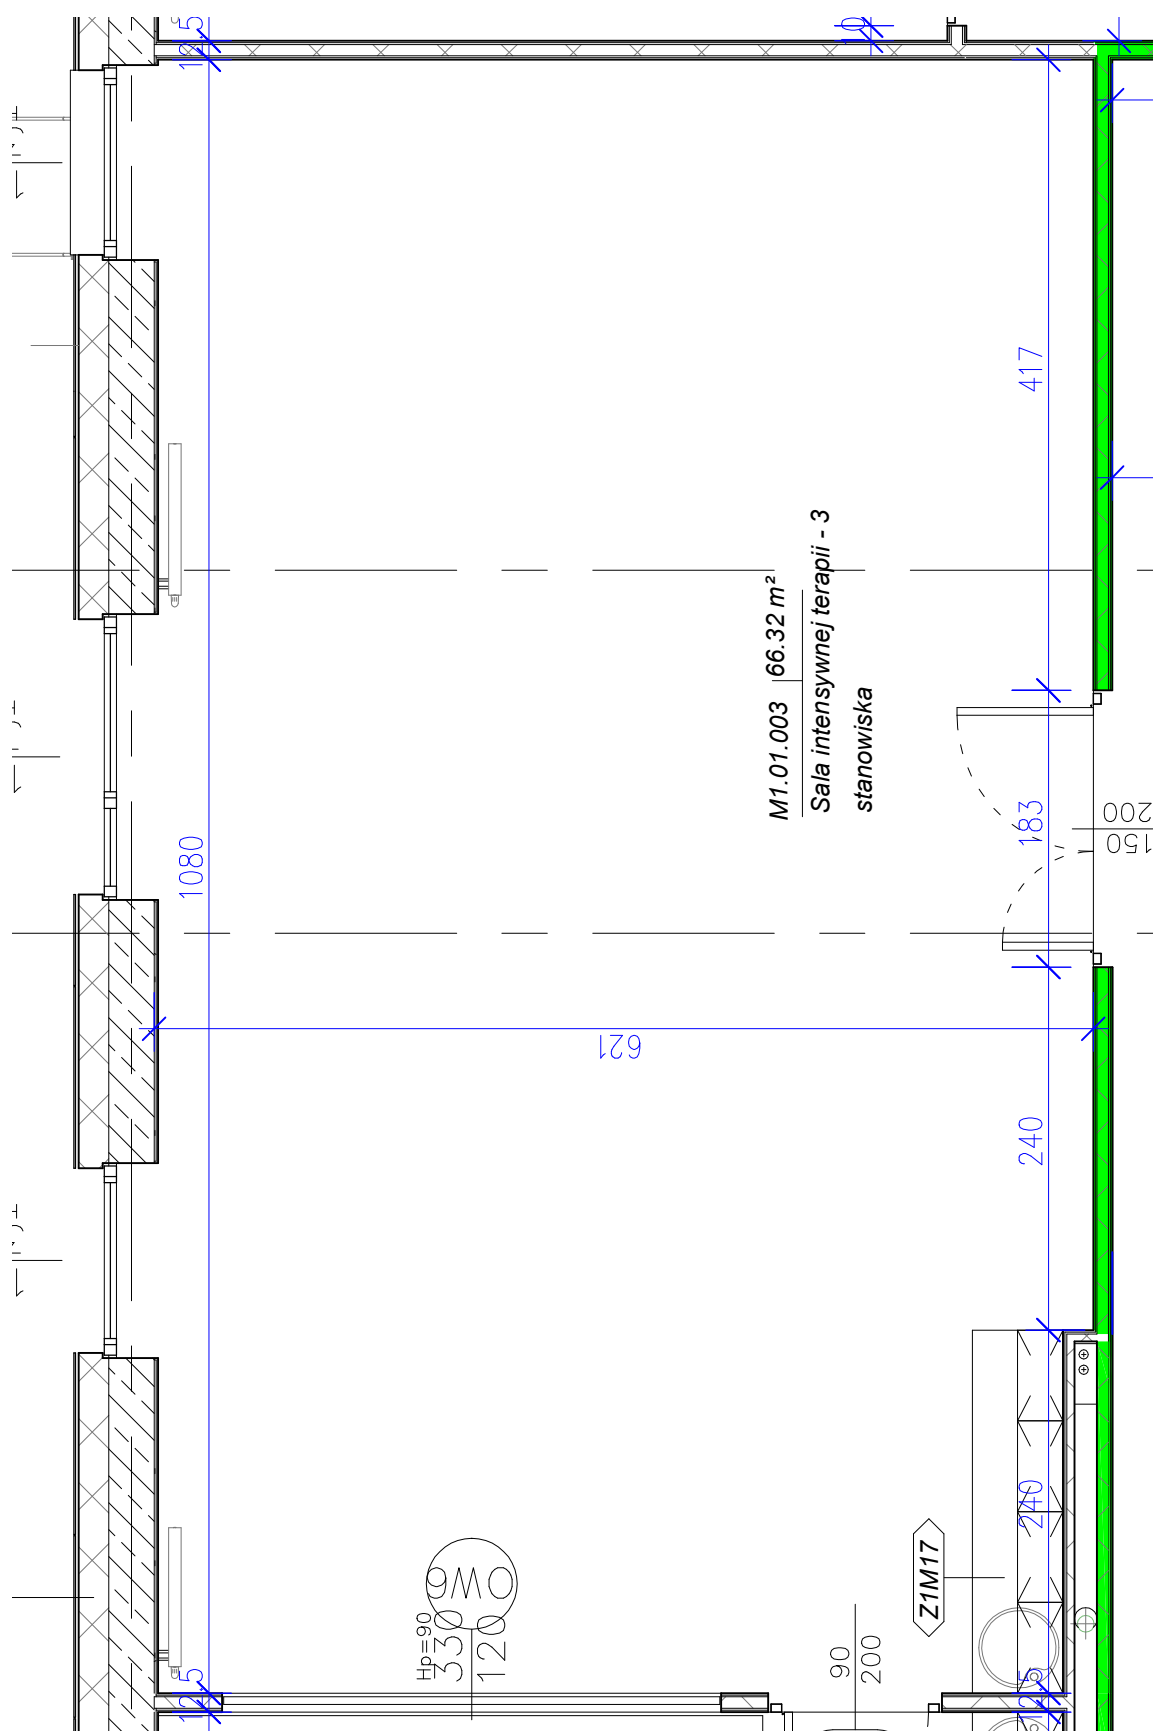


Most medyczny trzystanowiskowy - 1 szt



Most medyczny jednostanowiskowy - 1 szt


Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt




Most medyczny jedno stanowiskowy - 1 szt


Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt


Myjnia do kaczek i basenów - 1szt





Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt

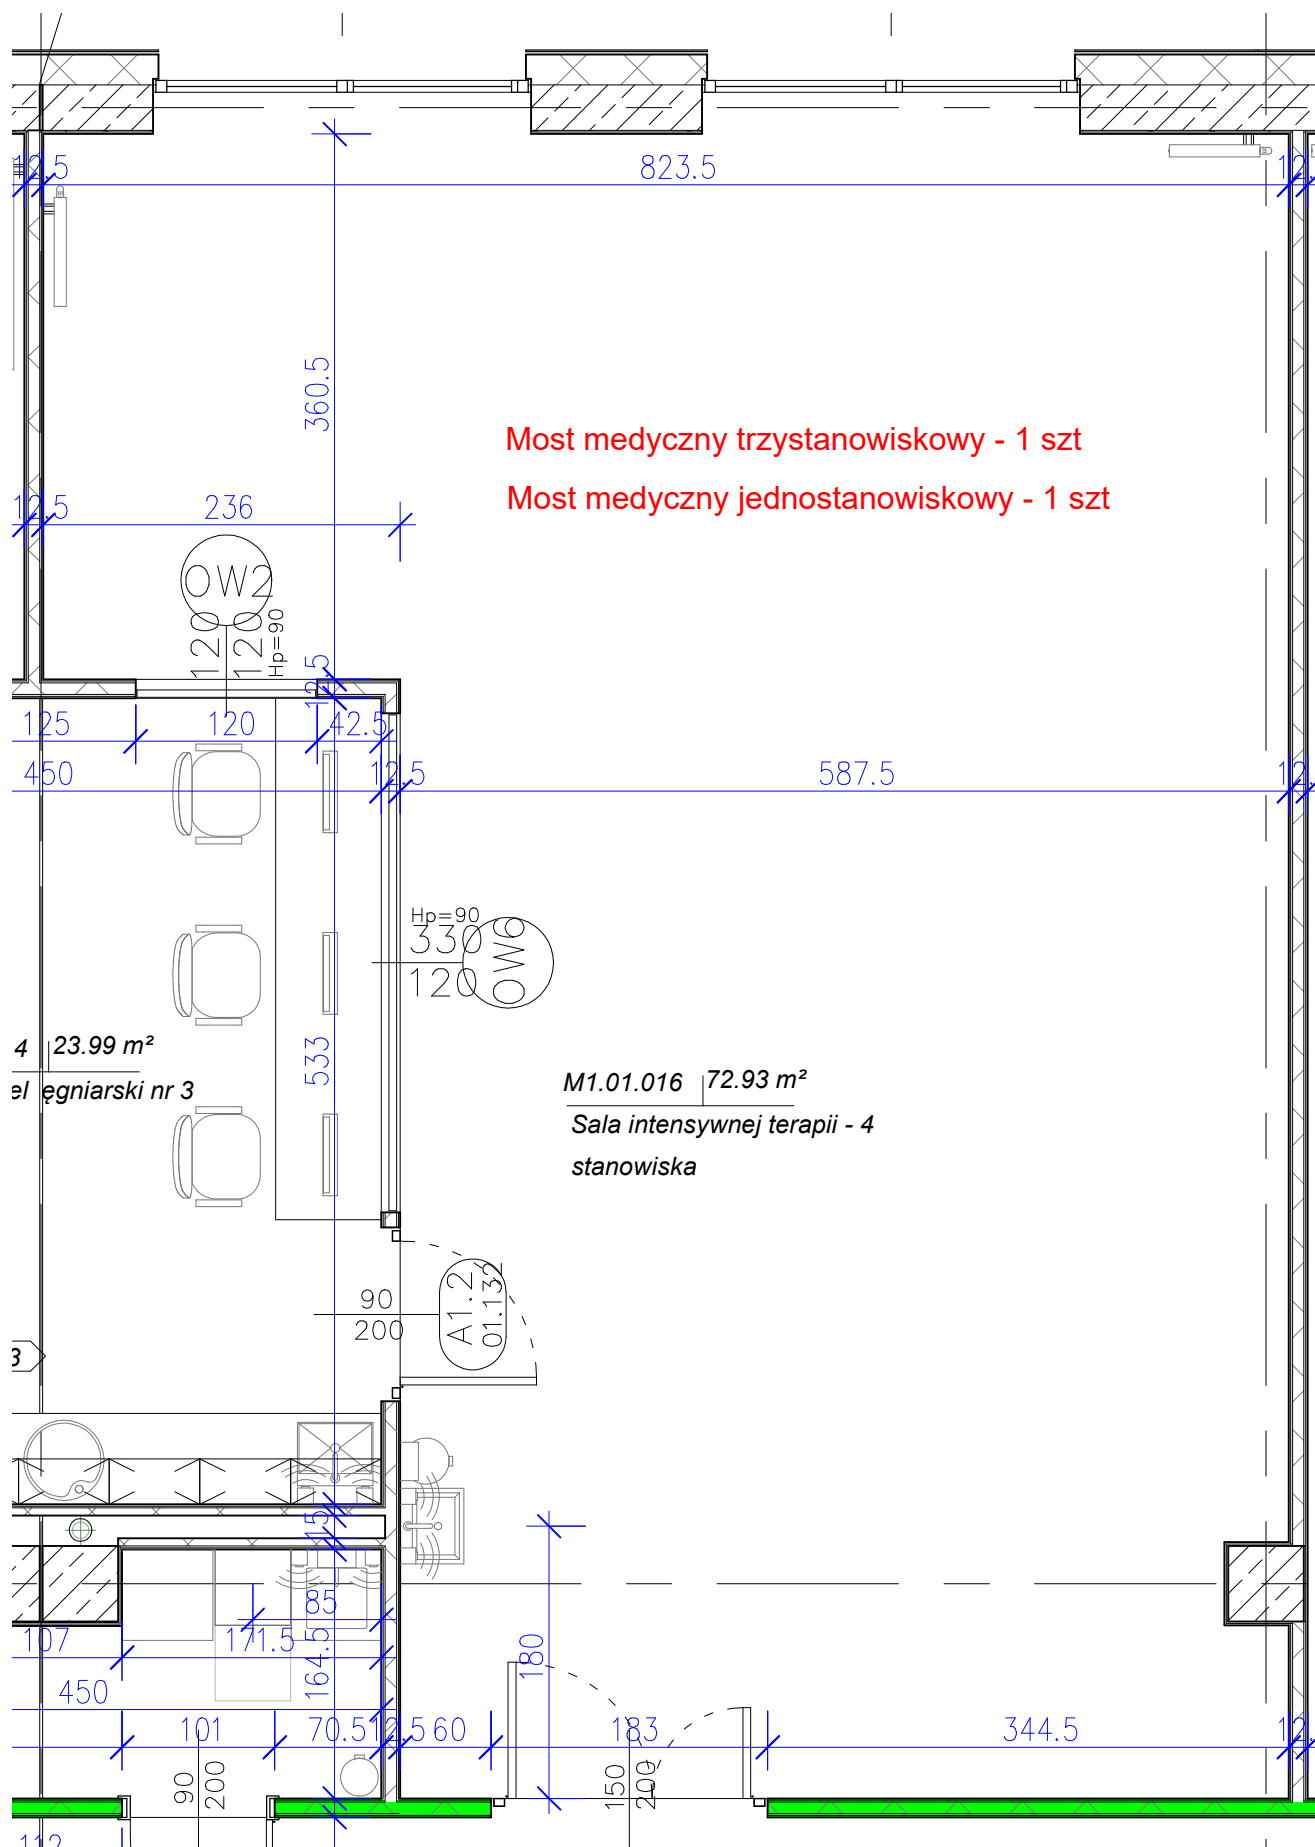




Most medyczny trzystanowiskowy - 1 szt


Most medyczny jednostanowiskowy - 1 szt

M1.01.020 70.24 m²
Sala intensywnej terapii - 4
stanowiska


A1.2
01.139




Most medyczny jedno stanowiskowy - 3 szt




Most medyczny jednostanowiskowy - 3 szt



Lampa zabiegowa - 1 szt




Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt



Most medyczny jedno stanowiskowy - 1 szt


Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt


Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt




Most medyczny jednostanowiskowy - 1 szt


Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt





Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt






Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP1 - 1 szt

Kolumna anestezjologiczna z windą - 1 szt


Lampa operacyjna 1 - szt

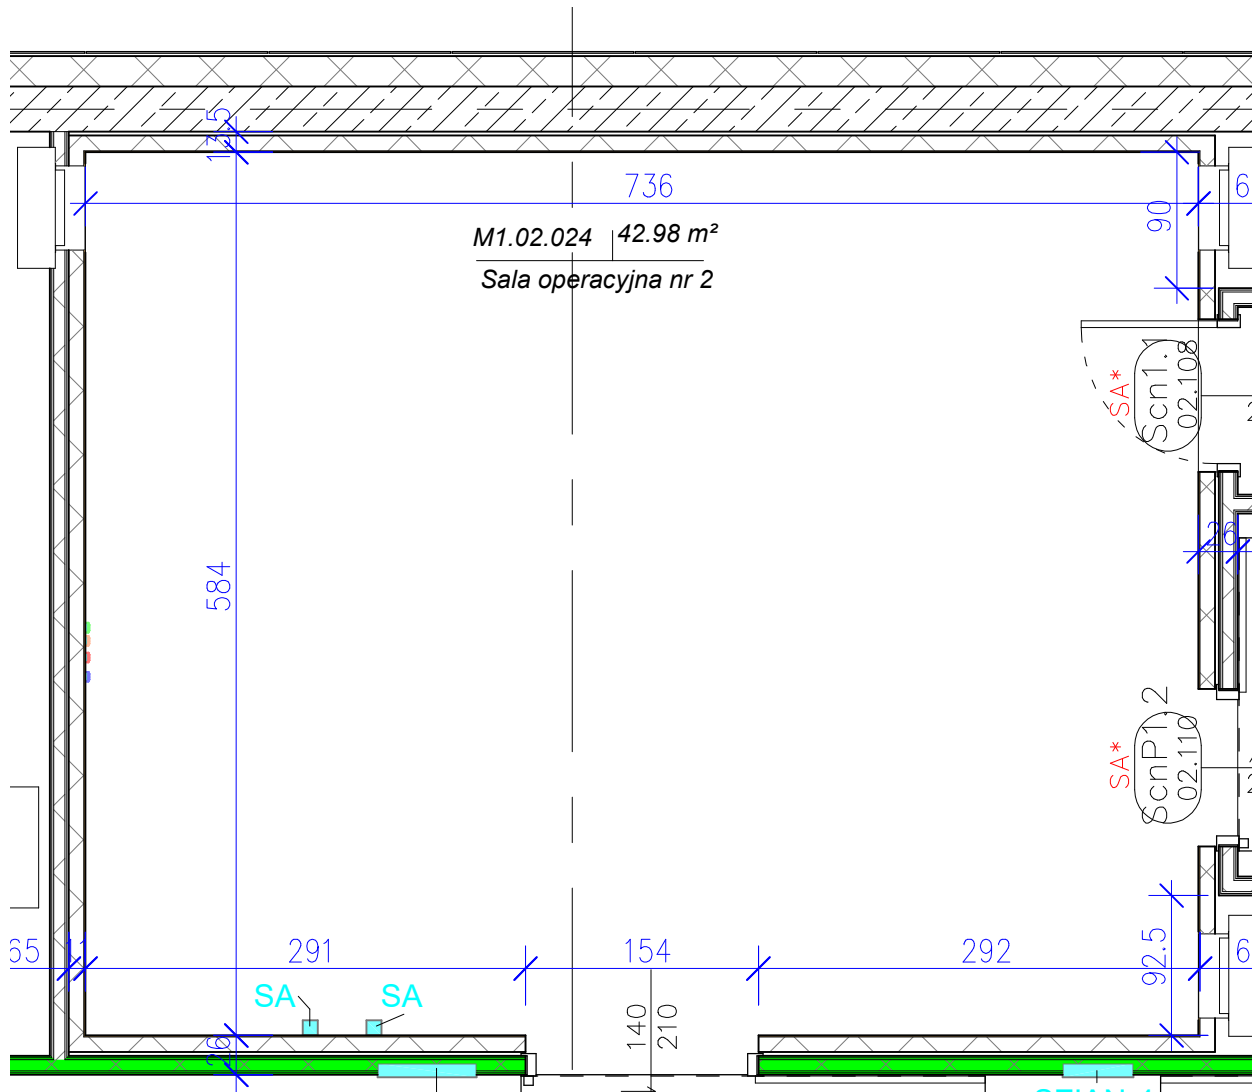

Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP1 - 1 szt

Kolumna anestezjologiczna z windą - 1 szt


Lampa operacyjna - 1 szt

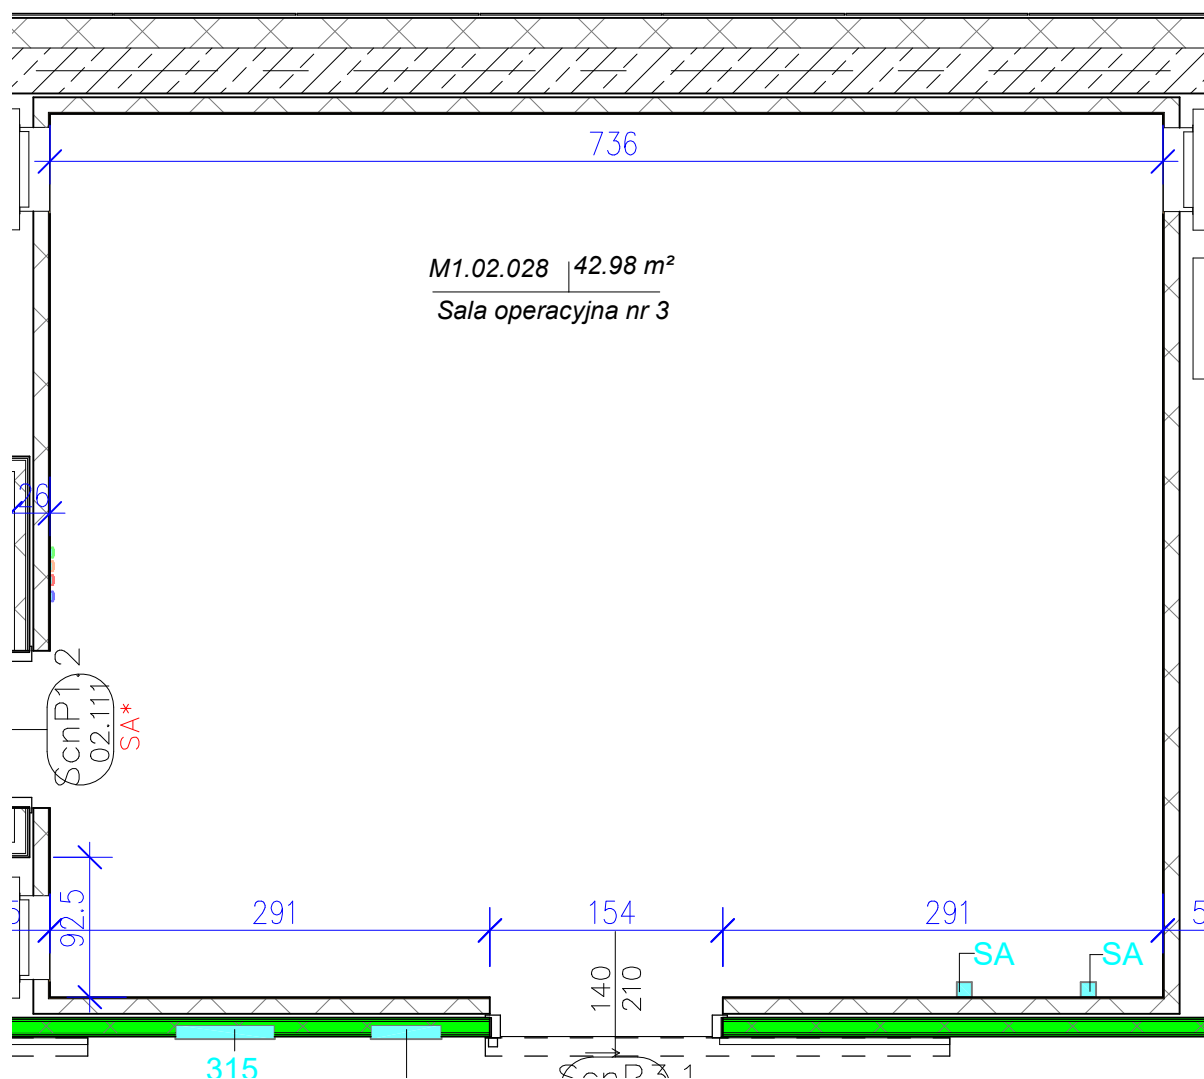

Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP1 - 1 szt

Kolumna anestezjologiczna z windą - 1 szt


Lampa operacyjna - 1 szt

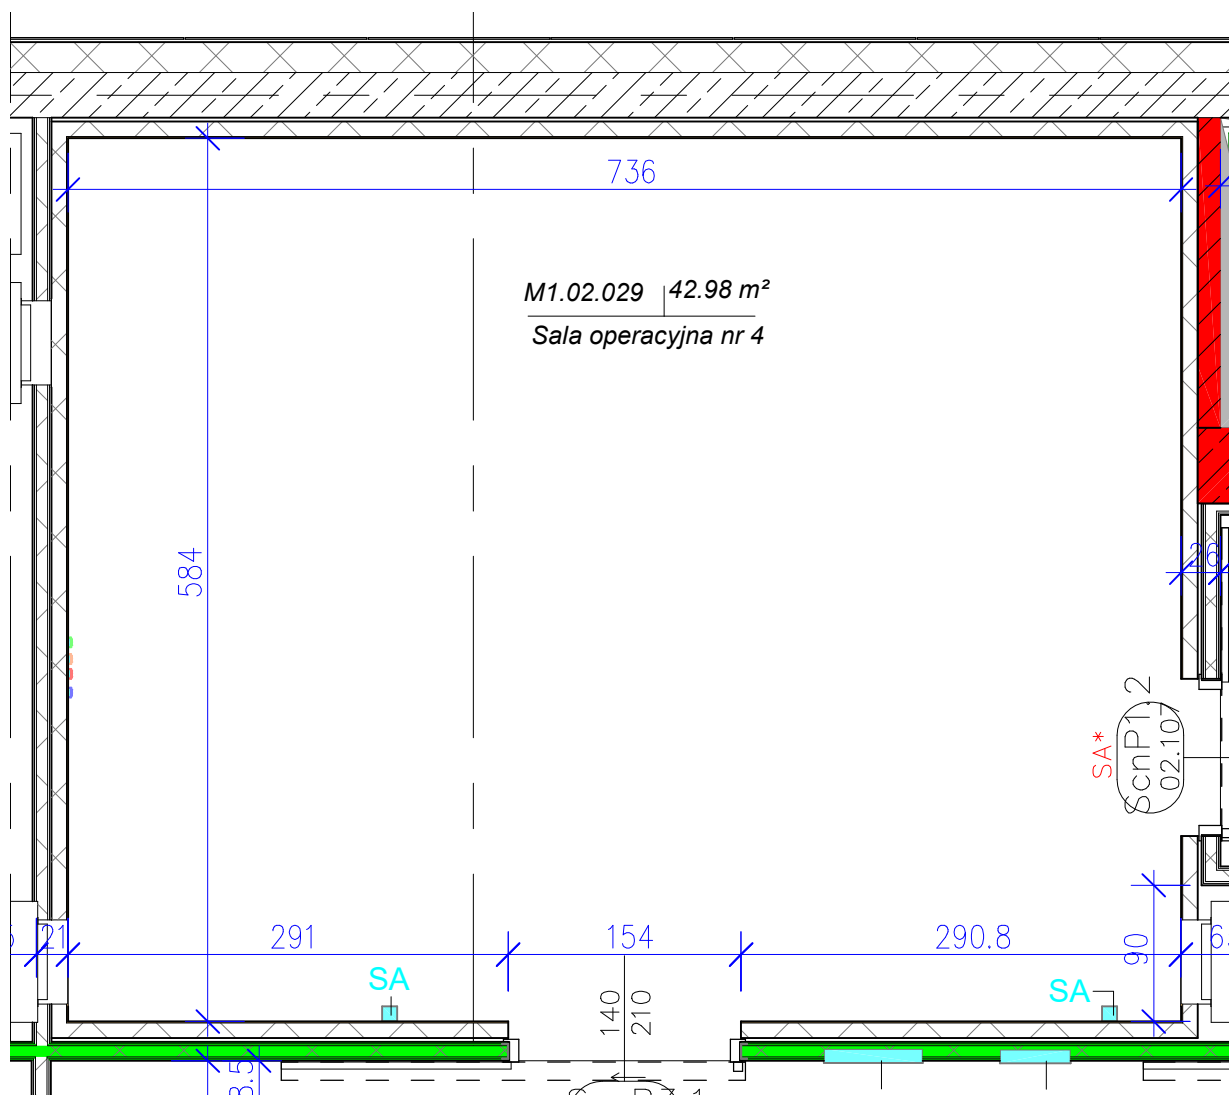



Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP 1 - 1 szt


Kolumna anestezyjologiczna z windą - 1 szt


Lampa operacyjna - 1 szt

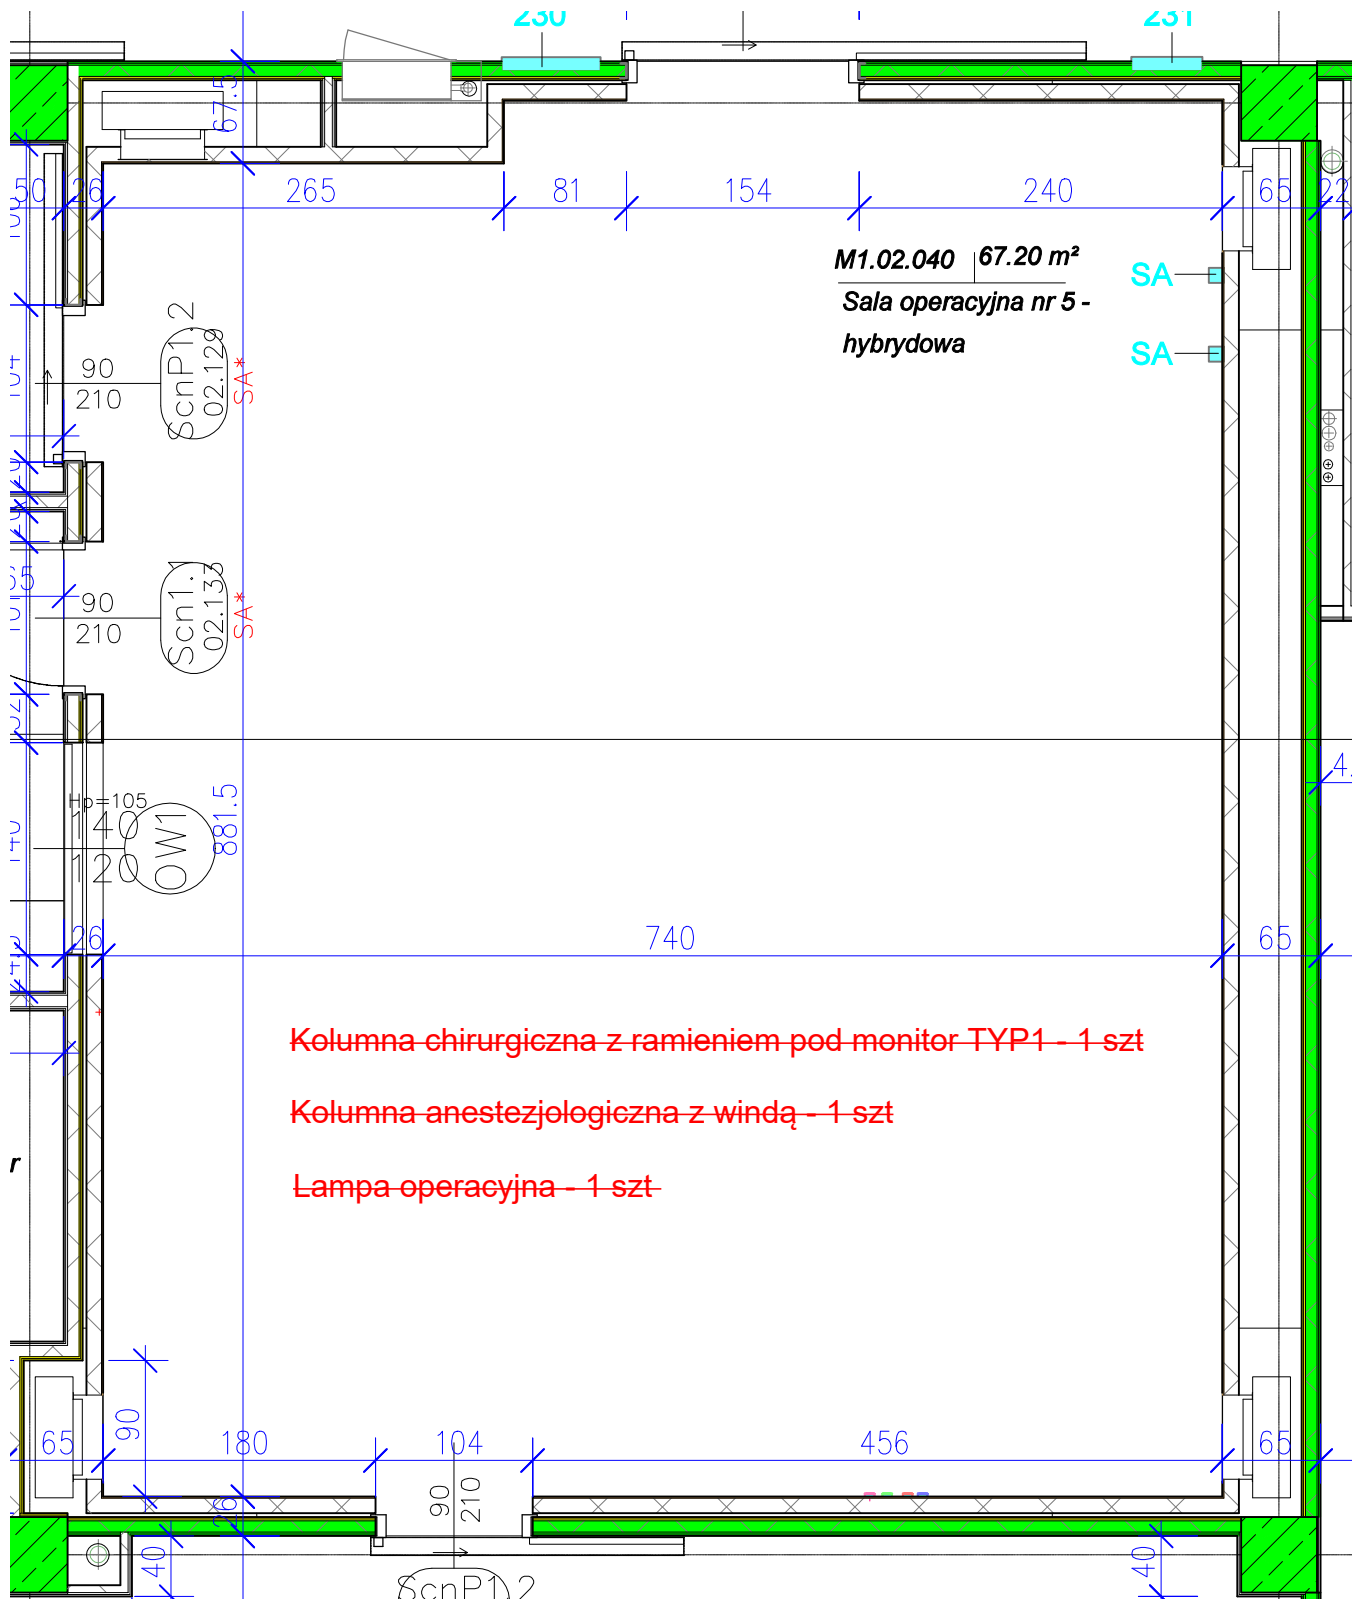

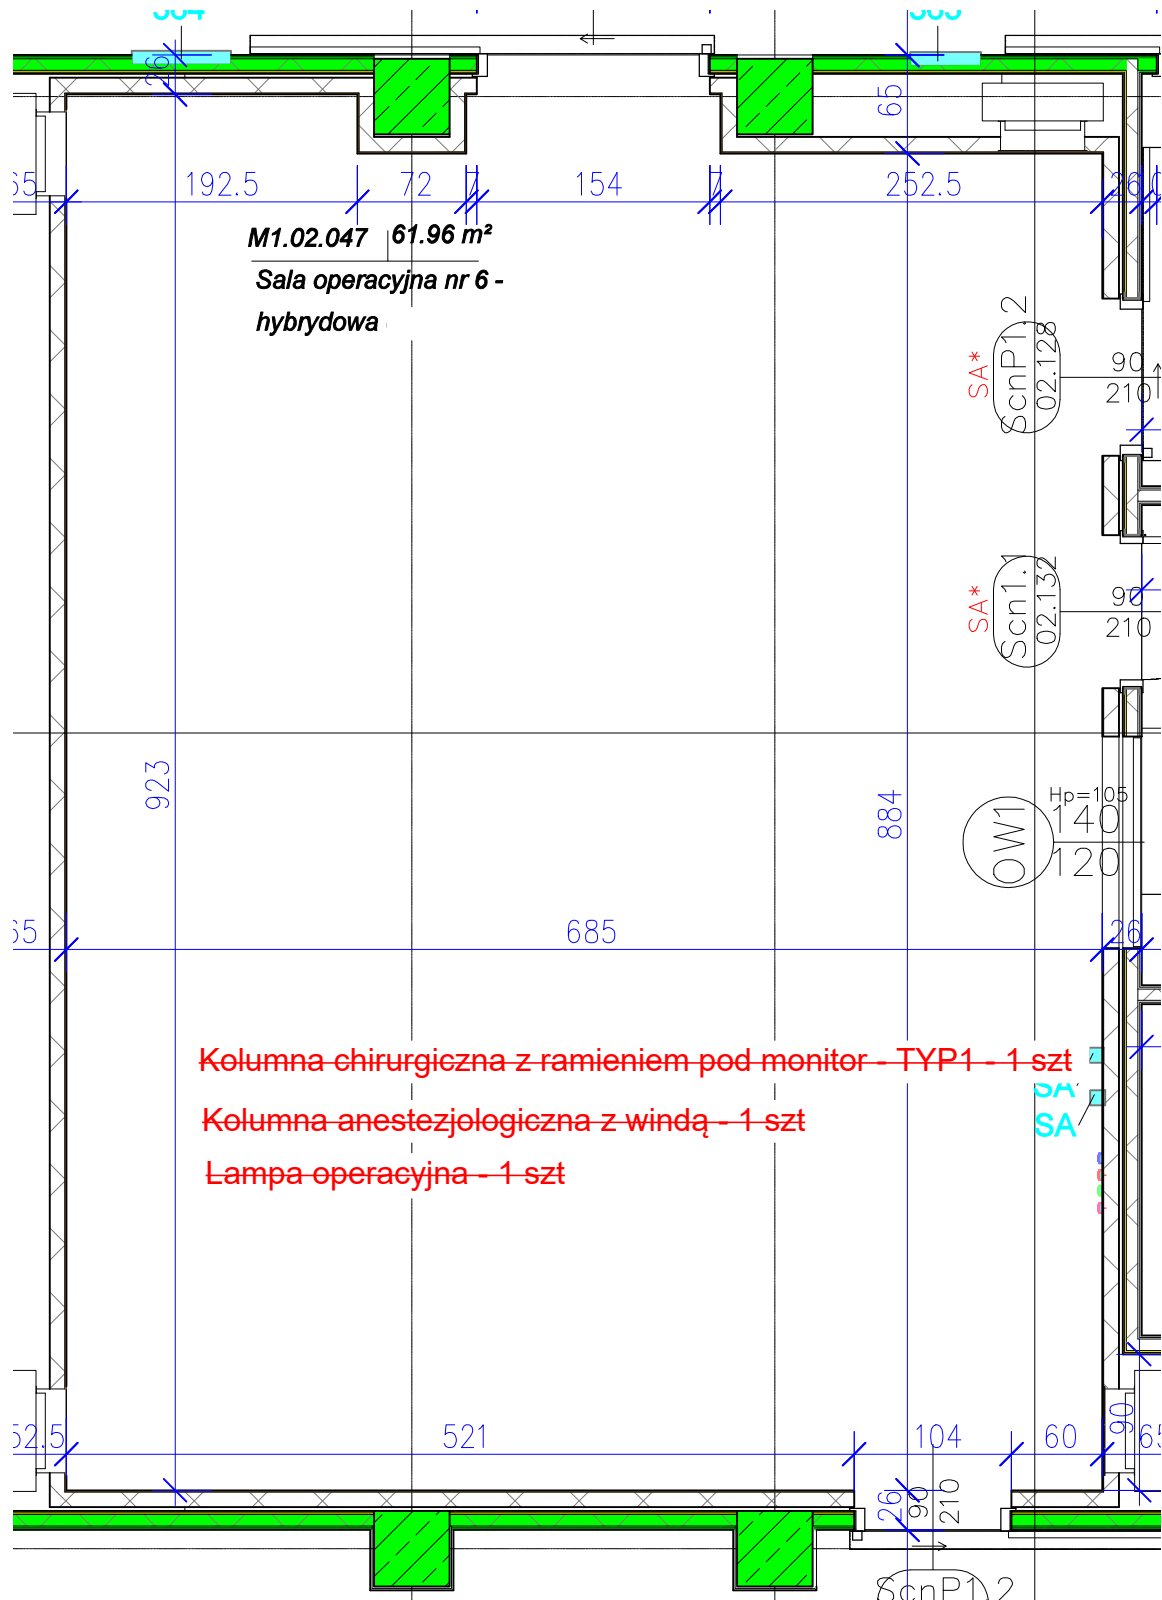









Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt

RYSUNEK NR 55

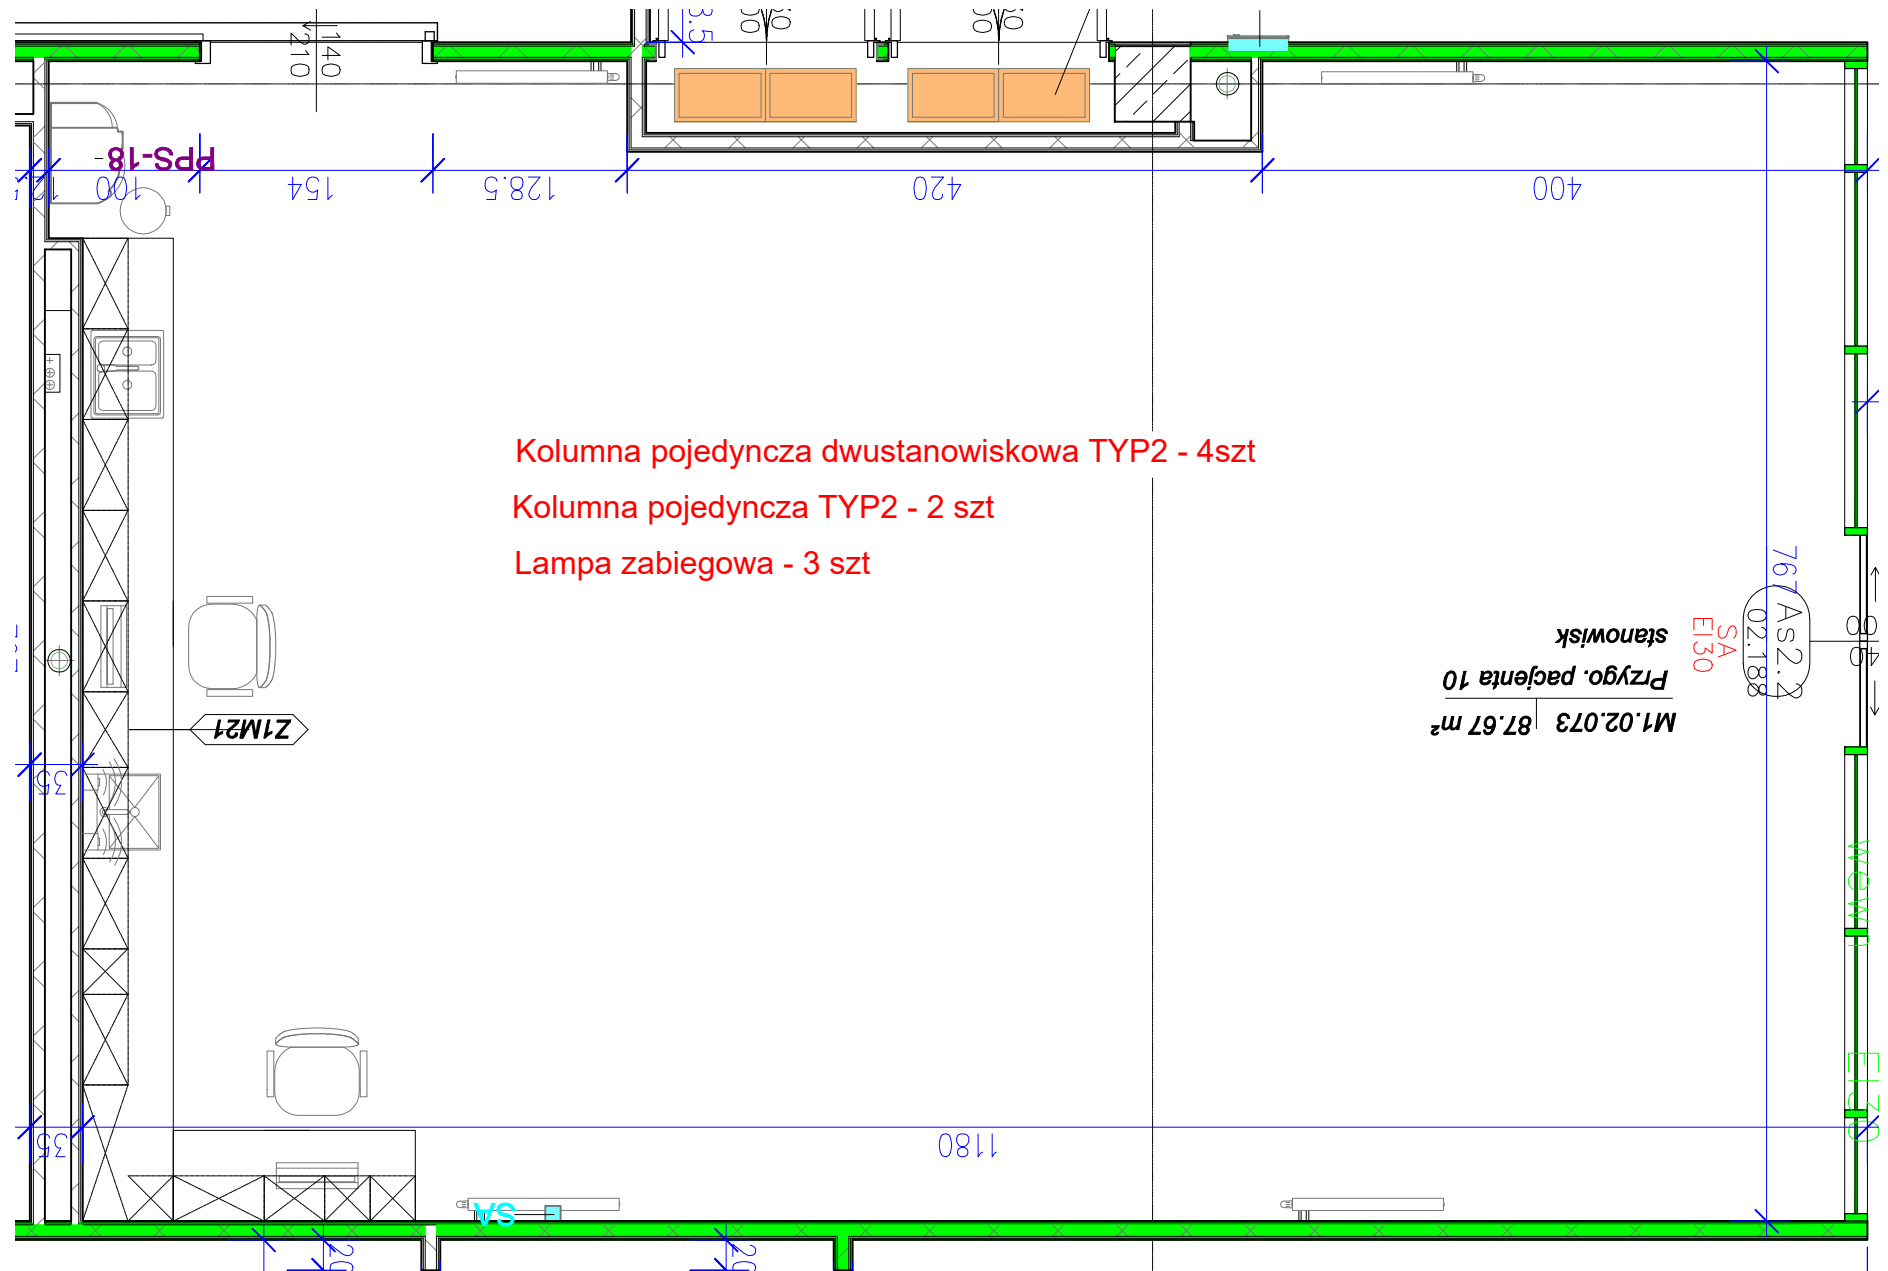




Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP1 - 1 szt

Kolumna anestezjologiczna z windą - 1 szt


Lampa operacyjna - 1 szt




Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP1 - 1 szt

Kolumna anestezjologiczna z windą - 1 szt

Lampa operacyjjna - 1 szt

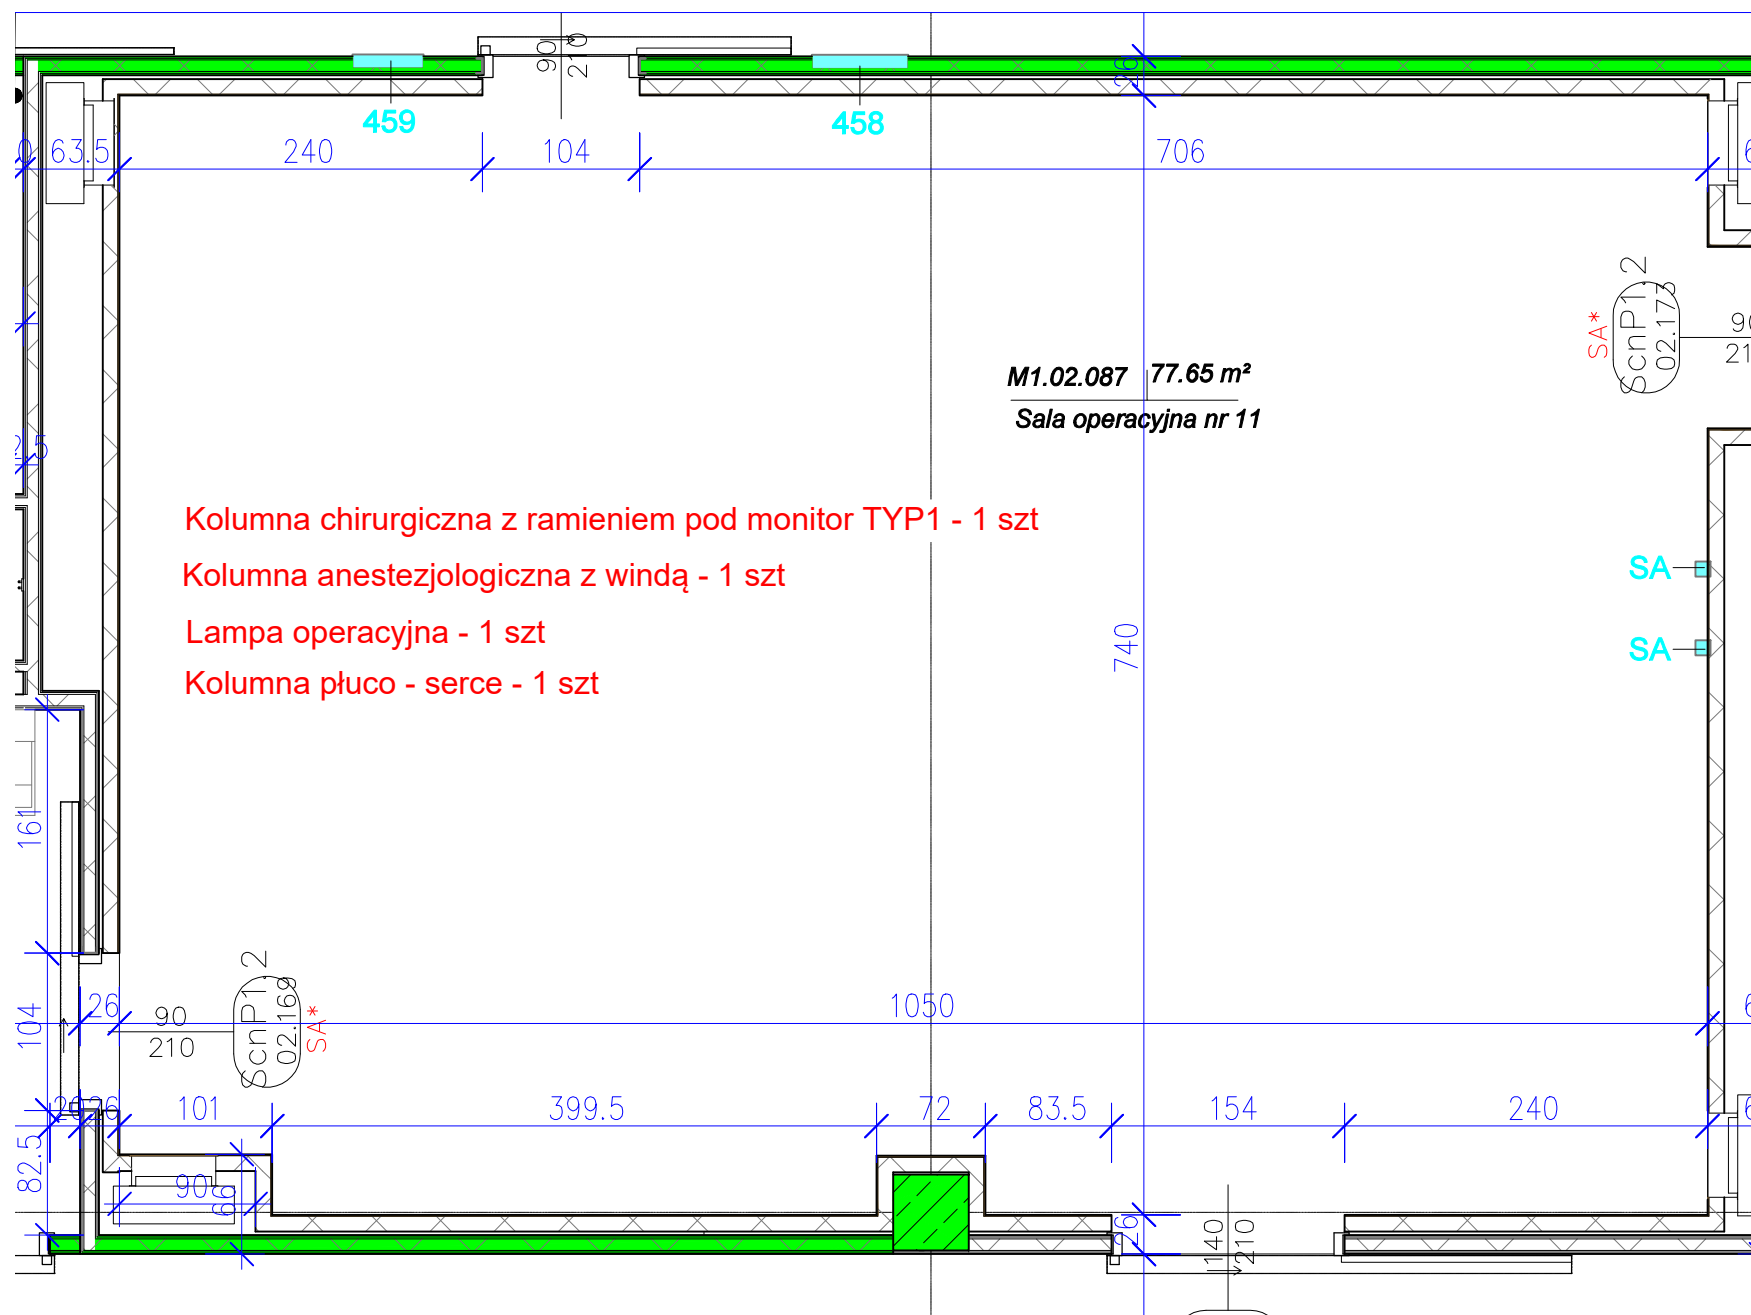




Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP1 - 1 szt

Kolumna anestezjologiczna z windą - 1szt


Lampa operacyjna - 1szt



Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP 1 - 1 szt

Kolumna anestetyczna z windą - 1 szt


Lampa operacyjna - 1 szt

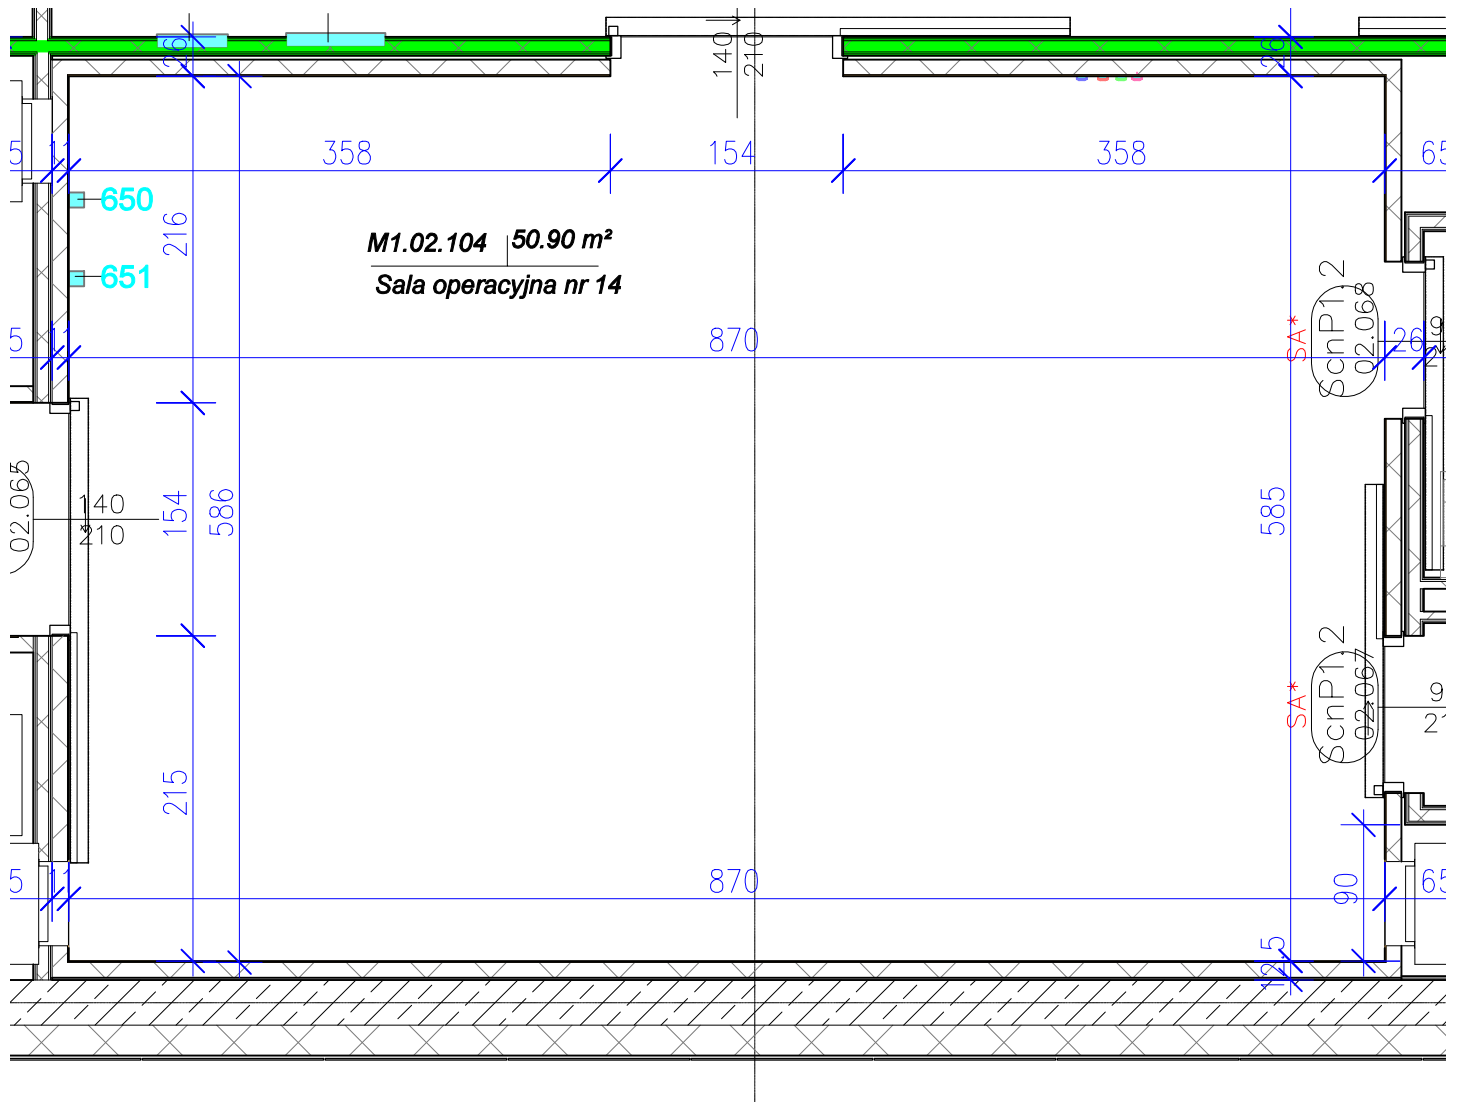

Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP1 - 1 szt

Kolumna anestezjologiczna z windą - 1 szt


Lampa operacyjna - 1 szt

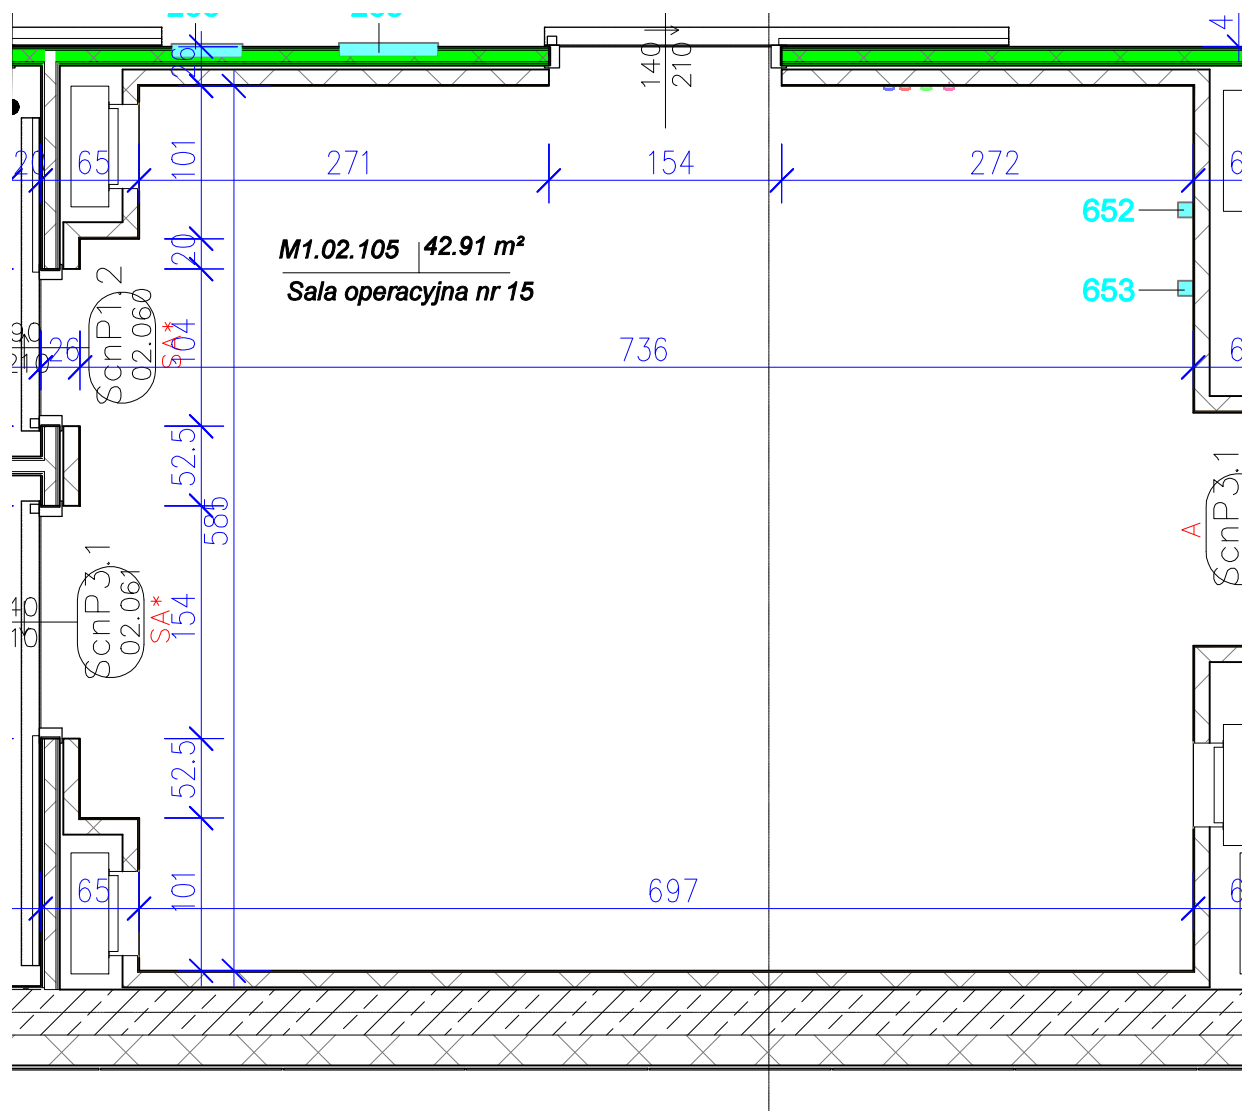


Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor TYP1 - 1szt

Kolumna anestezyjologiczna z windą - 1 szt


Lampa operacyjna - 1 szt




Kolumna pojedyncza dwustanowiskowa TYP2 - 1 szt




Lampa zabiegowa - 1 szt



Lampa zabiegowa - 1 szt




Lampa zabiegowa - 1 szt



Kolumna anestezjologiczna z windą - 1 szt

Kolumna chirurgiczna - 1 szt


Lampa operacyjna - 1 szt



Kolumna anestezjologiczna z windą - 1 szt

Kolumna chirurgiczna - 1 szt


Lampa operacyjna - 1 szt



Kolumna anestetyczna z windą - 1 szt

Kolumna chirurgiczna - 1 szt


Lampa operacyjna - 1 szt



Kolumna anestezjologiczna z windą - 1 szt


Kolumna chirurgiczna - 1 szt


Lampa operacyjna - 1 szt




Most medyczny jednostanowiskowy - 1 szt

Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt







Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt




Lampa zabiegowa - 1 szt




Lampa zabiegowa - 1 szt

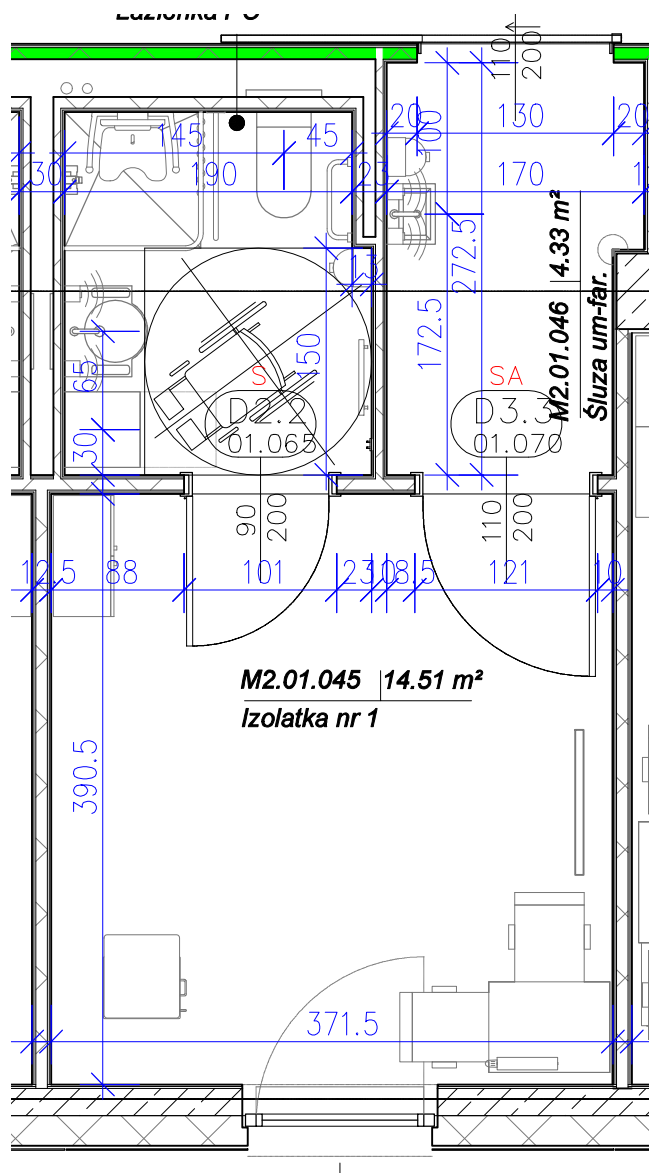


Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt




Lampa zabiegowa - 1 szt




Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt




Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt




Lampa zabiegowa - 1 szt




Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt



Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt



Lampa zabiegowa - 1 szt



Myjnia do kaczek i basenów - 1 szt

