

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



BB-PL
INTERREG V A
2014-2020

"Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen" / „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”

Gorzów Wlkp. 21.01.2021 r.

BZP.271.77.2020.AZ

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania: Dostawa wyposażenia pracowni CNC oraz pracowni obróbki metali

Na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (*tj. Dz. U. 2019r., poz. 1843*) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:

Dotyczy zamówienia częściowego nr 2


Pytanie 1

Poz. nr 1 - wysokościomierz - zakres pomiarowy 300 mm, odczyt 0,01 mm.

Zamawiający nie podał / określił typu konstrukcji wysokościomierza traserskiego jakiego wymaga. Wysokościomierze analogowe (noniuszowe) o konstrukcjach jak na zdjęciu 2 i 3 - nie występują (jak jest błędnie podawane w Internecie jako 0,01mm) z odczytem 0,01 mm, ich prawidłowy odczyt wynosi 0,1 mm. Dlatego parametry (wg kart katalogowych) spełniałby jedynie wysokościomierz z odczytem elektronicznym jak na zdjęciu 1.

Prosimy o określenie czy o tego typu przyrząd chodzi.


1.

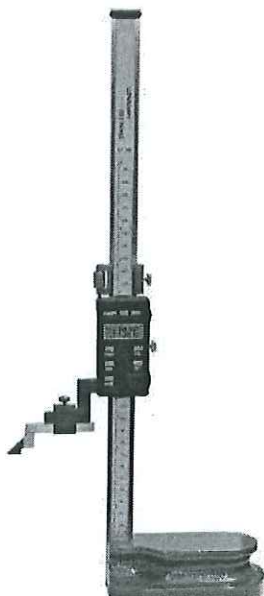

2.



3.

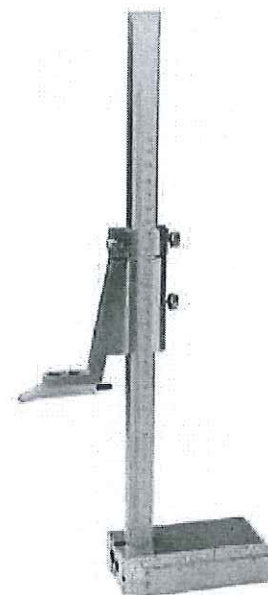

Odpowiedź:

Zamawiający podał w opisie parametry, jakie ma spełniać urządzenie. Jeżeli są Państwo w stanie zaoferować wysokościomierz z odczytem elektronicznym o takich parametrach to będzie on spełniał wymagania określone w SIWZ.

Powyzsze wyjaśnienia są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

Małgorzata Domagala
Zastępca Prezydenta Miasta