



SZP-ET/231/2021

Złotów, dnia 16.12.2021 r.

## Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr 20/ZP/2021

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego symbolem 20/ZP/2021, którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie”. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 1 i 5 ustawy Pzp udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:

### Pytanie nr 92

Część 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków combi za opakowania a'100 szt. z przeliczeniem ilości na 470 opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 93

Część 1, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowania a'250 szt. z przeliczeniem ilości na 24 opakowania?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 94

Część 1, pozycje 1 – 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania?

Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie może wydzielać pozycji do odrębnych części.**

### Pytanie nr 95

Część 1, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków z ostrym ostrzem o następujących parametrach:

Igła wykonana jest z wysokiej jakości materiałów przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje jej wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

- Igła o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona jest do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem
- Konstrukcja igły w najwyższym stopniu zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, a tym samym zabezpiecza przed zanieczyszczeniem pobieranego leku gumowymi skrawkami
- Boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczony na szczycie igły umożliwia swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku poprzez kierowanie płynu bezpośrednio na ścianki fiolek
- Igła wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- Nasadka igły idealnie dopasowana do końcówki Luer oraz Luer-Lock (zapewnienie pełnej szczelności połączenia ze strzykawkami)
- Igła oznaczona znakiem CE w pełni odpowiada wymogom normy PN-EN-ISO 7864 Dostępna w uniwersalnym rozmiarze 18G (1,2 x 30 mm)
- Jednorazowego użytku, sterylizowana tlenkiem etylenu

- Opakowanie jednostkowe zgodne z normami PN-EN556 i PN-EN 868, typu blister-pack
- Termin ważności: 5 lat?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza ponieważ brak jest wymaganego parametru dotyczącego filtra.**

**Pytanie nr 96**

Część 1, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne bez obturatora oraz ze średnicą w zakresie 0,7-1,7 (+/-8%) ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 97**

Część 1, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści igły 25Gx90 lub 25Gx120?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 98**

Część 1, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści igły 26Gx90 lub 26Gx120?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 99**

Część 1, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści igły 25Gx90 lub 27Gx90?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 100**

Część 1, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści igłę do penów 31G 0,25x6mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 101**

Część 1, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści igłę do penów 31G 0,25x8mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 102**

Część 1, pozycje 18-19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie może wydzielać pozycji do odrębnych części.**

**Pytanie nr 103**

Część 1, pozycje 26 -Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2ml z zakończeniem stożkowym typu luer umieszczonym centralnie?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 104**

Część 1, pozycje 26-29 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenia pojemności nominalnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozszerzoną skalę, jednakże nie dopuszcza 10% rozszerzenia pojemności nominalnej.**

**Pytanie nr 105**

Część 1, pozycje 33- Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą, czytelną skalą pomiarową?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 106**

Część 1, pozycje 34 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą, czytelną skalą pomiarową oraz wykonaną z polipropylenu (tłok) i poliwęglanu (cylinder)?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 107**

Część 1, pozycje 36 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z uszczelnieniem w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 108**

Część 1, pozycje 38 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wykonaną z PVC oraz wyposażony w igłę biorczą wykonaną z ABS bez wzmocnień włóknem szklanym?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych parametrów.**

**Pytanie nr 109**

Część 1, pozycje 39 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wykonaną z PVC bez opaski/gumki stabilizującej dren wewnątrz opakowania?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych parametrów.**

**Pytanie nr 110**

Część 1, pozycje 40 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacze bez opaski/gumki stabilizującej dren? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 111**

Część 1, pozycje 43 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z drenem o długości 145 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych parametrów.**

**Pytanie nr 112**

Część 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści cewniki ze zmrożoną powierzchnią ułatwiającą wprowadzanie oraz zapobiegającą przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 113**

Część 2, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren brzuszny, w rozmiarze CH 27 lub CH 30?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 114**

Część 2, pozycje 14-15 - Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe o długości 200 cm oraz odstąpi od wymogu by były wolne od ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowaną długość wąsów, jednakże nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu by drena były wolne od ftalanów.**

**Pytanie nr 115**

Część 2, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści dren Redon zwinięty w opakowaniu „w ślimak”, ze standardową końcówką (bez poszerzenia)?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych parametrów.**

**Pytanie nr 116**

Część 2, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści drena Kehra o długości ramion 450mm x 180mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 117**

Część 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 ( min 3 na min. 4 poziomie odporności) - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,23 (+/-0,02) mm, dłoni 0,19 (+/-0,01) mm, mankiecie 0,17 (+/-0,01) mm, długość min. 270mm. Zawartość protein

lateksowych poniżej 100 µg/g, średnia siła zrywu: przed starzeniem min 18N, po starzeniu min 15N - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,0-8,5?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaferowanych parametrów.**

#### **Pytanie nr 118**

Część 4, pozycja 1 -Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1,0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,12±0,02; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 µg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaferowanych parametrów.**

#### **Pytanie nr 119**

Część 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o parametrach:Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankiem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 18N, zawartość białek lateksowych max 10 µg/g - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,0-8,5.?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaferowanych parametrów.**

#### **Pytanie nr 120**

Część 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o długości minimum 292 mm i o zawartości protein max 23 ug/g?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie nr 121**

Część 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe ze siłą zrywu przed starzeniem min. 9N i grubością na palcu 0,16+/-0,02?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

#### **Pytanie nr 122**

Część 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o parametrach:

Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm, na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25µg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaferowanych parametrów.**

**Pytanie nr 123**

Część 5, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Welch Allyn CP-50 w bloku o wymiarach 114mm x 70mm x 250 kartek?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych parametrów. Zamawiający oczekuje papieru w rolkach.**

**Pytanie nr 124**

Część 7, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z balonem kontrolnym bez zaworka zwrotnego?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 125**

Część 7, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści rurkę bez podziałki centymetrowej?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 126**

Część 7, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik z 4 otworami bocznymi o łagodnych krawędziach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 4 otwory, natomiast pozostałe parametry poz. 11 muszą być zachowane.**

**Pytanie nr 127**

Część 15, pozycja 1 oraz 3 - Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe wykonane z przezroczystego, nietoksycznego PCV? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych parametrów.**

**Pytanie nr 128**

Część 15, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe ze standardowymi otworami, wykonane z przezroczystego, nietoksycznego PCV? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 129**

Część 15, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści nebulizator z drenem o długości 210 cm +/-5%?

- Wykonany z wysokiej jakości EVA, bez zawartości PVC
- Uniwersalne połączenie 15F/22M oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160cm
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Bezlataksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra lub 3 litrów
- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm
- Kolanko z portem luer-lock
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Do krótkotrwałego użytku (od 60 minut do 30 dni)
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka, opakowanie folia/papier

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 130**

Część 42, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści obwody oddechowe o następujących parametrach:

TYP	Średnica rur	Pojemność worka	Opakowanie transportowe
Dla dzieci	15 mm	1 litr	50 x 1 szt.
Dla dorosłych	22 mm	3 litry	40 x 1 szt.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 131**

Część 44, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek chirurgicznych wykonanych z trzech warstw niepyłającej włókniny polipropylenowej (Spunbond+Meltblown+Spunbond)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisanych w SWZ.**

**Pytanie nr 132**

Część 44, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek chirurgicznych z usztywnieniem na nos wykonanym z drucika stalowego powleczonego polietylenem (plastik)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 133**

Część 44, pozycja 3, 12-15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 134**

Część 44, pozycja 4-5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 135**

Część 44, pozycja 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk (50 par) z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 136**

Część 47 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem w rozmiarze 6 x 8 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 137**

Część 47 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75 cm z otworem Ø 7 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 138**

Część 47 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75 cm z otworem Ø 7 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 139**

Część 50 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z 2 warstwowego lamianatu (włóknina + folia)?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 140**

Część 52 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem plastikowym 3-komorowym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 141**

Część 52 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik instrumentalny 150cm x 100cm (owinięcie zestawu)?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 142**

Część 53 - Czy Zamawiający dopuści pensetę plastikową anatomiczną 13cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 143**

Część 53 - Czy Zamawiający dopuści serwety nieprzylepne o tolerancji wymiarów +/- 5cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 144**

Część 53 - Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną z otworem 6cm x 8cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 145**

Część 53 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę i igłę bez opakowań jednostkowych, co pozwoli na zminimalizowanie powstających odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 146**

Część 53 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkową miską nerkowatą służącą jako pojemnik na odpadki?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 147**

Część 53 - Czy Zamawiający dopuści 2 strzykawki z wodą jałową i 10% gliceryną 10 ml zamiast wody sterylnej w ampułce 20ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 148**

Część 53 - Czy Zamawiający dopuści żel poślizgowy w ampułkostrzykawce zamiast w saszetce?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 149**

Część 54, 55 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z rękawami o kroju prostym, zapewniającym swobodę ruchów?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 150**

Część 54, 55 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów ze szwami ultradźwiękowymi, trójścieżkowymi?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 151**

Część 54, 55 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z oznaczeniem rozmiaru poprzez nadruk z rozmiarówką oraz kolorową lamówkę adekwatną do rozmiaru?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 152**

Część 54, 55 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z ręcznikami chłonnymi w rozmiarze 30 x 30 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 153**

Część 54, 55 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w opakowaniu z 4 szt etykiet do dokumentacji?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 154**

Część 54 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o odporności na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym >100 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 155**

Część 55 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o odporności na przenikanie cieczy >20 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

#### Pytanie nr 156

Część 57 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego zestawu do cesarskiego cięcia, serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H<sub>2</sub>O. Skład:

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, czerwona

1 x serweta główna samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm, ze sztywnikiem oraz 2 portami do odsysania treści


1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm, włóknina spunlace 80g/m<sup>2</sup>

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny spunlace

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

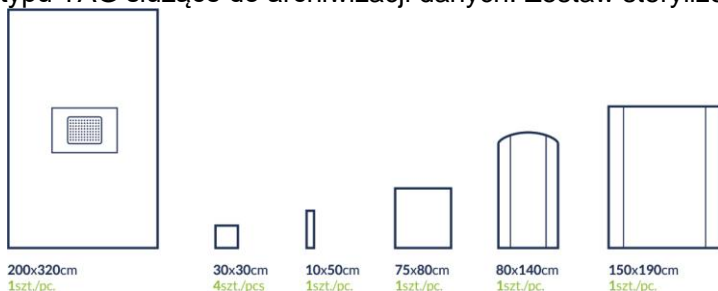

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

#### Pytanie nr 157

Część 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych o składzie: (różnice wyróżnione)

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma organizerami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma organizerami przewodów

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma organizerami przewodów, przylepiec na dłuższym boku

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny - owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H<sub>2</sub>O. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 158

Część 61 - Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną serwetę operacyjną, wzmocnioną w strefie krytycznej 180 x 180 cm (zamiast 170 x 175 cm)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 159

Część 61 - Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe min. 30cm x 30cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 160

Część 61 - Czy Zamawiający dopuści laminat dwuwarstwowy PE+PP wzmocniony chłonnym materiałem SM (spunbond, meltblown) o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>?



**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 161**

Część 61 - Czy Zamawiający dopuści gramaturę serwet w części podstawowej min. 55 g/m<sup>2</sup>, we wzmocnionej min. 110 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 162**

Część 61 - Czy Zamawiający dopuści parametry części wzmocnionej:

- Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >172 kPa;
- Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny >180 kPa;
- Odporność na penetrację płynów (chłonność) >197 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 163**

Część 61 - Czy Zamawiający dopuści odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu zintegrowane z etykietą główną znajdującą się wewnątrz opakowania zestawu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 164**

Część 62 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana o składzie:

1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym o średnicy 7 cm, torba wyposażona w sztywnik, dwa przylepce, oraz port do odsysania treści

1 x serweta dodatkowa wzmocniona na stół instrumentalny 150 cm x 190 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 165**

Część 63 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet operacyjnych na dłoni/stopie, z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O, o składzie:

1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, pad chłonny 75 x 100 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**


**Pytanie nr 166**

Część 65 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet operacyjnych do zabiegu chirurgii ręki, z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O, o składzie:

1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, pad chłonny 75 x 100 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm



**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

#### Pytanie nr 167

Część 66 - Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny wzmocniony:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm


1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm



**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

#### Pytanie nr 168

Część 69 - Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep w rozmiarze 2 x 22 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 169

Część 72, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o szer. 50 cm i długości 50 m z perforacją co 38 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 170

Część 72, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o szer. 58 cm i długości 50 m z perforacją co 38 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 171

Część 72, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o szer. 38 cm z perforacją co 50 cm oraz długości 40 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 172

Część 72, pozycja 3-4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 173**

Część 72, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie prześcieradła w kolorze białym w rozmiarze 80x210cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 174**

Część 72, pozycja 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu o średnicy tunelu 4 cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 175**

Część 101, pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii poliuretanowej o grubości 0,03mm, min 2 cm części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający - system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację, bez etykiet samoprzylepnych do dokumentacji. Klasa I sterylna.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 176**

Część 101, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii w rozmiarze 40 x 42 cm, część lepna 40 x 36 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 177**

Część 101, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii w rozmiarze 45 x 55 cm, część lepna 45 x 49 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 178**

Część 110, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków jednorazowego użytku? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 179**

Część 110, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki w kolorze czarnym?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 180**

Część 110, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści stazy bezlateksowe w kolorze niebieskim bądź różowym pakowane w rolki po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 181**

Część 110, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane w opak. a'24 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 182**

Pakiet nr 15 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnej maski tlenowej z drenem wykonanej z delikatnego medycznego PVC w rozmiarze uniwersalnym standardowym dla dorosłych oraz w rozmiarze dla dzieci, mikrobiologicznie czystej ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowane parametry.**

**Pytanie nr 183**

Pakiet nr 15 poz. 3,4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnej maski tlenowej z nebulizatorem oraz drenem wykonanej z delikatnego medycznego PVC w rozmiarze uniwersalnym standardowym dla dorosłych oraz w rozmiarze dla dzieci, mikrobiologicznie czystej?


**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowane parametry.**

**Pytanie nr 184**

Pakiet nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny:


Łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń, sterylny, do wentylacji pacjenta. Pozbawiony PCV oraz ftalanów, uniwersalne połączenie 22M/15F-22M umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów. Wersja rozciągliwa umożliwia zapamiętanie kształtu. Podwójnie obrotowe kolanko. Otwór do odsysania oraz bronchoskopii.?



**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.**

lub

Łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń, sterylny, do wentylacji pacjenta z PCV bez ftalanów, uniwersalne połączenie 22M/15F-22M umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów. Wersja gładka wewnątrz zapobiegająca zaleganiu bakterii. Podwójnie obrotowe kolanko. Otwór do odsysania oraz bronchoskopii.?




**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowane parametry.**

**Pytanie nr 185**

Pakiet 42 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy karbowany o stałej długości, z zachowaniem pozostałych parametrów?



**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowane parametry.**

Lub

Czy Zamawiający dopuści obwód rozciągliwy w zakresie 60-180cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?



**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt.**

**Pytanie nr 186**

pakiet nr 104

Dot. poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie kaniul nosowych zakończonych adapterem o śr. 10 mm, bez dodatkowego adaptera.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 187**

pakiet nr 104

Dot. poz. 2 Czy Zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 188**

pakiet nr 104

Dot. poz. 3 Czy Zamawiający wymaga zaofierowania czapeczki oraz czepecza do terapii wymiennych stosowanych zamiennie? Czepecz do terapii wymiennych posiada konstrukcji w formie opaski, dzięki czemu można regulować go do aktualnego rozmiaru i fizjologicznego kształtu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki i redukując ilość zużywanych mocowań w trakcie terapii. Proponowane mocowanie gwarantuje możliwość dostępu do naczyń w dowolnym miejscu na głowie pacjenta, sterowanie szczelnością poprzez tworzenie tzw. garbu lub niecki, zmniejszenie ilości urazów tkanek nosa i powiek terapii oraz obniżenie kosztów ich leczenia, uzyskania takiej stabilności połączeń, która wpływa na ograniczenie ilości niepowodzeń terapii.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 188a**

Pakiet nr 104.



Dot. poz. 4 Prosimy o dopuszczenie układu z grzałką niewtopioną w ściany odcinka wdechowego.







**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**




**Pytanie nr 189**





Zadanie nr 8 Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania narzędzia jak niżej:




Nr poz.	Pytanie	Zdjęcie poglądowe
1	<p>Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER 200 mm odgięte 1x2 ząbki</p> <p><b>Odpowiedź: poniżej tabeli</b></p>	
2	<p>Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER 200 mm proste 1x2 ząbki</p> <p><b>Odpowiedź: poniżej tabeli</b></p>	





4	<p>Kleszczyki naczyniowe typu PEAN-DELICATE 140 mm odgięte</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p>130 mm (5 1/8") 04-413 04-414  140 mm (5 1/2") 04-084 04-087  160 mm (6 1/4") 04-085 04-088  180 mm (7 1/8") 04-086 04-089</p> <p>PEAN-DELICATE</p>
5	<p>Kleszczyki naczyniowe typu PEAN DELICATE 140 mm proste</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p>130 mm (5 1/8") 04-413  140 mm (5 1/2") 04-084  160 mm (6 1/4") 04-085  180 mm (7 1/8") 04-086</p> <p>PEAN-DELICATE</p>
6	<p>Kleszczyki naczyniowe typu MIKULICZ 200 mm odgięte 1x2 ząbki</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p>1/1</p> <p>04-224 delikatne /fein /delicate  04-224/M mocne /kräftig /strong</p> <p>MIKULICZ  1x2  200 mm (8")</p>
6	<p>Kleszczyki naczyniowe typu MIKULICZ 200 mm odgięte 1x2 ząbki mocne</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	
9	<p>Kleszczyki naczyniowe typu HALSTED-MOSQUITO 125 mm odgięte</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p>04-012  125 mm  (5")</p> <p>HALSTED-MOSQUITO</p>
10	<p>Kleszczyki naczyniowe typu HALSTED-MOSQUITO 140 mm odgięte</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p>04-013  140 mm  (5 1/2")</p> <p>HALSTED-MOSQUITO</p>
11	<p>Nożyczki chirurgiczne do bandaży typu ESMARCH</p>	






	220 mm odgięte <b>Odpowiedź: tak</b>	
11	Nożyczki chirurgiczne do bandaży typu ESMARCH 240 mm odgięte  <b>Odpowiedź: tak</b>	
12	Nożyczki chirurgiczne do bandaży typu LISTER 190 mm odgięte z tw. wkładką, uchwyty złożone  <b>Odpowiedź: tak</b>	 <p><b>LISTER</b> 03-509 190 mm (7 1/2")</p>
16	Nożyczki chirurgiczne typu BABY-METZENBAUM dł. 145 mm odgięte końce tępe  <b>Odpowiedź: tak</b>	 <p>03-141 115 mm (4 1/2") 03-097 145 mm (5 3/4")</p> <p><b>BABY-METZENBAUM</b> lepo tepe odgięte stumpf/stumpf gebogen blunt/blunt curved</p>
18	Kaniule do płukania z oliwką , śr. 2,0 mm, dł 80mm, wejście gniazdowe typu Luer  <b>Odpowiedź: tak</b>	 <p><b>ST 8621</b> (2,0 mm) 80 mm</p>






<p>19</p>	<p>Kaniula, dł. 160 mm, śr. 4,0 mm, prosta z oliwką</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p>KD 25 ∅ 4,0mm</p> <p>KD 25/1 ∅ 4,0mm</p> <p>1/1 mm</p> <p>Kończówka ∅ 3 mm Olive diam. 3 mm Olive 3 mm Olivenkauf 3 mm</p> <p>1/1</p> <p>KD 25 3,3 mm x 160 mm (6 1/4")</p>
<p>20</p>	<p>Łyżeczka typu SCHEDE szer. końcówki 3,4 mm, dł. 170 mm</p> <p><b>Odpowiedź: nie</b></p>	 <p>09-711 2,5 mm</p> <p>09-712 3,4 mm</p> <p>09-713 4,2 mm</p>
<p>20</p>	<p>Łyżeczka typu SCHEDE szer. końcówki 4,2 mm, dł. 170 mm</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p>SCHEDE 170 mm (6 3/4")</p>
<p>21</p>	<p>Sonda typu PROBE dł. 160 mm podwójnie zakończona, końcówka ∅ 2 mm</p> <p><b>Odpowiedź: nie</b></p>	 <p>1/1</p> <p><b>PROBE</b> podwójnie zakończona prosta, dł. końcówki 2 mm /doppelt beendete, Länge von der Spitze 2mm /double ended straight, length of the end 2mm <b>08-008</b> 160 mm (6 1/4")</p>












<p>21</p> <p>Sonda typu BOWMAN podwójnie zakończona ze srebra rozmiar 1-2</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>		 <p><b>BOWMAN LACRIMAL PROBES</b> 08-010 - 08-015 130 mm (5 1/8")</p> <p>podwójnie zakończona, prosta /doppelt beendet, gerade /double ended, straight</p> <p><b>08-010</b> 0,5 + 0,6 mm, 000-000, <b>08-011</b> 0,7 + 0,8 mm, 00-0, <b>08-012</b> 0,9 + 1,1 mm, 1-2, <b>08-013</b> 1,3 + 1,4 mm, 3-4, <b>08-014</b> 1,5 + 1,6 mm, 5-6, <b>08-015</b> 1,8 + 1,9 mm, 7-8,</p>
<p>21</p> <p>Sonda typu WILLIAM podwójnie zakończona ze srebra rozmiar 1-2</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>		 <p><b>WILLIAM LACRIMAL PROBES</b> 08-016 - 08-021</p> <p>podwójnie zakończona, prosta /doppelt beendet, gerade /double ended, straight</p> <p><b>08-016</b> Sonda William, 000-0000, <b>08-017</b> Sonda William, 00-0, <b>08-018</b> Sonda William, 1-2,</p>
<p>25</p> <p>Igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR dł. 140 mm prosty</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>		 <p>130 mm (5 1/8") 06-600 140 mm (5 1/2") <b>06-601</b> 160 mm (6 1/4") 06-602 06-608 180 mm (7 1/8") 06-603 06-609 200 mm (8") 06-604 06-610 240 mm (9 1/2") 06-605 06-611 260 mm (10 1/4") 06-606 06-612 300 mm (12") 06-607 06-611'</p> <p>MAYO-HEGAR</p>




<p>28</p>	<p>Igłotrzymacz typu WEBSTER dł. 127 mm prosty z tw. wkładką</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	
<p>29</p>	<p>Pinceta do tęczówki, chirurgiczna, dł. 100 mm, czubek 1 mm, 1x2 ząbki, prosta</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	
<p>29</p>	<p>Pinceta mikrochirurgiczna, dł. 110 mm, czubek 1 mm, 1x2 ząbki, prosta</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	
<p>29</p>	<p>Pinceta mikrochirurgiczna typu MIKRO-ADSON, dł. 105 mm, czubek 0,6 mm, 1x2 ząbki, prosta</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	

<p>36</p>	<p>Pinceta typu MASTERLIGHT DE BAKEY, dł. 180 mm, czubek 1,2 mm, długość przefrezowania typu DE BAKEY od czubka na długości 20-25 mm, prosta</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <table border="1" data-bbox="1276 190 1396 504"> <tr> <td>150 mm (6")</td> <td>CN 100</td> </tr> <tr> <td>150 mm (6")</td> <td>TITANIUM CN 100T</td> </tr> <tr> <td>195 mm (7 3/4")</td> <td>CN 101</td> </tr> <tr> <td>195 mm (7 3/4")</td> <td>TITANIUM CN 101/T</td> </tr> <tr> <td>240 mm (9 3/4")</td> <td>CN 103</td> </tr> <tr> <td>240 mm (9 3/4")</td> <td>TITANIUM CN 103/T</td> </tr> <tr> <td>300 mm (12")</td> <td></td> </tr> <tr> <td>300 mm (12")</td> <td>TITANIUM</td> </tr> </table>	150 mm (6")	CN 100	150 mm (6")	TITANIUM CN 100T	195 mm (7 3/4")	CN 101	195 mm (7 3/4")	TITANIUM CN 101/T	240 mm (9 3/4")	CN 103	240 mm (9 3/4")	TITANIUM CN 103/T	300 mm (12")		300 mm (12")	TITANIUM
150 mm (6")	CN 100																	
150 mm (6")	TITANIUM CN 100T																	
195 mm (7 3/4")	CN 101																	
195 mm (7 3/4")	TITANIUM CN 101/T																	
240 mm (9 3/4")	CN 103																	
240 mm (9 3/4")	TITANIUM CN 103/T																	
300 mm (12")																		
300 mm (12")	TITANIUM																	
<p>36</p>	<p>Pinceta anatomiczna typu MEDIUM, dł. 180 mm, czubek 2,5 mm, prosta, z tytanu</p> <p><b>Odpowiedź: nie</b></p>	 <p>2,5 mm</p> <p>CO 183 180 mm (7")</p>																
<p>38</p>	<p>Nożyce do drutu dł. 170 mm</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p>09-542 09-543</p>																
<p>38</p>	<p>Nożyce do drutu dł. 170 mm</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p>kleszce do trzymania drutu /Drahtfasszangen /wire holding 170 mm (6 3/4")</p>																
<p>39</p>	<p>Nożyce do gięcia i cięcia drutu dł. 160 mm delikatne Delfinki</p> <p><b>Odpowiedź: nie</b></p>	 <p>09-610 160 mm (6 1/4") kleszce do gięcia i cięcia drutu</p>																

39	<p>Nożyce do cięcia drutu dł. 220 mm</p> <p><b>Odpowiedź: nie</b></p>	 <p><b>09-553</b> Do drutów: 220 mm (8 3/4") miękki max. 3,5 mm twardy max. 2,5 mm</p>
39	<p>Nożyce do cięcia drutu typu DIAMAND PIN dł. 160 mm</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p><b>09-552</b> Do drutów: 160 mm (6 1/4") miękki max. 2,0 mm twardy max. 2,0 mm</p>
39	<p>Nożyce do cięcia drutu dł. 180 mm z twardą wkładką</p> <p><b>Odpowiedź: nie</b></p>	 <p><b>09-595</b> 180 mm (7 1/8") <b>09-596</b> 210 mm (8 1/4") kleszcze do cięcia drutu /Drahtschneidezangen/wire cutters Do drutów: miękki max. 3,0 mm twardy max. 2,5 mm</p>
39	<p>Nożyce do cięcia drutu Kirchnera typu WIRE CUTTERS dł. 180 mm do 2,5 mm</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p><b>09-604</b> 180 mm (7 1/8") <b>09-605</b> 220 mm (8 3/4") kleszcze do cięcia drutu /Drahtschneidezangen /wire cutters Do drutów: miękki max. 2,5 mm twardy max. 2,2 mm</p>
41	<p>Wziernik dopochwowy typu</p>	

	<p>KALLMORGEN końcówki 90 X 40 mm + Wziernik dopochwowy typu KALLMORGEN końcówki 90 X 33 mm</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	
42	<p>Wziernik dopochwowy typu KALLMORGEN końcówki 70 X 40 mm + Wziernik dopochwowy typu KALLMORGEN końcówki 70 X 33 mm</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	
43	<p>Nożyczki chirurgiczne typu BRAUN- STADLER 140 mm odgięte</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p><b>BRAUN-STADLER</b> <b>03-318</b> 140 mm (5 1/2")</p>
43	<p>Nożyczki chirurgiczne do bandaży typu LISTER 140 mm odgięte</p> <p><b>Odpowiedź: nie</b></p>	
43	<p>Nożyczki chirurgiczne do bandaży typu LISTER 150 mm odgięte</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p><b>03-308</b> 115 mm (4 1/2") <b>03-309</b> 140 mm (5 1/2") <b>03-310</b> 150 mm (6") <b>03-311</b> 180 mm (7 1/8")</p> <p><b>LISTER</b></p>

46	<p>Nożyczki chirurgiczne typu BABY-METZENBAUM dł. 145 mm odgięte końce delikatnie tępo-tępo</p> <p><b>Odpowiedź: nie</b></p>	
46	<p>Nożyczki preparacyjne typu BABY-METZENBAUM-FINO dł. 145 mm odgięte końce tępe delikatne</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	
48	<p>Hak chirurgiczny bez nazwy własnej, dł. 260 mm?</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	
50	<p>Kleszce do zdejmowania klamer typu MICHEL dł. 120 mm</p> <p><b>Odpowiedź poniżej tabeli</b></p>	 <p>MICHEL 06-084 120 mm (4 3/4")</p>
50	<p>Kleszce do zdejmowania klamer typu MICHEL dł. 130 mm</p> <p><b>Odpowiedź poniżej tabeli</b></p>	
50	<p>Kleszce do zdejmowania klamer typu MOD. MICHEL</p> <p><b>Odpowiedź poniżej tabeli</b></p>	 <p>MOD. MICHEL 06-085 120 mm (4 3/4")</p>

50	<p>Kleszce do zdejmowania klamer typu COLLIN</p> <p><b>Odpowiedź poniżej tabeli</b></p>	 <p>COLLIN 06-086 130 mm (5 1/8")</p>
50	<p>Kleszce do zdejmowania klamer typu RICHTER-HEATH</p> <p><b>Odpowiedź poniżej tabeli</b></p>	 <p>RICHTER-HEATH 06-087 140 mm (5 1/2")</p>
51	<p>Łyżeczka kostna typ SIMON dł. 240 mm figura 000 główka owalna szerokość 3,6mm</p> <p><b>Odpowiedź: tak</b></p>	 <p>SIMON 240 mm (9 1/2")</p>

**Odpowiedź:**

**Ad.:**

- 1 – Tak, pod warunkiem zachowania parametru dotyczącego skoku ząbków (skok ząbków 1mm).
- 2 – Tak, pod warunkiem zachowania parametru dotyczącego skoku ząbków (skok ząbków 1mm).
- 4- Tak, Zamawiający dopuszcza.
- 5- Tak, Zamawiający dopuszcza.
- 6- Tak, Zamawiający dopuszcza.
- 6- Tak, Zamawiający dopuszcza.
- 9- Tak, Zamawiający dopuszcza.
- 10- Tak, Zamawiający dopuszcza.
- 11- Tak, Zamawiający dopuszcza.
- 11- Tak, Zamawiający dopuszcza.
- 12- Tak, Zamawiający dopuszcza.
- 16- Tak, Zamawiający dopuszcza.
- 18- Tak, Zamawiający dopuszcza.
- 19- Tak, Zamawiający dopuszcza.
- 20- Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
- 20- Tak, Zamawiający dopuszcza.
- 21 - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

21 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

21 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

25 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

28 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

29 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

29 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

29 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

36 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

36 - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

38 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

38 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

39 - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

39 - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

39 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

39 - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

39 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

41 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

42 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

43 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

43 - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

43 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

46 - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

46 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

48 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

50 x 5 zapytań – Zamawiający wymaga kompatybilności oferowanego urządzenia do usuwania zszywek przeznaczonych do zszywania skóry zszywkami kompatybilnymi ze staplerem skórnym Manipler firmy B Braun.

51 - Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie nr 190

Zadanie nr 125 Artykuły jednorazowego użytku dla niemowląt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produktu alternatywny, jak niżej:

Okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta. Wykonane z:

- materiału nie zawierającego lateksu,

- hypoalergiczne, dobrze przylegające wielopunktowo do skóry na zasadzie bioadhezji,

- bezklejwe (dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych.

Wykonanie okularków gwarantuje szczelne ich przyleganie, nie przemieszczają się, nawet podczas zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.

Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:

Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm ( najmniejsze noworodki/ wcześniaki), rozm. głowy poniżej 28 cm

Rozmiar 1 110 x 47 mm ( noworodki o drobnej budowie główki), rozm. głowy 28-34 cm


Rozmiar 2 130 x 60 mm ( wielkość główki - typowa); rozm. głowy powyżej 34 cm,

Każda sztuka pakowana pojedynczo z oznakowaniem rozmiaru.

Dla

125.1- Proponowany rozmiar 0

125.2 Proponowany rozmiar 1



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry, jednakże stawia wymóg możliwości regulacji opaski na główce pacjenta oraz zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie



**nr 12 Zamawiający wymaga, aby okulary posiadały wklęsnięcia od strony oczodołów, co umożliwi fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką.**

**Pytanie nr 191**

PAKIET 56

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych o parametrach zgodnych z SWZ, jednakże posiadających dwie kieszenie oraz dostępnych w rozmiarach S,M,L,XL,XXL?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 192**

PAKIET 60

Poz. nr 1 – czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- serweta z przylepcem 240 cm x 150 cm - 1 szt.,
- serweta z przylepcem 200 cm x 175 cm - 1 szt.,
- serweta z przylepcem- przylepiec na szerszym boku 90 cm x 75 cm - 2 szt.,
- taśma medyczna 50 cm x 10 cm - 1 szt.,
- serweta na stół instrum. 190 cm x 150 cm - 1 szt.,
- serweta na stolik mayo 145 cm x 80 cm - 1 szt.,
- serwetki do rąk 30 cm x 33 cm - 4 szt.

Zestaw wykonany z włókniny 2 warstwowej - włóknina foliowana polipropylenowo - polietylenowa gramatura min. 55g/m<sup>2</sup>, chłonność warstwy zewnętrznej 156 ml/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. 158 cm H<sub>2</sub>O;. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 193**

PAKIET 61

Poz. nr 1 - czy Zamawiający uznaje podany skład Zestawu uniwersalnego II za skład minimalny?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający uznaje podany skład za minimalny.**

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu zawierającego w swoim składzie ręczniki w rozmiarze 30 cm x 33 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 194**

PAKIET 62

Poz. nr 1 - czy w Zestawie do artroskopii kolana nastąpiła pomyłka w podaniu rozmiaru osłony na stolik? Czy Zamawiający dopuszcza serwetę (owinięcie zestawu) w rozmiarze 150 x 190cm oraz dodatkową serwetę na stolik w rozmiarze 150 x 190cm?

**Odpowiedź: Nie nastąpiła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia, jednakże Zamawiający dopuszcza zaproponowany rozmiar.**

**Pytanie nr 195**

PAKIET 63

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych na dłoni/stopie zawierającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 196**

PAKIET 64

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu pionowego izolacyjnego zgodnego z SWZ, jednakże w którym ręczniki celulozowe mają rozmiar 30 x 33 cm, natomiast serweta na stolik narzędziowy ma rozmiar 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 197**

PAKIET 65

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych do zabiegów chirurgii ręki zawierającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 198**

PAKIET 66

Poz. nr 1 - czy nastąpiła pomyłka w podaniu rozmiaru serwety na stolik narzędziowy? Czy Zamawiający wymaga serwety w rozmiarze 150 x 190cm?

**Odpowiedź: Nastąpiła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji załącznika nr 1a do SWZ w tym zakresie.**

**Pytanie nr 199**

Pakiet 1, poz. 11-14

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie może wydzielać pozycji do odrębnych części.**

**Pytanie nr 200**

Pakiet 1, poz. 15

Proszę o dopuszczenie igieł do pena w rozmiarze 29G x 12,7 mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 201**

Pakiet 1, poz. 17

Proszę o dopuszczenie igieł do pena w rozmiarze 32G x 8 mm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 202**

Pakiet 1, poz. 18-21

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie może wydzielać pozycji do odrębnych części.**

**Pytanie nr 203**

Pakiet 1, poz. 23-25

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie może wydzielać pozycji do odrębnych części.**

**Pytanie nr 204**

Pakiet 1, poz. 26-29

Proszę o dopuszczenie strzykawek z kontrastującym, niebieskim tłokiem, w celu lepszej wizualizacji zawartości.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 205**

Pakiet 1, poz. 29

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 206**

Pakiet 1, poz. 35

Proszę o dopuszczenie strzykawki innej firmy niż B. Braun.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego kompatybilnego z pompą infuzyjną Ascor AP14.**

**Pytanie nr 207**

Pakiet 1, poz. 36

Proszę o dopuszczenie strzykawek z podwójnym uszczelnieniem tłoka.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 208**

Pakiet 1, poz. 36

Proszę o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 5-6 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozszerzoną skalę w przypadku strzykawki 5 ml tj. możliwość zaoferowania strzykawki 5-6ml.**

**Pytanie nr 209**

Pakiet 1, poz. 38

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości komory kroplowej 55 mm w części przezroczystej

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 210**

Pakiet 1, poz. 38

Proszę o dopuszczenie przyrządu ze standardowym kolcem

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 211**

Pakiet 1, poz. 38-39

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 212**

Pakiet 1, poz. 38-39

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo importera zamiast producenta na wyrobie

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 213**

Pakiet 1, poz. 38-39

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez opaski mocującej dren.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 214**

Pakiet 1, poz. 43

Proszę o dopuszczenie przyrządu z drenem o długości 150 cm

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 215**

Pakiet 15, poz. 5

Proszę o dopuszczenie Nebulizatora z maską zamiast ustnika

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 216**

Pakiet 44, poz. 7-8

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie może wydzielać pozycji do odrębnych części.**

**Pytanie nr 217**

Pakiet 44, poz. 13

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 218**

Pakiet 44, poz. 14

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie może wydzielać pozycji do odrębnych części.**

**Pytanie nr 219**

Pakiet 44, poz. 15

Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 220**

Czy Zamawiający dopuści w Części 128, poz. nr 1:

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłaniającą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 80 µm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów średnia 0,98 mm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych zapobiega deformacji w kierunku skośnym, który jest kierunkiem decydującym jeśli chodzi o deformację, podwójna nić wzmacniająca), wytrzymałość 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych parametrów.**

**Pytanie nr 221**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 z części 128 i utworzy odrębną część? Wyłączenie pozycji 1 do osobnej części pozwoli na znaczne zwiększenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie może wydzielać pozycji do odrębnych części.**

**Pytanie nr 222**

Pakiet 9, poz. 2

prosimy o wydzielenie pozycji 2 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów MACINTOSH 1 do 4, MILLER 0

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie może wydzielać pozycji do odrębnych części. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zakres rozmiarów.**

**Pytanie nr 223**

Pakiet 115

prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni aktywnej 107 cm<sup>2</sup>, spełniającej pozostałe wymogi.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.**

**Pytanie nr 224**

Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczzonego zapytania ofertowego, czy jednym z wymogów w rzeczonym postępowaniu jest to aby dopuszczone zostały tylko paski i glukometry które spełniają w całości normę ISO 15107: 2015 wraz z obowiązującym dla tej normy hematokrytem, w pełnym zakresie normy 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych na listach refundacyjnych? Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełnienia normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie a tym samym nie stawia powyższego wymogu.**

**Pytanie nr 225**

Czy Zamawiający wymaga w/w postępowaniu ofertowym na paski w części 111 do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ lub sami wytwórcy wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA nie OEM zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu.**

**Pytanie nr 226**

Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym postępowaniu w części 111 w specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków Glucomaxx inne wyroby, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie, którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?

**Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określa marki glukometru ani marki pasków do glukometrów a tym samym konieczności kompatybilności pasków z konkretnymi glukometrami.**

**Pytanie nr 227**

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 228**

Pakiet 10 ; poz. 1-9

- Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jedynie posiadania zewnętrznego opakowania zabezpieczającego oferowane rękawy papierowo-foliowe.**

- Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm<sup>2</sup> zgodnie z normą PN 868 ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu.**

- Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

**Odpowiedź: Tak, powinna znajdować się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w między innymi w języku polskim.**

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów gdzie zalecana temp. zgrzewania jest w przedziale od 100-200 stopni C.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 229**

Pakiet 10 ; poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo-foliowy o rozmiarze 20cm x200m w zamian za rozmiar 18cmmx200m?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 230**

Pakiet 11 ; poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autoczytnika, który jest kompatybilny z testami ampułkowymi z pozycji 1 w pakiecie 11? Autocznik z pozycji 2 w w/w pakiecie nie będzie kompatybilny z żadnym testem ampułkowym o parametrach jakie Zamawiający określił w pozycji 1 w pakiecie nr 11.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż modyfikacją załącznika nr 1a do SWZ z dnia 03 grudnia 2021 poprawił części 11 – Sterylizacja – autoczytnik, wskaźnik w pozycji nr 1. Zamawiający prosi o sprawdzenie na stonie prowadzonego postępowania komunikatu Zamawiającego z dnia 03.12.2021.**

**Pytanie nr 231**

Dot pakietu 111

Czy Zamawiający dopuści płyny kontrolne na dwóch różnych poziomach (wysoki i niski)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 232**

dotyczy Zapisów SWZ

W związku z rozbieżnościami w zapisach SWZ, prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dołączenia JEDZ do oferty przetargowej czy na wezwanie zgodnie z art. 126.1 ustawy pzp?

**Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem III ust. 2 SWZ oraz rozdziałem X ust. 3 SWZ, Zamawiający wyraźnie zaznaczył, że będzie wymagał JEDZ tylko od Wykonawcy najwyższej ocenionego.**

**Pytanie nr 233**

dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości pojedynczej ścianki na placu min. 0,07mm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 234**

dotyczy Pakietu nr 3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1,5. Poziom taki wymagany jest zgodnie z normą EN 455-1. Stawianie wymogu poziomu AQL ≤1,0 jest dyskryminujące i ogranicza zasadę konkurencyjności i równego traktowania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w powyższym zakresie oraz podtrzymuje swoje stanowisko udzielając odpowiedzi na pytanie nr 23 z dnia 03.12.2021 r.**

**Pytanie nr 235**

dotyczy Pakietu nr 45 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety gazowej niepranej, posiadającej 2 etykiety służące do umieszczania w karcie pacjenta, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 236**

dotyczy Pakietu nr 45 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety gazowej wstępnie pranej, nieposiadającej etykiety służącej do umieszczania w karcie pacjenta, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 237**

dotyczy Pakietu nr 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 238**

dotyczy Pakietu nr 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 239**

dotyczy Pakietu nr 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 79x145cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 240**

dotyczy Pakietu nr 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o wymiarach 75x90cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 241**

dotyczy Pakietu nr 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony - niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmocniony wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropyleny o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 100 cm H<sub>2</sub>O. Kolor niebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – trzyścieżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny o długości min. 6cm, oznaczenie rozmiaru i rodzaju w postaci nadruku, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobowy papier krepowy 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30,5x34cm. Na opakowaniu rodzaj sterylizacji oraz 4 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nawę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 242**

dotyczy Pakietu nr 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy – min. 40 cm H<sub>2</sub>O. Kolor niebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – trzyścieżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny o długości min. 6cm, oznaczenie rozmiaru i rodzaju w postaci nadruku, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobowy papier krepowy 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30,5x34cm. Na opakowaniu rodzaj sterylizacji oraz 4 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nawę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 243**

dotyczy Pakietu nr 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego kompletu chirurgicznego?

Komplet chirurgiczny z włókniny – wykonany z antystatycznej miękkiej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i dwiema kieszeniami w dolnej części. Rękaw prosty, niepodwinięty i nieobszty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, niepodwinięte i nieobszty. Komplet jednorazowy, niesterylny. Klasa I. Zgodność z EN 13795 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych). Rozmiary: S, M, L, XL, XXL.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 244**

dotyczy Pakietu nr 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia (pozycja leżąca) - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przenikanie cieczy – 165 cm H<sub>2</sub>O.

Skład: 1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu).

Zestaw w opakowaniu typu „folia-Tyvec”, posiadającym 4 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nawę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Na opakowaniu zbiorczym kolorową informację o sposobie sterylizacji.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 245**

dotyczy Pakietu nr 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody składanej teleskopowo o wymiarach 15x250cm, z prostą końcówką, 1 taśmą przylepną i 2 pierścieniami elastycznymi?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 246**

dotyczy Pakietu nr 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody składanej teleskopowo o wymiarach 15x240cm, z perforowaną końcówką i 2 taśmami przylepnymi?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 247**

dotyczy Pakietu nr 59



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o wymiarach 9x50cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 248**

dotyczy Pakietu nr 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw uniwersalny 2-warstwowy.

Skład zestawu: serweta z przylepcem 240cmx150cm - 1 szt., serweta z przylepcem 180x180cm - 1szt., serweta z przylepcem- przylepiec na szerszym boku 90cmx75cm - 2 szt., taśma medyczna 50 cmx9cm - 1 szt., serweta na stół instrum. 190cmx150cm - 1 szt., serweta na stolik mayo 145cmx79cm - 1 szt., serwetki do rąk 30,5x34cm - 2 szt.

Włóknina 2 warstwowa - włóknina foliowana polipropylenowo - polietylenowa gramatura 60g/m<sup>2</sup>, chłonność warstwy zewnętrznej 458%, odporność na przenikanie cieczy 165cm H<sub>2</sub>O; Asortyment spełnia wymogi aktualnej normy EN 13795 1:2019; Asortyment musi być sterylizowany w walidowanym procesie zgodnie z normą dla tlenu etylenu 11135-1, dla radiacji 11137-1,2; Każdy zestaw powinien być zaopatrzony w etykietę w j.polskim umieszczoną na zewnątrz op. oraz 4 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nawę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Odporność na przenikanie cieczy zbyt niska.**

**Pytanie nr 249**

dotyczy Pakietu nr 62

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do artroskopii kolana, w skład którego wchodzi:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Zestaw spełnia wymagania wysokie wg normy EN 13795-1:2019. Materiał serwety głównej składający się z trzech warstw (folia delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna warstwa polipropylenowa) o łącznej gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 250**

dotyczy Pakietu nr 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet operacyjnych na dłoni/stopie, barierowych, wykonanych i chłonnego i nieprzemakalnego laminatu składającego się z 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 60g/m<sup>2</sup>, w części wzmocnionej 140g/m<sup>2</sup> i odporności na penetrację płynów 165 cmH<sub>2</sub>O - o składzie:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Odporność na penetrację płynów zbyt niska.**

#### **Pytanie nr 251**

dotyczy Pakietu nr 65

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet operacyjnych na dłoni/stopie, barierowych, wykonanych i chłonnego i nieprzemakalnego laminatu składającego się z 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 60g/m<sup>2</sup>, w części wzmocnionej 140g/m<sup>2</sup> i odporności na penetrację płynów 165 cmH<sub>2</sub>O - o składzie:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Odporność na penetrację płynów zbyt niska.**

**Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  
Marcin Druszcz

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/543425>)

2. a/a

Sporządził: Bożena Schmidt – Dział Techniczno-Administracyjny,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: [przetargi@szpital.zlotow.pl](mailto:przetargi@szpital.zlotow.pl)