



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama - Kościalkowskiego**

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 20 listopada 2024 r.

DZP.2344.46.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dzierżawę automatycznej platformy analitycznej z modułem biochemicznym i immunochemicznym na okres 36 miesięcy wraz z dostawą odczynników.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościalkowskiego, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz.U. 2024 poz. 1320), informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w formularzu asortymentowo-cenowym zamiast ceny jednostkowej netto za test/badanie Wykonawca podał **cenę jednostkowa za opakowanie**. Wykonawca dostarcza i sprzedaje tylko pełne opakowania odczynników.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ceny za test.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin okresowych dostaw wynosił 4 dni robocze od daty otrzymania zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu instalacji analizatora z 7 dni na min. 21 dni. Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec.

Odpowiedź: Instalacja analizatora w siedzibie Zamawiającego w terminie do 14 dni od podpisania umowy – zgodnie z punktem 34 Szczegółowego Opisu Analizatora.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby próg wykonania umowy wynosił 80% wartości umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 - Dotyczy § 8 projektu umowy – załącznik nr 9 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego zapisu na:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

- a) zwłoki w dostarczaniu towaru w wysokości **0,04 % wartości brutto towaru niedostarczonego** w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki,
b) zwłoki w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wysokości **0,04 % wartości brutto towarów wadliwych** za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności przez Wykonawcę kar umownych wynosił 60 dni od dnia wystawienia noty księgowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 - Dotyczy § 7 projektu umowy – załącznik nr 9a do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego zapisu na:

„Wydzierżawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

zwłoki w dostarczeniu i instalacji Urządzenia w wysokości **5% wartości miesięcznego czynszu dzierżawy**, za każdy dzień opóźnienia ponad termin ustalony w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
zwłoki w podjęciu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia Urządzenia, w wysokości **5% wartości miesięcznego czynszu dzierżawy**, za każdy dzień opóźnienia ponad termin nie wykonania przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego, w wysokości 50% wartości umowy o której mowa w § 1 ust. 2.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 - Dot. § 4 ust. 7 projektu umowy – załącznik nr 9 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku stwierdzenia braków ilościowych towaru przy dostawie Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia brakującej ilości towaru **w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia danej reklamacji ilościowej?**

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 - Dot. § 4 ust. 8 projektu umowy – załącznik nr 9 do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru w momencie dostawy, Wykonawca zobowiązał się do wymiany na własny koszt wadliwej części dostawy na towar wolny od wad **w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia danej reklamacji jakościowej**, a w razie stwierdzenia wad jakościowych towaru w późniejszym czasie, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt wadliwej części dostawy na towar wolny od wad **w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji?**

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 - Dot. § 4 ust. 2 i 3 projektu umowy – załącznik nr 9a do SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku nieusunięcia awarii, w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zobowiązał się po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym wykonać analizę w innym zewnętrznym laboratorium na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 24 h od momentu zgłoszenia. Jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe w ciągu 48 h od zgłoszenia awarii, to Zamawiający tym samym zyskuje prawo do zlecenia badań w wybranym przez siebie laboratorium medycznym na koszt Dostawcy, aż do momentu uruchomienia sprzętu (zgodnie z punktem 32 Szczegółowego Opisu Analizatora).

Pytanie nr 11 - Dot. § 1 ust. 6 projektu umowy – załącznik nr 9 do SWZ:

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie niniejszego zapisu „Wykonawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych w Umowie”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 - Dot. § 1 ust. 6 projektu umowy – załącznik nr 9 do SWZ:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co ma na myśli pisząc wszelkie szkody? „Wykonawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych w Umowie”. Wykonawca składając ofertę przetargową powinien znać precyzyjnie warunki umowy która może zostać zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 - Dot. § 4 ust. 5 projektu umowy – załącznik nr 9 do SWZ:

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie niniejszego zapisu „W przypadku niedostarczenia faktury wraz towarem lub w terminie określonym w § 3 ust. 8, podzielenia zamówienia niezgodnie ze złożonym zamówieniem, Zamawiający ma prawo go nie odebrać lub zwrócić towar na koszt Wykonawcy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę.” Uzasadnienie: Zamówienia są dzielone ze względu na chwilowe braki w magazynie. Wykonawca w takich przypadkach może nie dzielić zamówienia, jednak w takich przypadkach całe zamówienie będzie czekało z realizacją do momentu dostępności wszystkich produktów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14 - Dotyczy Tabela 1: Asortyment:

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania troponiny I hs. Troponina T jest charakterystyczna tylko dla jednego Wykonawcy, firmy Roche. Obie troponiny są stosowane w laboratoriach i mają takie same znaczenie kliniczne. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, żeby ograniczać się tylko do troponiny T hs.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wysokoczułej Troponiny I, która stanowi metodę równoważną i bardziej precyzyjną niż Troponina T, ponieważ spełnia wymagania IFFCC dla 99 percentyla CV poniżej 10%. Troponina I jest także bardziej swoistym izoenzymem sercowym niż Troponina T, ponieważ w przeciwieństwie do Troponiny T, nie ulega kontaminacjom z obecną w próbce biotyną lub hemolizą. Oznaczanie Troponiny I jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne nie tylko w diagnostyce zawału mięśnia sercowego, ale także jako marker prognostyczny dla innych chorób sercowo – naczyniowych. Ponadto, odczynnik do oznaczania Troponiny T jest oferowany na rynku tylko przez jednego Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 16 - Dotyczy WYMOGI DOTYCZĄCE CZĘŚCI IMMUNOCHEMICZNEJ punkt 51:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas wykonania oznaczenia Troponiny I hs wynosił nie więcej niż 18 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 17 - Dotyczy WYMOGI DOTYCZĄCE CZĘŚCI IMMUNOCHEMICZNEJ punkt 48:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla kilku oferowanych testów immunochemicznych czyli kwasu foliowego, p-ciał anty-CCP, p-ciała p/peroksydazie tarczycowej czas wykonania oznaczenia wynosił nie więcej niż 43 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o maksymalnej wydajności teoretycznej do 100 oznaczeń na godzinę?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyższej maksymalnej wydajności teoretycznej.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści odczynniki immunochemiczne gotowe do użycia, które przed włożeniem na pokład aparatu wymagają, kilkukrotnego obrócenia odczynnika góra/dół, odkręcenia nakrętki oraz założenia kapturka zabezpieczającego dodatkowo odczynnik przed parowaniem na pokładzie aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę, jeśli jest to czynność wykonywana jednorazowo przed pierwszym włożeniem odczynnika na pokład analizatora a odczynniki mogą być podładowane do czasu ich zużycia, bez konieczności ich wyjmowania, chowania, mieszania.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby jeden z oferowanych odczynników biochemicznych wymagał wstępnego przygotowania odczynnika roboczego przed wstawieniem na pokład aparatu? Czynności te nie wymagają użycia precyzyjnych naczyń pomiarowych, a wymagają jedynie połączenia dwóch jednostek składowych w celu przygotowania odczynnika roboczego, a ryzyko popełnienia błędu jest zminimalizowane do zera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści odczynniki biochemiczne gotowe do użycia wymagające jedynie odkręcenia nakrętki przed włożeniem na pokład aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę, jeśli jest to czynność wykonywana jednorazowo przed pierwszym włożeniem odczynnika na pokład analizatora a odczynniki mogą być podładowane do czasu ich zużycia, bez konieczności ich wyjmowania, chowania, mieszania.

Pytanie nr 22

Prosimy o wyrażenie zgody za zaoferowanie analizatora biochemicznego, który wyposażony jest w mechaniczne miksery mieszaniny reakcyjnej, ale w którym współczynnik przeniesienia jest poniżej istotności klinicznej, czyli poniżej 0.1 ppm. Zapewnia to pełne bezpieczeństwo procesu analitycznego, dzięki zastosowaniu sprawnych systemów mycia zarówno sond dozujących, mikserów jak i kuwet reakcyjnych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 23 - Dot. Załącznika nr 1a- SZCZEGÓŁOWY OPIS ANALIZATORA PKT. 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu wykorzystującego kuwety wielorazowego użytku, których poziom czystości monitorowany jest na bieżąco i w sytuacji przekroczenia limitów fabrycznych w celu bezpieczeństwa wydawanych wyników, możliwa jest wymiana części zespołu kuwet? Czynność ta wykonywana jest w ramach rutynowych procedur konserwacyjnych, a odpowiednia ilość kuwet wyszczególniona jest w ofercie wraz z elementami zużywalnymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 24 - Dot. Załącznika nr 1a- SZCZEGÓŁOWY OPIS ANALIZATORA PKT. 18

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli wyniki będą podawane w jednostkach zgodnych z ulotka metodyczną producenta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 25 - Dot. Załącznika nr 1a- SZCZEGÓŁOWY OPIS ANALIZATORA PKT. 19

Prosimy o doprecyzowanie czy pod stwierdzeniem "Materiały kontrolne do wszystkich oznaczanych parametrów o wartościach prawidłowych i patologicznych" Zamawiający ma na myśli wszystkie wymienione w Załączniku nr jeden oznaczenia z wyłączeniem "Odczynnika do badania wpływu hemolizy/lipemii/bilirubinemii"?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 26 - Dot. Załącznika nr 1a- SZCZEGÓŁOWY OPIS ANALIZATORA PKT. 21

Czy zamawiający uzna punkt za spełniony w przypadku zaferowania odczynników gotowych do użycia bez konieczności ręcznego odkręcania butelek i mieszania zawartości (biochemia i immunochemia)

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 27 - Dot. Załącznika nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytoninę w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 28 - Dot. Załącznika nr 1:

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, anty-TPO i anty-Tg posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji noworodków, niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach , co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 29 - Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3

Zwracamy się z prośbą o możliwość rozszerzenia tabel poprzez dodanie wierszy w celu wyspecyfikowania wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych badań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30 - Dotyczy: Załącznik nr 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż podana szacunkowa wielkość zamówienia zawiera oznaczenia przeznaczone na kontrolę i kalibrację.

Odpowiedź: Należy doliczyć liczbę oznaczeń przeznaczonych na kontrolę i kalibrację.

Pytanie nr 31 - Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5


Zwracamy się z prośbą o możliwość zmiany nazwy kolumny "Cena jednostkowa netto za test/ badanie" na "Cena jednostkowa netto", ponieważ jednostką miary jest opakowanie. Umożliwi to poprawne wyliczenie wartości oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ceny za test.

Pytanie nr 32 - Dotyczy ogólnych wymogów

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z niższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

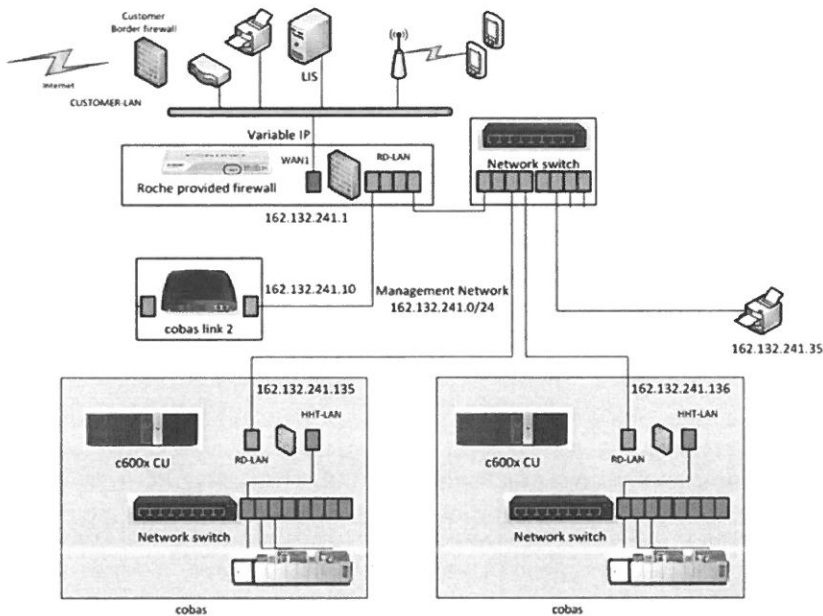

URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń musi być zrealizowane w czasie instalacji.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 35 - Dotyczy pkt. 1.1) Rozdział V. Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych deklaracji zgodności Wykonawca załączył oświadczenie do oferty o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie deklaracji zgodności UE wyłącznie w języku angielskim?

Uzasadnienie: Przedstawienie deklaracji zgodności UE jedynie w języku angielskim spełnia obowiązujące normy prawne. Zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, nie ma bowiem konieczności dostarczania deklaracji zgodności UE w języku polskim. W przypadku wyrobów przeznaczonych bądź udostępnionych do stosowania przez użytkowników niebędących laikami, deklaracja zgodności UE może być wyrażona w języku polskim lub języku angielskim. Wyjątkiem są informacje przeznaczone dla pacjenta, które podaje się jedynie w języku polskim lub wyraża się za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Podkreślamy, że informacje wyrażone w języku angielskim w ww. dokumencie są przedstawione w sposób czytelny i w pełni zrozumiały, co zapewnia zgodność z wymaganiami prawnymi oraz nie wpływa na czytelność i przejrzystość dokumentów. Takie podejście może również przyczynić się do zwiększenia efektywności i uproszczenia procesu przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37 - Dotyczy wymagań ogólnych

Wnioskujemy od odstąpienie, na każdym etapie postępowania, od wymogu dostarczania dokumentów potwierdzających udostępnienie wyrobu na rynku tj. przedstawienia potwierdzenia dokonania notyfikacji w URPL.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) dokonywanie notyfikacji w formie papierowej zostało zastąpione dokonywaniem rejestru w systemie informatycznym "wykaz dystrybutorów", w którym dystrybutor obowiązkowo dokonuje wpisu o każdym sprowadzonym po raz pierwszy wyrobie, systemie lub zestawie zabiegowym. Dane gromadzone w powyższy systemie informatycznym dostępne są dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38 - Dotyczy Załącznik nr 9 – Projekt umowy dostawy par. 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39 - Dotyczy Załącznik nr 9 – Projekt umowy dostawy par. 4 ust. 7-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40 - Dotyczy Załącznik nr 9 – Projekt umowy dostawy par. 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41 - Dotyczy Załącznik nr 9 – Projekt umowy dostawy par. 8 ust. 1 lit. c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42 - Dotyczy Załącznik nr 9 – Projekt umowy dostawy par. 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43 - Dotyczy Załącznik nr 9 – Projekt umowy dostawy par. 8 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację limitu kar umownych do „10% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44 - Dotyczy Załącznik nr 9 – Projekt umowy dostawy par. 9 ust. 7 pkt 2) lit. d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego zapisu, tak aby Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2), mogło się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy?

Uzasadnienie: W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45 - Dotyczy Załącznik nr 9 – Projekt umowy dostawy par. 11 ust. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46 - Dotyczy Załącznik nr 9a – Projekt umowy dzierżawy par. 4 ust. 2 lit. a) i b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47 - Dotyczy Załącznik nr 9a – Projekt umowy dzierżawy par. 4 ust. 3

Czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 24 h od momentu zgłoszenia. Jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe w ciągu 48 h od zgłoszenia awarii, to Zamawiający tym samym zyskuje prawo do zlecenia badań w wybranym przez siebie laboratorium medycznym na koszt Dostawcy, aż do momentu uruchomienia sprzętu (zgodnie z punktem 32 Szczegółowego Opisu Analizatora).

Pytanie nr 48 - Dotyczy Załącznik nr 9a – Projekt umowy dzierżawy par. 7 ust. 1 lit. a)-b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 49 - Dotyczy Załącznik nr 9a – Projekt umowy dzierżawy par. 7 ust. 1 lit. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wyzierżawiającego" na "z przyczyn zawinionych przez Wyzierżawiającego"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od „niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 50 - Dotyczy Załącznik nr 9a – Projekt umowy dzierżawy par. 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 51 - Dotyczy Załącznik nr 9a – Projekt umowy dzierżawy par. 12 ust. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 52 - Dotyczy Załącznik nr 9a – Projekt umowy dzierżawy Dotyczy Załącznik nr 9b – Projekt umowy powierzenia danych osobowych par. 5 ust. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji postanowień umowy zakazujących przetwarzania danych osobowych poza Unią Europejską. Wyjaśniamy, że niekiedy występują sytuacje awaryjne, które wymagają wsparcia specjalistów z naszych globalnych zespołów serwisowych funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej, znajdujących się poza UE. Incydentalny dostęp do danych przez nasz globalny zespół jest kluczowy dla szybkiego i sprawnego rozwiązania problemów technicznych, co w konsekwencji minimalizuje potencjalne przestoje i pozwala na utrzymanie wysokiego standardu usług. Pragniemy podkreślić jednocześnie, że takie rozwiązanie nie powoduje agregacji danych osobowych w państwie trzecim, co jest rozwiązaniem bardzo bezpiecznym, szczególnie gdy realizowane jest przez podmiot w ramach grupy kapitałowej, nad którym mamy większą kontrolę i zaufanie.

Wyjaśniamy także, że serwisant spoza UE uzyska realny dostęp do danych wyłącznie wtedy, gdy otrzyma prośbę o wsparcie, a jednocześnie dane osobowe będą umieszczone w analizatorze. Podkreślamy również, że Wykonawca w celu należytego zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnia zgodność z wymaganiami oraz zobowiązuje podwykonawców do przestrzegania zasad uregulowanych niniejszą Umową na takich samych warunkach, którym sam podlega. Globalne koncerny podczas świadczenia dostaw lub usług wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie lub dostępu do tego produktu.

W związku z powyższym, uzyskanie zgody na podpowierzenie przetwarzania podwykonawcom, w tym także znajdującym się poza UE, jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej oraz sprawnej realizacji usługi przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokładnych informacji na temat podmiotu podprzetwarzającego, który będzie przetwarzał dane.

W konsekwencji prosimy o dodanie do niniejszego postanowienia zastrzeżenia: „Wyjątek stanowią spółki powiązane i podwykonawcy Procesora z listy opisanej załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.

Lista może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody."

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, to czy będzie korzystał z analizatorów w taki sposób, aby nie wprowadzać do nich danych osobowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 53 - Dotyczy Załącznik nr 9a – Projekt umowy dzierżawy Dotyczy Załącznik nr 9b – Projekt umowy powierzenia danych osobowych par. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:

"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 54 - Dotyczy Załącznik nr 9a – Projekt umowy dzierżawy Dotyczy Załącznik nr 9b – Projekt umowy powierzenia danych osobowych par. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy załącznika nr 1 z listą podmiotów podprzetwarzających, w tym na dodanie do Umowy par. 9 ust. 5 o treści "Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Podmiot przetwarzający jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 2 do Umowy."?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 55 - Dotyczy Załącznik nr 9a – Projekt umowy dzierżawy Dotyczy Załącznik nr 9b – Projekt umowy powierzenia danych osobowych par. 10 ust. 1 pkt 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 56 - Dotyczy Załącznik nr 9a – Projekt umowy dzierżawy Dotyczy Załącznik nr 9b – Projekt umowy powierzenia danych osobowych par. 12 ust. 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zynowicza-Kościakowskiego

Marek Stanisław Karp