

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.029.2024

Wrocław, dnia 18.10.2024r.

EZ/843.124

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę pozostałych materiałów medycznych do badań diagnostycznych oraz odczynników i testów do badań diagnostycznych (sygnatura sprawy: EZ/783/415/24).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą SWZ.

Pytanie nr 1

Dot. Zad.10 poz.1


"Prosimy informację czy Zamawiający wymaga elektrody z kablem czy samej elektrody bez kabla?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody z kablem lub bez kabla.

Pytanie nr 2

Dot. Zad.10 poz.1

" Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej z kablem o powierzchni aktywnej 104cm², pakowanych jednostkowo w opakowania zbiorcze po 25 szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 360op., przedstawionych na grafice poniżej:"

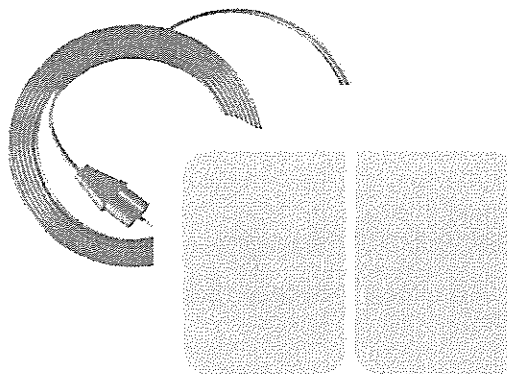

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**




Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie nr 3

Dot. Zad.10 poz.1

" Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej bez kabla o powierzchni aktywnej 104cm², pakowanych po 5 szt. w opakowanie zbiorcze po 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 90op., przedstawionych na grafice poniżej."

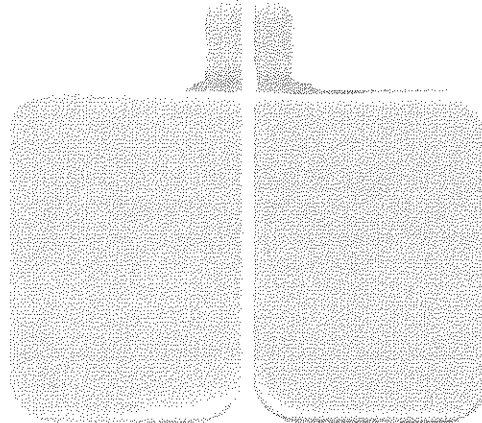

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. Zad.12

" Z uwagi na różnorodność produktów w Zadaniu 12 prosimy o wydzielenie poz. 3 do osobnej części. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Dodatkowo chcielibyśmy nadmienić, iż zamawiający ma możliwość wydzielenia pozycji do osobnego Pakietu, gdyż nie jest to postępowanie powyżej progu unijnego oraz nie spełnia przesłanek do zastosowania art 25 ustęp 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz 2019)"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dot. Zad.12, poz.3

" Prosimy o wskazanie technologii w jakiej mają pracować czujniki."

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje technologię - OxiMax Technology. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 6

Dot. Zad.12, poz.3

" Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o czujniki jednorazowe."

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 7

Dot. Zad.12, poz.3


" Prosimy o dopuszczenie czujników dla noworodków/dorosłych, z przedziału wagowego <3kg oraz >30kg."

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**




Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników dla noworodków do 5 kg. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 8

Dot. Zad.17, poz.1

" Prosimy o dopuszczenie elektrod neutralnych, dzielonych, o powierzchni aktywnej 33cm², przedstawionych na grafice poniżej:"

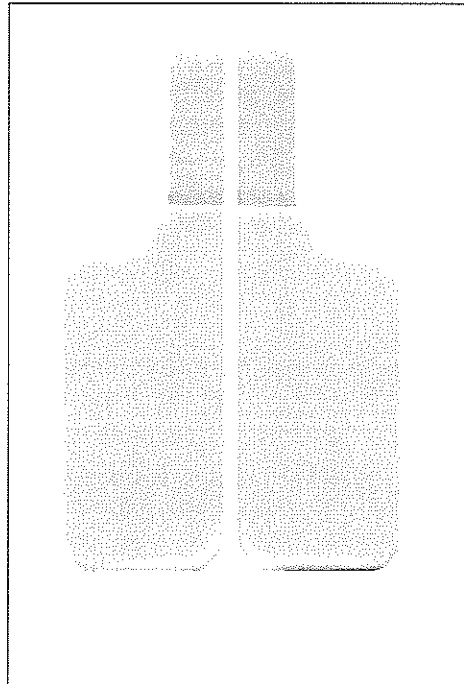

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. Zad.18, poz.1

" Prosimy o informację z jakim aparatem ma być kompatybilna elektroda, w celu dobrego dopasowania kabla."

Odpowiedź: Zamawiający wymaga elektrod kompatybilnych z aparatami: Valleylab, Erbe, Aesculap. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 10

Dot. Zad.18, poz.1

"Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej z kablem o powierzchni aktywnej 104cm², dla pacjentów powyżej 5kg, pakowanych jednostkowo w opakowania zbiorcze po 25 szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 8op., przedstawionych na grafice poniżej:"

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła:




DOLNY
ŚLĄSK

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

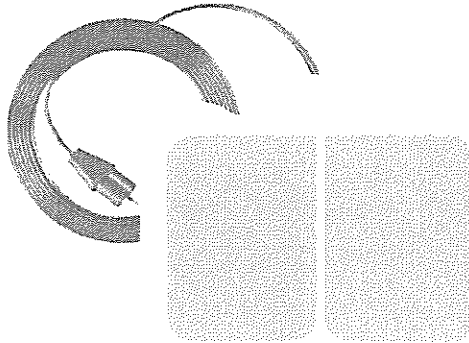

Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2 Formularz cenowy Zadanie 18 poz. 1 i jej nie zmienia.

Pytanie nr 11

Dot. Zad.19

" Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 19 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w zintegrowane z tym testem narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (biopłatów) na pole reakcyjne testu ?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 12

Dot. Zad.19


" Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 19 – Test ureazowy - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 13

Dot. Zad.12, poz. 2

" Czy zamawiający dopuści czujnik SpO2, nie posiadający w zestawie naklejek do mocowania czujnika w kształcie kótek pokrytych klejem z obu stron, ułatwiających aplikację. Nie posiadający miedzianej osłony Faraday'a. Pozostała część bez zmian. Zdjęcie czujnika w złączeniu."

Sporządziła: Elżbieta Borowik 
Sprawdziła:


Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

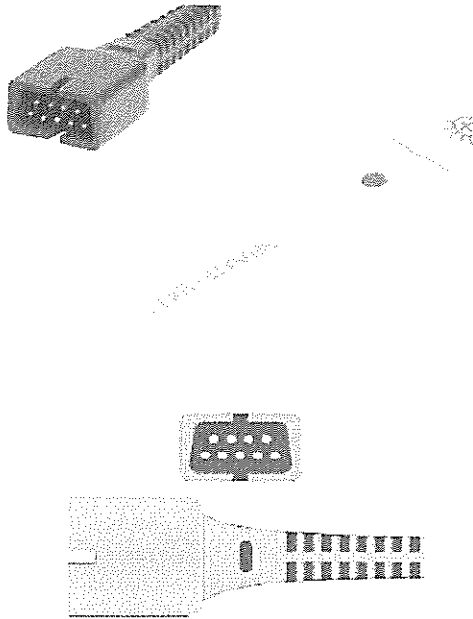

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 14

Dot. Zad.12, poz.3

" Proszę o podanie w jakiej technologii pracuje obecnie używany czujnik oraz numer REF."

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje technologię -OxiMax Technology, nr REF: SCNEO-1

Pytanie nr 15

Dot. Zad.14, poz.1

" Czy zamawiający dopuści, jednorazowe elektrody noworodkowe z przewodem 50 cm, 23x30 mm, wtyk DIN 1,5 mm, 3 sztuki w opakowaniu?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 16

Dot. Zad.15, poz.1

" Proszę o podanie w jakiej technologii pracuje obecnie używany czujnik oraz numer REF."

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje technologię czujnika: RD SET INF ADH oraz nr REF: 4002


Pytanie nr 17

Dot. Zad.9, poz.1

" Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu sterylności elektrody do defibrylacji. Elektrody są jednorazowego użytku, zatem nie widzimy zasadności aby były sterylne. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie elektrod mikrobiologicznie czystych, pakowanych parami z zachowaniem warunków czystości, jednorazowego użytku. Nie ma możliwości zaoferowania tego asortymentu w wersji sterylnej gdyż takie elektrody nie są produkowane."

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu sterylności. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.


Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu elektrody mikrobiologicznie czyste z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Sporządziła: Elżbieta Borowik 
Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie nr 18

Dot. Zał. nr 3 do SWZ wzór umowy §9 pkt. 6

" Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę."

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianej w §9 pkt. 6 wzoru umowy każdorazowo będzie zwracał się do wykonawcy o zgodę na przedłużenie czasu trwania umowy.

Pytanie nr 19

Dot. Zad.9, poz.1

" Czy zamawiający dopuści elektrodę biologicznie czystą, pakowaną po 2 sztuki, opakowanie szczelnie zamknięte?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 20

Dot. Zad.12, poz.1

" Czy Zamawiający dopuści czujnik niesterylny?"

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21

Dot. Zad.12, poz.1

" Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „pakowany z dodatkową opaską typu Velcro do stabilizacji czujnika na czole pacjenta”?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Dot. Zad.12, poz.1

"Czy Zamawiający dopuści opaskę typu Velcro do stabilizacji czujnika na czole pacjenta dołączoną osobno?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opaskę pakowaną osobno pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów opisanych w Zał. nr 2 Formularz cenowy Zadanie 12 poz. 1

Pytanie nr 23

Dot. Zad.12, poz.2

"Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „posiadający w integralnym opakowaniu sześć naklejek do mocowania czujnika w kształcie kótek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika”?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czujnik bez naklejek do mocowania.

Pytanie nr 24

Dot. Zad.12, poz.3

"Czy Zamawiający oczekuje czujnika jedno czy wielorazowego?"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujnika jednorazowego. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 25

Dot. Zad.14, poz.1

"Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 22mm, podłoże z pianki, kabel 60cm, nieradioprzezierny?"

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26

Dot. Zad.15

"Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga czujników Masimo Set z końcówką RD (płaska wtyczka) czy LNCS (pinowe)?"

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników Masimo Set z końcówką RD (płaska wtyczka). Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 27

Dot. Zad.15

"Czy zamawiający oczekuje czujników saturacji wykonanych w technologii Masimo SET – eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnału z krwi żyłnej?"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników saturacji wykonanych w technologii Masimo SET. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 28

"Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?"

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną."

Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2 do SWZ Formularz cenowy oraz w SWZ Rozdz. XXI pkt 3.

Pytanie nr 29

"Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego."

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie widzi takiej możliwości z uwagi, iż zamówienia składane są wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr 30

"Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)"

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający w § 3 ust. 11 wzoru umowy określił minimalny stopień realizacji umowy i go nie zmienia.

Pytanie nr 31

"Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy."

Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w § 10 ust. 2 i 3 wzoru umowy i go nie zmienia.

Pytanie nr 32

"Prosimy o modyfikację zapisów § 11 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje modyfikacji treści SWZ, a mianowicie w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 15.10.2024r., miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 15.10.2025r. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu:

1. Zał. nr 2 Formularz cenowy – po modyfikacji

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
mgr Tomasz Dymyt

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**

FORMULARZ CENOWY - po modyfikacji

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent (twój)	Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	J.m.	Ilość zamówienia podstawowego	Cena j. netto w zł	stawka VAT %	Kwota j. VAT w zł	Cena j. brutto w zł	Wartość netto zamówienia podstawowego w zł	Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł	Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł	Ilość objęta prawem opcji	Ilość próbek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZADANIE 1															
1	Filtry przeciwpływe do pochłaniacza. Kompatybilne z aparatem MAQUET Flow (1 op. 20sztuk) Pochłaniacz CO2 jednorazowy. Pojemnik z medycznym wapieniem sodowanym w postaci granuliek z indykatorem barwnym. Szczelnie zamknięty, bez możliwości otwierania. Przeznaczony do absorpcji CO2. Pojemność 700ml. Kompatybilny z urządzeniami MAQUET Flow-iFlow-cFlow-e. Granulat w pojemniku Sofnolime (1op. 12sztuk)					48								28	x
2					op *	48								28	x
ZADANIE 2															
1	Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego małądą manometryczną, nieinwazyjną. Jednorazowego użyciu. Sterylny				zestaw	310								186	1
ZADANIE 3															
1	Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) z jednorazowym przetwornikiem, do cewnika Foley'a, w zestawie z zamkniętym systemem do pomiaru diurezy godzinowej, kompatybilny z kardiomonitorem Mindray BeneView T9, jednorazowy, sterylne				zestaw	660								396	1
2	Przewód interfejsowy do zestawu z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) z wykiem "R" kompatybilny z kardiomonitorem Mindray BeneView T9 oraz z zestawem z pozycji 1				szk	12								7	1
ZADANIE 4															
1	Szkiełko podstawowe 26x76x1mm z polem do opisu z jednej strony (1op. 50 sztuk)				op *	220								132	x
ZADANIE 5															
1	Papier do programatora MEDTRONIC 9790 110mm x 150mm (1op. 200sztuk)				op *	3								1	x
2	Papier do bieżni Quinton z nadrukiem 210mmx300, (1op. 200sztuk)				op *	3								1	x
3	Papier do aparatu EKG rolkowy z nadrukiem rozmiar 210mm x 25m				szk	260								156	x
4	Papier do programatora ST JUDE 210mm x 140mm (1op. 250sztuk)				op *	3								1	x
ZADANIE 6															
1	Papier termoczulny TF 50KS-E2C 112mmx42mmx2m do drukarki termicznej do aparatu Goby Ghub 5 - badanie przepływu moczu				szk	5								3	x
ZADANIE 7															
1	Zel wodny lubrykant na bazie wody, bez dodatku środka znieczulającego, bez środka dezynfekcyjnego, antyalegiczny, nie powodujący uszkodzenia materiałów z gumy i metalu (1 op. =min 142g)				op	8								4	x

FORMULARZ CENOWY - po modyfikacji

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent (uwagi)	Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	j.m.	ilość zamówienia podstawowego	Cena j. netto w zł	stawka VAT %	Kwota j. VAT w zł	Cena j. brutto w zł	Wartość netto zamówienia podstawowego w zł	Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł	Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł	ilość objęta prawem opcji	ilość próbek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	x	x	x	x	x	x	x	x	8x9	8+10	7x8	7x10	7x11	x	x
ZADANIE 8															
1	Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowa do badania mięśni, długość 50 mm, powierzchnia 0,07 mm ² (1op 25szluk)				op *	32								19	x
2	Elektrody pierścieniowe do odbioru potencjałów przy badaniu włókien czuciowych, z końcówką dinowską, okrągła. Elektrody w postaci dwóch obrączek, 1 para z kablem HUSH o długości 1m				kpl	5								3	x
3	Kabel, do którego podłączane są elektrody igłowe jednorazowego użytku, z końcówką dinowską, długość 1,5-2 m				szt	6								3	x
RAZEM!															
ZADANIE 9															
1	Elektroda kompatybilna z delibrylatorem LifePak Quick Combo firmy Medtronic, jednorazowe (1 op 2szluk)				op *	560								336	x
ZADANIE 10															
1	Elektroda neutralna pow 110cm ² kompatybilna z aparatami Valleylab, Erbe, Aesculap				szt	9 000								5400	x
ZADANIE 11															
1	Elektroda EKG noworodkowa z zębem węglowa RTG i MRI 25mm (1op 50szluk)				op *	36								21	x
ZADANIE 12															
1	Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, do przyklejania na czoło, min 3 warstwy przylepne, dla dorosłych i dla dzieci powyżej 10 kg, pakowany z dodatkową opaską typu Veicro do stabilizacji czujnika na czole pacjenta, sensor w technologii Oximax, kalibrowany cyfrowo				szt	432								259	x
2	Czujnik jednorazowy do pomiaru SpO2 w technologii OxiMAX, typu Covidien MAX-N i dla noworodków poniżej 3kg i dorosłych powyżej 40 kg posiadający w integralnym opakowaniu sześć naklejek do mocowania czujnika w kształcie kłerek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, sensor w technologii Oximax, kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność (%SpO2) w zakresie 70-100% - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% - 3 cyfry Czujnik posiadający miedzianą osłonę Faradaya				szt	312								187	x
3	Czujnik do pulsoksymetrii do pomiaru SpO2 dla noworodków, czujniki jednorazowe, czujniki w technologii Oximax Technology, Czujniki dla noworodków do 5 kg.				szt	192								115	x
RAZEM!															
ZADANIE 13															
1	Zestaw pomiarowy spirometrii i kalymetrii, jednorazowy D-lite++ dla dorosłych, 2m kompatybilny z modulem E-SCOVX linia spirometryczna, linia probkowania gazu i czujnik spirometryczny dla jednego pacjenta (1 op 20zestawów)				op *	8								4	x

FORMULARZ CENOWY - po modyfikacji

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent (wzrost)	Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	J.m.	ilość zamówienia podstawowego	Cena j. netto w zł	stawka VAT %	Kwota j. VAT w zł	Cena j. brutto w zł	Wartość netto zamówienia podstawowego w zł	Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł	Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł	ilość objęta prawem opcji	ilość próbek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ZADANIE 14															
1	Elektroda EKG noworodkowa z przewodem zasilającym, kompaktowa z urzadzeniem Antena, monitor Mindray Elektroda ze słaym zelem, wymiar 20 x 28, podłozce z "oddychającej" włókniny, złącze typu K (1 5mm) na kabliku 50cm, do średnio i długookresowego monitorowania, możliwość przeklejenia radioprzezerna (1op 3sztuk)				op *	40								24	x
ZADANIE 15															
1	Jednorazowy samoprzylepny czujnik pulsoksymetrii typu Massimo Set z końcówką RD (płaska wtyczka) dla niemowląt 3-20kg, kompaktowy z aparatem do znieczulenia GETINGE typu Massimo, (1 op 20 sztuk)				op *	14								8	x
ZADANIE 16															
1	Paski diagnostyczne Test Schirmera (1op 100sztuk)				op *	6								3	x
ZADANIE 17															
ZADANIE 18															
1	Elektroda neutralna, 40 cm2, dzielona, EASY (1 op 100sztuk)				op *	4								2	x
ZADANIE 19															
1	Elektrody neutralne, niesteryjne, jednorazowego użytku dla pacjentów powyżej 13,8kg z kablem Elektroda dzielona na pół z warstwą samoprzylepną (1 op 50sztuk), elektrody kompatybilne z aparatami: Valleylab, Erbe, Aesculap.				op *	4								2	x
ZADANIE 20															
1	Test urazowy, suchy, wymiary w czasie od 2min do 60min				szt	3 600								2150	x
ZADANIE 21															
1	Tusz - znacznik endoskopowy w ampułkoszzytkawkach o zawartości od 2 ml do 5 ml (1 op 10 sztuk)				op *	10								6	x
ZADANIE 22															
1	Paski testowe do pomiaru stęż. ciał beta ketonowych we krwi do aparatu Optium Xido (op 10sztuk)				op *	10								6	x
ZADANIE 23															
1	Roztwór sterylny błękit trypanu 1ml PŁYN (op 10 fiolek)				op *	2								1	x
ZADANIE 24															
1	Paski do pomiaru pozostałości dezynfektanta (op 100sztuk)				op *	2								1	x

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoznacznych zgodnie z pkt 5 Rozdział III SWZ

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaofiarowanych, danych dotyczących zaofiarowanych, danych dotyczących zaofiarowanych, danych dotyczących zaofiarowanych

* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaofiarować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaofiarowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej) do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 - 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy porównawczej przynajmniej 1 opakowania

