



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
ul. Szpitalna 10, 64 - 400 Międzychód

NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249 KRS: 0000005301
Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11 Centrala: tel. 95 748 20 11
e-mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl e-mail: 3000310@zoz.org.pl
www.spzoz-miedzychod.com.pl

AG/ZP-17/2022

Międzychód 29.11.2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na:
sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego użytku

SPZOZ Międzychód informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniami do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

dot. pakietu 36 Czy Zamawiający wymaga okularków w następujących rozmiarach:, micro poniżej 28 cm Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak wymagamy.

Pytanie nr 2

dot. pakietu 36 Czy Zamawiający wymaga aby okularki posiadały badania dotyczące nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99,9 %?. Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okularki należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji, dlatego tak ważne jest aby okularki do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Odpowiedź: Tak wymagamy.

Pytanie nr 3

dot. pakietu 36 Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyników badań okularków na przenikanie fal świetlnych?

Odpowiedź: Tak wymagamy.

Pytanie nr 4

dot. pakietu 36 Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okularki posiadały wkłęcia od strony oczodołów, co umożliwi fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką?

Odpowiedź: Tak wymagamy.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w **Pakiecie 23** w pozycjach **1 i 2** (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta) dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę luer lock **30 ml**; zestaw spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w **Pakiecie 23** w pozycjach **6-8** dopuści rurkę tracheostomijną marki Portex (bez regulacji położenia kołnierza) z termoplastycznego PCW, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankieta; elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; rurka sterylna; rozmiary - zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

dotyczy Pakietu nr 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych, **nieznacznie różniącego się** od opisanego w SWZ:

1 taśma operacyjna 9 x **50 cm**
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
2 ręczniki do rąk **30,5x34cm**
2 przyklejane serwety 75 x 90 cm
1 przyklejana serweta średnia **180 x 180 cm**
1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (stanowiąca owinięcie zestawu)
Materiał serwet głównych wykonanych z mocnego laminatu dwuwarstwowego (chłonna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa) o gramaturze **60g/m2**.
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu 46 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
1 osłona na kończynę 36 x 120 cm
1 serweta 100 x 150 cm
1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (stanowiąca owinięcie zestawu)
Serwety główne wykonane z mocnego laminatu dwuwarstwowego (chłonna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o gramaturze 140g/m2(łączna gramatura 140g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kresowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu 46 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
1 osłona na kończynę 36 x 65 cm
1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (stanowiąca owinięcie zestawu)
Serwety główne wykonane z mocnego laminatu dwuwarstwowego (chłonna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o gramaturze 140g/m2(łączna gramatura 140g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kresowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakietu 46 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
6 ręczników do osuszania rąk 21 x 25 cm
1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 60 cm
1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm
1 serwetka do owinięcia dziecka 56 x 75 cm
1 serweta do zabiegu szycia 75 x 120 cm
1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm
Serwety główne wykonane z mocnego laminatu dwuwarstwowego (chłonna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Wytrzymałość laminatu na sucho i mokro 168kPa. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kresowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw

jednorazowego użytku zapakowany w opakowanie Tyvec-folia, sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane do transportu podwójnie: wewnętrzny dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem oraz Zewnętrzny karton transportowy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu 46 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (stanowiąca owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane z mocnego laminatu dwuwarstwowego (chłonna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Wytrzymałość laminatu na sucho i mokro 168kPa. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kresowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw jednorazowego użytku zapakowany w opakowanie Tyvec-folia, sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane do transportu podwójnie: wewnętrzny dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem oraz Zewnętrzny karton transportowy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu 46 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przyklepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczoowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przyklepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (stanowiąca owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane z mocnego laminatu dwuwarstwowego (chłonna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Wytrzymałość laminatu na sucho i mokro 168kPa. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kresowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw jednorazowego użytku zapakowany w opakowanie Tyvec-folia, sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane do transportu podwójnie: wewnętrzny dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem oraz Zewnętrzny karton transportowy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Pytanie 7 – Dotyczy Pakietu 46 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przyklepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta dwuwarstwowa 150 x 190 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (stanowiąca owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana z mocnego laminatu trzywarstwowego (chłonna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura 155g/m²). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Wytrzymałość laminatu na sucho i mokro 314kPa/290kPa. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kresowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Zestaw jednorazowego użytku zapakowany w opakowanie Tyvec-folia, sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane do transportu podwójnie: wewnętrzny dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem oraz Zewnętrzny karton transportowy.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 14

Pytanie 8 – Dotyczy Pakietu 46 poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej kieszeni? Sterylna samoprzylepna kieszeń 2 sekcyjna o wymiarach 30x40, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej. Materiał spełniać wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kresowy. Szerokość poszczególnych komór : 30cm x 15cm + 25cm. Na dłuższym brzegu kieszeni znajduje się 6-cm pasek samoprzylepny pokryty klejem hypoalergicznym wyposażony w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Opakowanie zbiorcze 55 szt w formie kartonowego dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny zawierający łącznie 220 szt.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 15

Pytanie 8 – Dotyczy Pakietu 46 poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej osłony na stolik Mayo o szerokości 79cm (zamiast 80cm)?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 16

Pytanie 9 – Dotyczy Pakietu 46 poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytu do przewodów i drenów w postaci jałowej włókninowej taśmy przylepnej 9x50cm pokrytej hypoalergicznym klejem zabezpieczonym papierem silikonowanym z ok. 2-cm marginesem ułatwiającym odklejenie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Pytanie 10 – Dotyczy Pakietu 46 poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczoowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zastonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (stanowiąca owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane z mocnego laminatu dwuwarstwowego (chłonna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Wytrzymałość laminatu na sucho i mokro 168kPa. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kresowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Zestaw jednorazowego użytku zapakowany w opakowanie Tyvec-folia, sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane do transportu podwójnie: wewnętrzny dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem oraz Zewnętrzny karton transportowy.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 18

Pytanie 11 – Dotyczy Pakietu 46 poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej osłony na kończynę 22x75cm, wykonanej z elastycznego, nieprzemakalnego materiału podobnego do neopreny z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, zawierającej 2 taśmy samoprzylepne 9x50cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Pytanie 12 – Dotyczy Pakietu 46 poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej osłony na kończynę 30x120cm, wykonanej z elastycznego, nieprzemakalnego materiału podobnego do neopreny z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, zawierającej 2 taśmy samoprzylepne 9x50cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Pytanie 13 – Dotyczy Pakietu 46 poz. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowej serwety do zabiegów na kończynie o wymiarach 150x180cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, wykonanej na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym 50x100cm o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura 140g/m²)

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 21

Pytanie 14 – Dotyczy Pakietu 46 poz. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowej serwety do zabiegów na kończynie o wymiarach 230x300cm z elastycznym otworem o średnicy 7cm, wykonanej na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m² z dodatkowym padem chłonnym 50x100cm o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura 155g/m²)

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 22

Pytanie 15 – Dotyczy Pakietu 46 poz. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowej serwety do zabiegów na kończynie o wymiarach 150x180cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, wykonanej na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym 50x100cm o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura 140g/m²)

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 23

Pytanie 16 – Dotyczy Pakietu 46 poz. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowej serwety do zabiegów na kończynie o wymiarach 230x300cm z elastycznym otworem o średnicy 7cm, wykonanej na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m² z dodatkowym padem chłonnym 50x100cm o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura 155g/m²)

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 24

Pytanie 17 – Dotyczy Pakietu 54 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanych rękawic? Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu ,on. 0,07mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, niepolimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne przenikalność substancji co najmniej 3 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta, przebadane na przenikanie min. 13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 oraz oryginalnym nadrukiem 3 substancji chemicznych i poziomów ochrony na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone dokumentami producenta. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. op. po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 25

Pakiet 31 Jakiego rozmiaru klipsów Zamawiający wymaga do zaferowania w Pakiecie 31.

Odpowiedź: Wymagamy zaferowania klipsów w rozmiarze ML

Pytanie nr 26

Pakiet 57 Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igieł 6 mm, 23G, 2300 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 27

Pakiet 58 Czy Zamawiający w pozycji 4 i 5 dopuści zaferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,4 mm, szerokości otwarcia łyżeczek 8,0 mm, długość szczęk 4,0 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 28

Pakiet 60 Czy Zamawiający dopuści zaferowanie pętli o średnicy 27-32 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 29

Pakiet 11 poz. 8 Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do defibrylatora Life Pack 11/12 o rozmiarze 107mm x 23m.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 30

Pakiet 11 poz. 9 Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru o czułości HG?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 31

Pakiet 20 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrod z pianki, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 32

Pakiet 20 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o średnicy 40mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 33

Pakiet 20 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 34

Pakiet 20 poz. 4,5 Czy Zamawiający oczekuje elektrod typu preconnect (z kablem wyprowadzonym na zewnątrz w umożliwiający podpięcie elektrod bez otwierania opakowania)) w obu przypadkach elektrod tzn elektroda typu Quick Combo z kablem na zewnątrz dla dorosłych oraz elektroda typu Quick Combo z kablem na zewnątrz dla dzieci?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 35

Pakiet 20 poz. 4,5 Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie jednostki miary. Czy Zamawiający wymaga 5 i 2 sztuk czy 5 i 2 kompletów elektrod? Elektrody do defibrylacji są pakowane parami stąd nasze pytania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 5 oraz 2 – komplety elektrod.

Pytanie nr 36

Pakiet 27 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie uchwytu j.u. wykonanego z wytrzymałego tworzywa o dł. 145 mm z kablem o dł. 3,2 m i elektrodą nożową o dł. 70 mm, trzpień 2,38 mm z blokadą heksagonalną, wtyk do diatermii 3 pin.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 37

Pakiet 27 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie uchwytu j.u. wykonanego z wytrzymałego tworzywa o dł. 145 mm z kablem o dł. 3,2 m i elektrodą nożową o dł. 70 mm, trzpień 2,38 mm z blokadą heksagonalną, wtyk do diatermii 1 pin 5mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 38

Pakiet 27 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie elektrod o powierzchni ogólnej 162 cm² i powierzchni aktywnej 107 cm², wymiary 150x108cm, dzielonych REM, podkład piankowy, hydrożel.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 39

Pakiet 27 poz. 5 Prosimy o wydzielenie poz. 5 do oddzielnego pakietu co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40

Pakiet 39 poz. 3 Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet 39 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie strzygarki innej niż Care Fusion. Zaproponowana strzygarka jest strzygarką z 3 trzyczakresowej, obrotowe głowicą posiadającą trzy pozycje:

- Kąt 0 stopni
- Kąt 45 stopni w lewo
- Kąt 45 stopni w prawo

Powyższe rozwiązanie ułatwia usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała Strzygarka zapewniająca minimum 60 minut pracy po pełnym naładowaniu baterii; bateria typu Li-ion 3,7V ICR 14500MAB 800mAh, spełniająca wymogi Dyrektywy: Dyrektywa EMC 2014/30/UE

- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- CE MDR IEC 60101-1:2005

Odpowiedź: Nie, Szpital posiada już kilka strzygarek Care Fusion, które są sprawne oraz w posiadaniu ma ostrza z nią kompatybilne. Zmiana strzygarki spowodowałaby szkodę finansowa SPZOZ Międzychód.

Pytanie nr 42

Pakiet 39 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki CareFusion, pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste.

Odpowiedź: jw., pytanie nr 41

Pytanie nr 43

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §3 ust. 10 oraz §5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Jak w SWZ.

Pytanie nr 44

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust. 1 pkt A:

1. Obciążające Wykonawcę:

A) W przypadku opóźnienia terminu dostawy częściowej Przedmiotu Zamówienia z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy – Wykonawcy mogą zostać naliczone kary – za każdy dzień zwłoki od przekazanego zamówienia po 0,5% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy.

Odpowiedź: Jak w SWZ.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w §6 ust. 2 lit. A poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 35 siatki przepuklinowe polipropylenowe o rozmiarach: 7,5 x 15cm, 15 x 15cm, 5 x 10cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 51 w poz. 2 wymaga szczoteczki o włoskach bocznie ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona część posiada włoski położone prostopadle do trzonu, co umożliwia jednoczesne pobranie zwiększonej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji? Załączone zdjęcie nr 1.



Zdjęcie nr 1

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 48

Czy w Pakiecie nr 51 w poz. 1 powinny być zaferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 49

Dotyczy pakietu nr 32: Poz. 1 Czy Zamawiający zwiększy ilość czujników rzutu serca do 30 ze względu na najmniejsze dostępne opakowanie w ilości 5 szt.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 50

Dotyczy pakietu nr 32: Poz. 3 Czy Zamawiający zwiększy ilość przetworników ciśnienia do 10 ze względu na najmniejsze dostępne opakowanie w ilości 10 szt.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 51

PAKIET 1, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 52

PAKIET 1, poz. 1- 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze niebieskim dla lepszej wizualizacji pobranego płynu??

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53

PAKIET 1, poz. 7-8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępnie od wymogu wpisanej strzykawki w menu pompy i dopuszczenie strzykawki kompatybilnej z pompą potwierdzonej oświadczeniem Producenta strzykawki?

Odpowiedź: Nie, kompatybilność jest konieczna ze względu na warunki, gwarancję pompy i ewentualne ryzyko jej uszkodzenia.

Pytanie nr 54

PAKIET 1, poz. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły w rozmiarze 0,8 x 100 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55

PAKIET 1, poz. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły w opakowaniu 100 szt.?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 56

PAKIET 1, poz. 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły w rozmiarze 1,2 x 40 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 6-24 dopuści rurki wyposażone w znacznik głębokości w postaci pełnego pierścienia lub półpierścieni, oznaczenie rozmiaru rurki i średnicy mankieta na baloniku kontrolnym lub na rurce?

Odpowiedź: Nie dotyczy. W pakiecie 1 nie ma takich pozycji.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 6 dopuści rozm.3, pozostałe parametry bez zmian lub prosimy o dopuszczenie standardowej rurki i odstępnie od wymogu "silikonowana"?

Odpowiedź: Nie dotyczy. W pakiecie 1 nie ma takich pozycji.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 6-24 dopuści rurki niesilikonowane, standardowe?

Odpowiedź: Nie dotyczy. W pakiecie 1 nie ma takich pozycji.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający w Pakiecie 19, poz. 11 dopuści Lejce naczyniowe silikonowe do żył niebieskie rozmiar 2,4x 1,2 mm długość 2 x 40?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający w Pakiecie 21, poz. 2, 3, 4, 5 dopuści Jednorazowa maska krtaniowa wykonana medycznego przezroczystego PCV z mankietem o standardowo niskiej przenikalności dla podtlenu azotu, z luźnym przewodem łączącym balonik kontrolny, bez poprzeczek, z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankieta, nazwą producenta, rozmiarem maski, sterylna?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 dopuści: Maskę anestetyczną twarzową jednorazowego użytku z nadmuchiwanym kołnierzem uszczelniającym, z zaworem, wykonane z PCV, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 dopuści: Maskę anestetyczną twarzową jednorazowego użytku z otwartym mankietem, bez zaworu, pozbawione PCV, elastomerowy nieprzezroczysty mankieta, kolor mankieta identyfikujący rozmiar, mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 64

Pakiet 17, poz. 22 Czy Zamawiający dopuści myjkę o wymiarach: 80 x 50 x 37 mm (+/- 2,5 mm), pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26, poz. 1 dopuści Układ oddechowy anestetyczny dla dorosłych - koreczek zakręcany luer-lock, który jest bezpieczniejszy przy wyższym ciśnieniu w obwodzie oddechowym?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26, poz. 2 dopuści Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych z rur karbowanych, rozciągliwych, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26, poz. 2 dopuści Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych długość 160cm, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 68

Pakiet nr 42 Pozycja nr 2 Prosimy o dopuszczenie Podkład podfoliowany szerokość 50-51cm, perforacja co 38-50cm, Prosimy o dopuszczenie podkładu w kolorach: zielony, niebieski, biały. Prosimy o dopuszczenie podkładu o gramaturze celulozy 23g/m² i folii PE 10g/m²

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 69

Pakiet nr 42 Pozycja nr 3 Prosimy o dopuszczenie:

- Podkład podfoliowany szerokość 29-33cm lub 40cm

- kolor biały

- perforacja co 45-50cm

- gramatura celulozy 23g/m² + PE 10 g/m²

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 70

Pakiet nr 42 Pozycja nr 4 Prosimy o dopuszczenie czyściwa o wysokości rolki 26cm.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 71

Pakiet 43 poz. 3,4 Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min.60g?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 72

Pakiet 43 poz.5 Czy Zamawiający dopuści ręczniki sterylne do osuszania rąk z wzmocnionej, wysokochłonnej, niepylącej, włókniny celulozowej o Gramaturze 70 g/m2 w rozmiarze 30x40?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 73

Pakiet 43 poz.5 Czy Zamawiający dopuści ręczniki pakowane a` 2szt?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 74

Pakiet 43 poz.6 Czy Zamawiający wymaga serwety sterylnej?

Odpowiedź: Tak, wymaga serwety sterylnej.

Pytanie nr 75

Pakiet 44 poz.1 Czy Zamawiający dopuści Koszula dla położnic - zakładana przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 110cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm Wykonana z miękkiej, miłej w dotyku chłonnej włókniny typu Spunlace (wiskozowo poliestrowej), kolor biały, 55g. Opakowanie a`20szt.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 76

Pakiet 44 poz.1 Czy Zamawiający dopuści Koszula typ V- Koszula dla pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g. Opakowanie a`20szt

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 77

Pakiet 44 poz.3 Czy Zamawiający dopuści Spodenki do kolonoskopii z owalnym wycięciem z tyłu, umożliwiającym wykonanie badania, typu szorty, z gumka w pasie. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: obwód pasie 120cm, Wykonane z włókniny PP 25g kolor zielony.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 78

Pakiet 44 poz.4 Czy Zamawiający dopuści czepki męski typu furażerka wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną o gramaturze 20g/m² w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej, przeciwpotny, zapewniający komfort w trakcie noszenia, jednorazowego użytku, zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń, lekki i dobrze przepuszczający powietrze?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 79

Pakiet 44 poz.7 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 17g/m²?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 80

Pakiet 44 poz.7 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 160x210cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81

Pakiet 44 poz.8 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 82

Pakiet 44 poz.10, 11 Czy Zamawiający dopuści pokrowce na zwłoki z włókniny polipropylenowej o gramaturze 50g/m²

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 83

Pakiet 44 poz.11 Czy Zamawiający dopuści Pokrowiec na zwłoki dla noworodka z włókniny spunlance cross 80g/m²?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 84

Pakiet 45 Czy Zamawiający dopuści Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy, Gramatura serwet 65 g/m², Uniwersalne zastosowanie, Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Nie, zgodne z SWZ.

Pytanie nr 85

Projekt umowy §6 ust.1 pkt.A Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do poziomu 1% wartości netto niedostarczonych w terminie towarów, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Jak w SWZ.

Pytanie nr 86

Pakiet 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramatura 57 g/m² (+/- 0,5g/m²), wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20 x 50 cm, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²).

Odpowiedź: Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 87

Pakiet 46 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²), z polipropylenowymi łątami chłonnymi w serwecie anestetycznej i serwecie dolnej, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m² (+/- 0,5 g/m²)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 88

Pakiet 46 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²), z polipropylenowymi łątami chłonnymi, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²), z serwetą na stolik instrumentariuszki o gramaturze 80 g/m² i serwetą na stolik Mayo z folii o gramaturze 55 g/m², ze wzmocnieniem włókninowym, o całkowitej gramaturze 85 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 89

Pakiet 46 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 48 g/m², wytrzymałość na sucho/ mokro 94/114 kPa? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 90

Pakiet 46 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 91

Pakiet 46 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²), z polipropylenowymi łatami chłonnymi wokół pola operacyjnego, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 92

Pakiet 46 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²), wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 93

Pakiet 46 poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą do podłożenia pod pacjenta z zakładką do sterylnej aplikacji w rozmiarze 75 x 120 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 94

Pakiet 50 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów wykonanych z włókniny SMS?

Odpowiedź: Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 95

Pakiet nr 12 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach :

- Nawilżanie 37 mg/l H₂O przy V_t=500ml,
- Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H₂O
przy 60 l/min 2,14 cm H₂O
przy 90 l/min 3,95 cm H₂O,
- Masa 35,6 g,
- Przewodność (objętość ściśliwa) 55 ml
- mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 96

Pakiet nr 12 poz. 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr oddechowy z barierą mechaniczną w postaci celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci i membranie o metodzie oddziaływania ładunków intermolekularnych o nawilżaniu 37 mg/l H₂O przy V_t=500ml,

- Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H₂O
przy 60 l/min 2,14 cm H₂O
przy 90 l/min 3,95 cm H₂O,
- Masa 35,6 g,



- Przewodność (objętość ściśliwa) 55 ml.

- Sterylny, pakowany pojedynczo
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 97

Pakiet nr 12 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny wymiennik o oporach przepływu 0,63cm H₂O przy 30l/min, 1,8 cm H₂O przy 60l/min, 3,5 cmH₂O przy 90l/min pozostałe parametry zgodnie z SWIZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 98

Pakiet nr 12 poz. 4, 5 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważne łączniki o długości 15 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 99

Pakiet nr 21 poz. 2, 3, 4, 5 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę krtaniową o następujących parametrach:

- Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku
- Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa
- Poślizgowa powierzchnia mankieta ułatwiająca zakładanie
- Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę
- Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski
- Sterylność opakowania umożliwiającą natychmiastowe użycie
- Kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia
- Dostępność w 8 rozmiarach uwzględniających szerokie spektrum pacjentów
- Bezpieczeństwo i kompatybilność z MR
- Produkt bezlateksowy
- Produkt nie zawiera lateksu i ftalanów



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 100

Pakiet nr 21 poz. 6,7: Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważne worki samorozprężalne wykonane z tworzywa sztucznego SEBS?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 101

Pakiet nr 21 poz. 6,7: Prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający wymaga aby worki pozbawione były szkodliwych bez ftalanów oraz posiadały możliwość warunkowego stosowania w rezonansie magnetycznym (zgodnie z ASTM F2503 produkt jest MR Conditional)?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 102

Pakiet nr 22 poz. 1, 2, 3, 4 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważne maski anestetyczne wykonane z medycznego delikatnego PCV z zaworem?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 103

Pakiet nr 26 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy o następujących parametrach :

- średnica rur 22mm,
- rury rozciągliwe w zakresie 50 do 180cm, dodatkowa rura rozciągliwa do 90cm,

- dwa porty w trójkątniku Y z koreczkami (przymocowanymi),
- zatyczka do szczelności układu i zachowania czystości,
- worek oddechowy 2 litrowy,
- łącznik prosty 22mmM-22mmM,
- czysty mikrobiologicznie, pakowany folia/folia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 104

Czy Zamawiający w § 3 ust. 1 projektu umowy wydłuży dla pakietu 41 dostawy w trybie pilnym do 48h, z tego względu, że nie są to wyroby medyczne ratujące życie?

Odpowiedź: Jak w SWZ.

Pytanie nr 105

Jakie odszkodowanie ma na myśli Zamawiający w § 6 ust. 1B projektu umowy? Czy Zamawiający może wydłużyć ten czas opóźnienia do 2 dni?

Odpowiedź: 1 część pytania – na zasadach Kodeksu Cywilnego. 2 część pytania – NIE.

Pytanie nr 106

Dotyczy pak. 25 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów polimerowych II generacji o stabilności poprzecznej klipsa na naczyniu na poziomie 15N

Odpowiedź: Oczekuje, nie wymaga.

Pytanie nr 107

Pytanie o waloryzację do umowy:

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowyprzetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź: Jak w SWZ.

Pytanie nr 108

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt. A Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych za opóźnienia w dostawie do 1% wartości netto niezrealizowanej części dostawy

Odpowiedź: Jak w SWZ.


Pytanie nr 109

Pakiet 4, pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 110

Pakiet 4, pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z potrójnym znacznikiem głębokości, zdjęcie poglądowe poniżej?

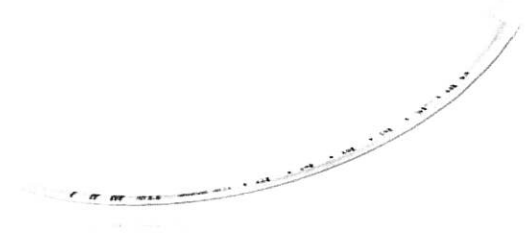

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 111

Pakiet 4, pozycja 6-24 Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 112

Pakiet 4, pozycja 6-24 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem intubacji w postaci 2 półpierścieni?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 113

Pakiet 4, pozycja 6-20 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na przyrządzie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe? Pełną identyfikację przyrządu zapewni Zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 114

Pakiet 4, pozycja 25-30 Czy Zamawiający dopuści zaferowanie przewodnic wykonanych z aluminium pokrytym tworzywem jakości medycznej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 115

Pakiet 4, pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści przewodnicę w rozmiarze 2,0 o dł. 255mm dla rurek 2,5-4,5?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 116

Pakiet 4, pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści przewodnicę w rozmiarze 3,3 o dł. 340mm dla rurek 4,0-6,0?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 117

Pakiet 4, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści przewodnicę w rozmiarze 4,0 o dł. 340mm dla rurek 5,5-6,5?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 118

Pakiet 4, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści przewodnicę w rozmiarze 4,0 o dł. 600mm dla rurek 5,5-7,0?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 119

Pakiet 4, pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści przewodnicę w rozmiarze 4,7 o dł. 340mm dla rurek 5,5-10,0?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 120

Pakiet 4, pozycja 31-32 Czy Zamawiający dopuści przewodnicę do trudnych intubacji wykonaną z medycznego PE?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 121

Pakiet 4, pozycja 36 Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czystą taśmę do mocowania rurek tracheostomijnych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 122

Pakiet 4, pozycja 38 Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czystą taśmę do mocowania rurek intubacyjnych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 123

Pakiet 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści filtr o oporności przepływu 1,0hPa przy 30l/min?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 124

Pakiet 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 40ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 125

Pakiet 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 126

Pakiet 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 127

Pakiet 12, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 128

Pakiet 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 129

Pakiet 12, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 130

Pakiet 19, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania płynu z drzewa oskrzelowego o pojemności 15-20ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 131

Pakiet 19, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści lejce naczyniowe w rozmiarze 2,4 x 1,2mm o dł. 1 x 40cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 132

Pakiet 21, pozycja 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia badaniami klinicznymi mankietu o obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 133

Pakiet 21, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z luźnym, niewbudowanym w ścianę rurki przewodem z balonika kontrolnego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 134

Pakiet 21, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu na korpusie rurki?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 135

Pakiet 21, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na przyrządzie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe? Pełną identyfikację przyrządu zapewni Zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 136

Pakiet 22, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną wykonaną z PCV, bez ftalanów, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 137

Pakiet 26, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy rozciągliwy do 180cm i dodatkową rurą rozciągliwą do 120cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 138

Pakiet 26, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z kapno na kolanku bez pętelki?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 139

Pakiet 26, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dołączoną osobno zatyczką?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 140

Pakiet 26, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez zatyczki?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 141

Pakiet 26, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pakowany w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 142

Pakiet 26, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy rozciągliwy do 200cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 143

Pakiet 26, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pakowany w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 144

Pakiet 38, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści łyżkę ze światłowodem o średnicy 5mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 145

Pakiet 38, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści łyżkę wykonaną ze stopu metalu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 146

Pakiet 38, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści łyżkę posiadającą standardową konstrukcję – bez dłuższego ogonka?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 147

Pakiet 38, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści łyżkę kodowaną wyłącznie numerycznie zarówno na łyżce jaki i na opakowaniu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 148

Pakiet 38, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści instrukcję dołączoną do opakowania zbiorczego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 149

Pakiet 38, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści łyżkę bez nazwy producenta i nazwy handlowej występującej bezpośrednio na przyrządzie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe? Pełną identyfikację przyrządu zapewni Zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 150

Pakiet 38, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści łyżkę pakowaną w pojedyncze foliowe opakowanie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 151

Pakiet 38, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści łyżkę i rękojeść osobno pakowane?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 152

Pakiet 38, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści łyżkę i rękojeść wykonane wyłącznie z metalu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 153

Pakiet 38, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści łyżkę kodowaną wyłącznie numerycznie zarówno na łyżce jaki i na opakowaniu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 154

Pakiet 38, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 155

Pakiet 41, pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 120cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwie z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml
- Czas stosowania 29dni, potwierdzone badaniami?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 156

Pakiet 41, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści równoważne worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 157

Pakiet 59, pozycja 1 Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 59 pozycję 1 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 158

Pakiet 55. Czy Zamawiający dopuści pułapki 5-komorowe? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 159

Pakiet 57. Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwania o długości ostrza 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, 6 mm.

Pytanie nr 160

Pakiet 58, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo; współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,3mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 161

Pakiet 58, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku w polietylenowej osłonce, otwarcie łyżeczek 8 mm, długość szczęk 3,86 mm? Pozostałe parametry zgodne z SZW.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 162

Pakiet 58, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku w polietylenowej osłonce, otwarcie łyżeczek 8 mm, długość szczęk 3,86 mm? Pozostałe parametry zgodne z SZW.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 163

Pakiet 59, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści dwustronne szczotki jednorazowego użytku o długości 250cm do czyszczenia kanałów endoskopowych, śr. cewnika 1,7 mm; średnica włosa szczotki 6 mm (z obu stron) dł. 20mm; dostosowane do wszystkich rodzajów endoskopów giętkich?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 164

Pakiet 60. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii wykonane z drutu plecionego o standardowej sztywności o średnicy 25 mm lub 32 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 165

Czy Zamawiający w pak 24 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) całkowicie suchy (niewymagający wypełnienia zastawki wodą - gotowy do użycia), z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10-40 cm H₂O, posiadający możliwość wypełnienia mechanicznej zastawki wodą w celu monitorowania przecieku powietrza, wyskalowany do objętości 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 26 cm i konstrukcji niewymagającej

mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bez lateksowym zabezpieczeniem przed zagięciem, z możliwością odłączenia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 166

Czy Zamawiający w pak 24 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta pakowany po 14 magazynków w opakowaniu wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 167

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pak 25 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

Rozporządzenie UE 2017/745, rozdział 1 – Definicje specyficzne dla zasad klasyfikacji stanowi:

„Ośrodkowy układ krążenia” oznacza następujące naczynia krwionośne: tętnice płucne, aorta wstępująca, łuk aorty, aorta zstępująca do rozwidlenia aorty, tętnice wieńcowe, tętnica szyjna wspólna, tętnica szyjna zewnętrzna, tętnica szyjna wewnętrzna, tętnice mózgowie, pień ramiennie-główny, żyły sercowe, żyły płucne, żyła główna górna i żyła główna dolna.

Odpowiedź: Po stronie producenta/importera dostarczającego wyroby do Szpitala, istnieje konieczność dostosowania się do obowiązujących zapisów prawa. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt spełniający zapisy odpowiednich ustaw.

Pytanie nr 168

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego.

Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w pak 25 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Po stronie producenta/importera dostarczającego wyroby do Szpitala, istnieje konieczność dostosowania się do obowiązujących zapisów prawa. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt spełniający zapisy odpowiednich ustaw.

Pytanie nr 169

Czy Zamawiający w pak 34 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny jednorazowego użytku, załadowany 35 zszywkami ze stali chirurgicznej, zszywka szeroka (wys.7,2 mm; szer. 4,9 mm, szer. b. 0,6 mm)?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 170

Czy Zamawiający w pak 34 poz. 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny jednorazowego użytku, załadowany 35 zszywkami ze stali chirurgicznej, zszywka szeroka (wys.7,2 mm; szer. 4,9 mm, szer. b. 0,6 mm)?

Odpowiedź: Nie, konieczność załadunku 55 zszywek.

Pytanie nr 171

Czy Zamawiający w pak 34 poz. 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego producenta biologicznie czysty pakowany po 54 sztuki?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 172

dotyczy pakietu 12 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra oddechowego z celulozowym wymiennikiem ciepła w wilgoci z portem do kapnografu, elektrostatycznego, o przestrzeni martwej 60ml, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 173

dotyczy pakietu 12 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra oddechowego sterylnego z portem do kapnografu, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o wydajności nawilżania 32,3 mg H₂O/L przy VT 500ml, utrata wilgoci 6mg H₂O/L przy VT 500ml, o wadze 31g?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 174

dotyczy pakietu 12 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wymiennika ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, z centralnie umieszczonym zatraskowym portem do odsysania oraz wbudowaną obrotową centralnie umieszczonym portem do podaży tlenu, o wydajności nawilżania 26mg H₂O/L przy VT 500ml, przestrzeni martwej 19ml, waga 8gi oporze 0,2cm H₂O przy przepływie 30L/min?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 175

dotyczy pakietu 12 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łącznika martwa przestrzeń prosta o długości 7-15cm, sterylna?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 176

dotyczy pakietu 12 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łącznika martwa przestrzeń prosta o długości 17cm, mikrobiologicznie czysta?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 177

dotyczy pakietu 12 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łącznika martwa przestrzeń zespoloną z podwójnie obrotowym kolankiem z portem do odsysania i bronchoskopii o długości 7-15cm, sterylny?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 178

dotyczy pakietu 12 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łącznika martwa przestrzeń zespoloną z podwójnie obrotowym kolankiem z portem do odsysania i bronchoskopii o długości 17cm, sterylny?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 179

dotyczy pakietu 21 poz. 2-5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, z koniuszkiem mankieta nie podwijającym się podczas zakładania, w rozmiarach : 2, 3, 4, 5, z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankieta, maksymalnej objętości wypełnienia mankieta na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 180

dotyczy pakietu 26 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obwodu oddechowego anestetycznego, składającego się z 2 rur o regulowanej długości w zakresie 40-200cm, trzecia rura do worka o regulowanej długości 40-150cm, z łącznikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem do kapnografii oraz workiem oddechowym bezlateksowym o pojemności 2L z pętelką do zawieszania oraz z kapturkiem zabezpieczającym układ od strony pacjenta?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 181

dotyczy pakietu 26 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie układu oddechowego do respiratora dla dorosłych z rur karbowanych o średnicy 22mm o długości 160cm z łącznikiem Y oraz kapturkiem zabezpieczającym od strony pacjenta, pakowany folia-folia?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 182

dotyczy pakietu 26 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie układu oddechowego do respiratora dla dorosłych z rur karbowanych o średnicy 22mm o długości 200cm z łącznikiem Y oraz kapturkiem zabezpieczającym od strony pacjenta, pakowany folia-folia?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 183

dotyczy pakietu 26 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie układu oddechowego do respiratora dla dorosłych z rur karbowanych o regulowanej długości i średnicy 22mm, do 200cm długości, z łącznikiem Y oraz kolankiem z portem luer, pakowany folia-folia?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 184

dotyczy pakietu 36 Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w celu zapewnienia najwyższej skuteczności fototerapii i najwyższego bezpieczeństwa u najmniejszych pacjentów wymagając okularków zapewniających min. 99,999% ochronę oczu przeciwko promieniom UV, wymaga również potwierdzenia niniejszego faktu niezależnym badaniem i dokumentami od producenta?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 185

dotyczy pakietu 36 Czy Zamawiający w celu zachowania prewencji incydentów medycznych polegających na przypadkowym odklejeniu naklejki identyfikacyjnej z okularków wymaga oznaczeń graficznych (wieloryb, kaczką, serce), kolorystycznych (turkusowy, zielony, granatowy) oraz wielkości (reg, prem, micro) umiejscowionych na opakowaniach?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 186

dotyczy pakietu 36 Czy Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka przesuwania się okularków oraz zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa fototerapii, oprócz rozmiarów dot. obwodu głowy wymaga również odpowiedniej szerokości opaski dostosowanej dla:

- noworodków rozmiar 30-38cm – kolor turkusowy, znak graficzny – wieloryb, szerokość opaski 56 cm
- wcześniaków rozmiar 24 – 33 cm – kolor zielony, znak graficzny – kaczką, szerokość opaski 46 cm
- mikro rozmiar 20-28 cm – kolor granatowy, znak graficzny – serce, szerokość opaski 46 cm

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 187

Pakiet 48 poz.1-3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z włókniny SMMMS, posiadającego dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z laminatu 2-warstwowego folia polietylenowa oraz włóknina polipropylenowa po wewnętrznej stronie fartucha i w $\frac{3}{4}$ rękawów. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch owinięty wewnętrznie w serwetę włókninową z dwoma sztukami ręczników włókninowych do osuszania rąk?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 188

Pakiet 52 poz.1-7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych, pudrowanych o zawartości protein <100µg/g, poziomie AQL 0.65, długości min.280mm, grubości 0,19mm środkowy palec (ścianka pojedyncza)?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 189

Pakiet 52 poz.8-9 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych, ortopedycznych, sterylnych o rozciągliwości przed starzeniem min.700%, wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem min.27N potwierdzona oświadczeniem producenta, rękawice składane w połowie, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 190

Pakiet 52 poz.10-14 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o grubości 0,19mm środkowy palec (ścianka pojedyncza), długości min.282mm, sile zrywu przed starzeniem min.13N, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 191

Pakiet 52 poz.15-17 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowych, bezpudrowych o rozciągliwości przed starzeniem 650%. Opakowanie a'50 szt. (25 par). Pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 192

Pakiet 52 poz.20 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic winylowych o grubości na palcu 0,08mm, sile zrywu przed starzeniem min.3,6N?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 193

Pakiet 52 Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388. Pragniemy wyjaśnić, iż w przypadku zgodności rękawic z nowym rozporządzeniem unijnym oraz normą tj. EN ISO 374-1 zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z EN 388.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 194

Pakiet 53 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy ilości rękawic są podane w opakowaniach a 100 sztuk?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 195

Pakiet 54 poz.1-5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych o obniżonej grubości na palcu 0,09mm, rolowany mankiet, mikroteskturowane z tekstura na palcach, chlorowane od wewnątrz, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytania do wzoru umowy**Pytanie nr 196**

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 2 projektu umowy poprzez zmianę terminu realizacji reklamacji na 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 197

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do poziomu:

- a. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. A);
- b. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. D).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 198

Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i

samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dot. asortymentu:

Pytanie nr 199

Pakiet 35 poz.1-3: Czy Zamawiający wymaga: nieresorbowalna lekka siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej jednowłókienkowej o średnicy 0,16mm, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności i niskiej masie powierzchniowej: 60-85 g/m² i grubości siatki 0,45 +- 0,05 mm, oraz niestrzępiących się brzegach i wysokiej wytrzymałości na wyrwanie szwu, optymalna sztywność, wytrzymałość – w kierunku wzdłużnym i poprzecznym >250 N; porowatość siatki – min. 60%(+/-5); siatka wykonana techniką dzianą z możliwością przycinania jej brzegów?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 200

Pakiet 37: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 15x250 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pytanie nr 201

Pakiet 43 poz. 6: Czy Zamawiający wymaga serwety o min gramaturze 43g/m² i jałowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 202

Pakiet 45: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- serweta 240x150cm z przylepcem -1szt.
- serweta 180x170cm z przylepcem - 1szt.
- serwety 90x75cm z przylepcem - 2szt.
- ręczniki celulozowe 20x40cm - 4szt.
- serweta 190x150cm na stół do instrumentarium - 1szt.
- serweta 145x80cm na stolik MAYO - 1szt.
- taśma medyczna mocująca 50x9cm - 1szt.

Obłożenie operacyjne wykonane z włókniny laminowanej trójwarstwowej o gramaturze minimum 73 g/m²?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 203

Pakiet 47: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na ramię C o rozmiarze 183x104cm z dwoma trokami z przylepcami na końcu (przylepce z fingerliflami)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 204

Pakiet 48: Czy Zamawiający dopuści fartuch, w którym wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów wykonane są z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego polipropylenowo-polietylenowego, pakowany z rączniczkami z włókniny kompresowej (2 szt.)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 205

Pakiet 49 poz. 1-13: Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-14 z pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 206

Pakiet 49 poz. 1-9: Czy Zamawiający dopuści rękawy z oznaczenie norm „ISO 11607-1,2 EN 868-5” na linii zgrzewu fabrycznego?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 207

Pakiet 50 poz. 1- 5: Czy Zamawiający dopuści komplety z włókniny SMS, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 208

Pakiet 54 poz. 1-5: Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe diagnostyczne/zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,07 mm, na dłoni min. 0,07 mm, na mankiecie min. 0,05 mm, powierzchnia gładka, palce teksturowane, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, chlorowana, wydłużenie 400 – 500%, siła zrywająca przed i po starzeniu 7–7,5 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice są środkiem ochrony indywidualnej kat III. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F1671, ASTM D5151, ASTM D6124, ASTM D6319, ASTM D7160, ASTM D7161 , przebadane zgodnie z normą PN EN 16523-1, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rękawice muszą wykazywać odporność na przenikanie na co najmniej 8 substancji chemicznych, z czego min. 8 substancji na 6 poziomie odporności, (na potwierdzenie wyniki badań wytwórcy zgodnie z normą PN EN 16523-1). Rękawice muszą posiadać odporność na leki cytostatyczne, min. 14 cytostatyków (na potwierdzenie wyniki badań wytwórcy wg normy ASTM D6978). Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Okres ważności 5 lat?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 209

Pakiet 54 poz. 1-5: Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe diagnostyczne/zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,05 mm, na dłoni min. 0,05 mm, na mankiecie min. 0,04 mm, powierzchnia gładka, palce teksturowane, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, chlorowana, wydłużenie 400 – 500%, siła zrywająca przed i po starzeniu 6-7 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice są środkiem ochrony indywidualnej kat III. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F1671, ASTM D5151, ASTM D6124, ASTM D6319, ASTM D7160, ASTM D7161 , przebadane zgodnie z normą PN EN 16523-1, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rękawice muszą wykazywać odporność na przenikanie na co najmniej 8 substancji chemicznych, z czego min. 7 substancji na 6 poziomie odporności, (na potwierdzenie wyniki badań wytwórcy zgodnie z normą PN EN 16523-1). Rękawice muszą posiadać odporność na leki cytostatyczne, min. 14 cytostatyków (na potwierdzenie wyniki badań wytwórcy wg normy ASTM D6978). Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Okres ważności 4 lata?

Odpowiedź: Nie, dopuszczamy.

Pytanie nr 210

Pakiet 61 poz.1: Czy Zamawiający dopuści: taśma do wysiłkowego nietrzymania moczu, lekka, sterylna, do metod implantacyjnych TOT, TVT, TVT-O, monofilament polipropylenowy niewchłaniający, transparentny i niebieski, gramatura 64-73 g/m², szerokość taśmy 0,9-1,3cm, porowatość 67%, długość taśmy bez uchwyty 45 cm, bez osłonki, niebieskie uchwyty do zamocowania taśmy na aplikatorze, zabezpieczone termokurczliwą rurką w miejscu łączenia uchwyty z taśmą, pakowana pojedynczo, 4 etykiety identyfikujące wyrób?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 211

Pakiet 61 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sześcioramiennej lekkiej siatki ginekologicznej, przeznaczonej do chirurgicznego leczenia obniżenia narządu rodowego u kobiet, wytwarzanej techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej w kolorze transparentnym i niebieskim; gramatura 40(+/-5)g/m², szerokość 600(+/-2)mm, wysokość 300(+/-2)mm, bez prowadnic?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Dot. projektu umowy:**Pytanie nr 212**

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w § 3 ust. 9 w sformułowaniu „z zastrzeżeniem zapisów §3 ust. 9”? Obecnie §3 ust. 9 odwołuje się sam do siebie.

Odpowiedź: W projekcie umowy, nie mamy § 3 ust. 9 z „z zastrzeżeniem zapisów §3 ust. 9”

Pytanie nr 213

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 15 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem

umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 214

Czy Zamawiający zgadza się aby numer zamówienia był naniesiony na dokument WZ?

Numer zamówienia nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania numeru zamówienia na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru zamówienia bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia numeru zamówienia na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dla Zamawiającego specjalnej obsługi, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które wpłyną na kalkulację i wysokość ceny oferowanej w przetargu. Brak modyfikacji § 4 ust. 2 wzoru umowy może zatem doprowadzić do zaoferowania w przetargu wyższych cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 215

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z §6 ust. 1 pkt A wzoru umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 216

Czy Zamawiający wykreśli punkt B w §6 punkt 1? Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo §6 ust. 3 wzoru umowy

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 217

Pakiet 1, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści igły j.u. w rozmiarze 0,8x50mm?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 218

Pakiet 1, pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne do pobierania leków w rozmiarze 1,2x40mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 219

Pakiet 1, pozycja 28 – Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne do pobierania leków z bocznym otworem bez filtra, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 220

Pakiet 4, pozycja 6-20- Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem z balonikiem posiadającym oznaczenie numeru serii i rozmiaru, bez nazwy producenta?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 221

Pakiet 4, pozycja 6-24- Czy Zamawiający dopuści rurki wyposażone w znacznik głębokości w postaci dwóch półpięścieni?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 222

Pakiet 4, pozycja 25-30 - Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych, wykonane z aluminium pokrytego PCV, w rozmiarze:

-6 Fr o średnicy 2.0 mm, pasujące do rurek w rozmiarze od 2,0 do 4,0

-10 Fr o średnicy 3.3 mm, pasujące do rurek w rozmiarze od 4,5 do 6,5

-14 Fr o średnicy 4.7mm, pasujące do rurek w rozmiarze od 7,0 do 10,0?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 223

Pakiet 5, pozycja 41-45 – Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia tylko o długości 500 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 224

Pakiet 5, pozycja – Czy Zamawiający dopuści końcówkę do drenu o średnicy wewnętrznej 3,9 i zewnętrznej 6,9mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 225

Pakiet 9, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o długości 180cm?

Odpowiedź: Nie, dopuszczamy.

Pytanie nr 226

Pakiet 9, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o długości 116cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 227

Pakiet 9, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkład w rozmiarze 140x100cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 228

Pakiet 17, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwuwarstwowej, jednorazowej myjki do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy, nasączonej jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny, obie warstwy myjki nie podfoliowane, rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2, produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty), czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 229

Pakiet 17, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 230

Pakiet 17, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej myjki do mycia ciała noworodków nasączoną środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 z dodatkiem aloesu, wykonaną w całości z poliestru o gramaturze 400g/m2, rozmiar 12cm x 10cm, produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty), czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 231

Pakiet 17, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 232

Pakiet 34, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów załadowanych 35 zszywkami w rozmiarze 7,2 x 4,9mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 233

Pakiet 34, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów załadowanych 35 zszywkami w rozmiarze 7,2 x 4,9mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 234

Pakiet 34, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów załadowanych 35 zszywkami w rozmiarze 5,9 x 3,9mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 235

Pakiet 37 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 16x200cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 236

Pakiet 43, pozycja 1,2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 237

Pakiet 43, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 210x130cm, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 238

Pakiet 43, pozycja 3-4 - Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 239

Pakiet 43, pozycja 3-4 - Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 240

Pakiet 43, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x80cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 241

Pakiet 43, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm lub 7cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 242

Pakiet 44, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 50 opakowań?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 243

Pakiet 44, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 244

Pakiet 44, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 25 opakowań?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 245

Pakiet 44, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki, wykonany w całości z perforowanej włókniny Spunlace Mesh o gramaturze 35g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, ,opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 246

Pakiet 44, pozycja 4,5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 247

Pakiet 44, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m² w części górnej, ze wstawką antypotną z włókniny Spunlace Mesh, opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 248

Pakiet 44, pozycja 4,6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 249

Pakiet 44, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonną pot, wiązany z tyłu na troki, wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², wstawka antypotna 38g/m², opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 250

Pakiet 44, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści maski z trokami o dł. 40cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 251

Pakiet 44, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 252

Pakiet 44, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 253

Pakiet 45 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 254

Pakiet 47 - Czy Zamawiający dopuści sterylny, trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt. taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 255

Pakiet 48 pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści fartuch z owinięciem w serwetę włókninową, zamiast w papier krepowy?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 256

Pakiet 48 pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu: polipropylen spunbond + folia PE?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 257

Pakiet 50, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające, bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z trokami w pasie, dostępne w dwóch kolorach: zielonym, niebieskim, zgodnie z EN 13795-2:2019?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 258

Pakiet 54, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na placu 0,11mm+/-0,01?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 259

Pakiet 54, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o posiadające teksturę na końcach palców?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 260

Pakiet 54, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikanie min. 12 cytostatyków potwierdzone raportem z badań wykonanych w jednostce niezależnej?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 261

Pakiet 54, pozycja 1-5 - Prosimy Zamawiającego o wskazanie planowanej ilości na 12 miesięcy.

Odpowiedź: Na platformie zakupowej Zamawiającego został udostępniony poprawiony zał. nr 3 w pakiecie 54.

Pytanie nr 262

Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki bez wkładki luer i zatyczki, ponieważ tak duży rozmiar występuje wyłącznie z końcówką lejkowatą?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 263

Pakiet 7, pozycja 1-7 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki o długości 105cm spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 264

Pakiet 7, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści worek z drenem o długości 150cm zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, pakowany w folie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 265

Pakiet 8, pozycja 4-5 Czy Zamawiający dopuści woreczki 100ml?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 266

Pakiet 9, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 1,16m?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 267

Pakiet 9, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 1,8m?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 268

Pakiet 9, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści sterylną pęsetę?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 269

Pakiet 9, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków pakowanych a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 270

Pakiet 9, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści kieliszki 30ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 271

Pakiet 9, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści pojenik 250ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 272

Pakiet 9, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści pojenik z jedną przykrywką?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 273

Pakiet 9, pozycja 14 Czy Zamawiający oczekuje wyceny za rolkę czy sztukę?

Odpowiedź: Za rolkę.

Pytanie nr 274

Pakiet 9, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści koc 210x160?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 275

Pakiet 9, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści zaciskacz sterylony?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 276

Pakiet 10, pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści wzierniki z regulacją szpilką?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 277

Pakiet 17, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści papier 112x25?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 278

Pakiet 17, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści szkiełka 76mm x 26mm x 1mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 279

Pakiet 17, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści lusterko o średnicy 19mm i długości rączki 180mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 280

Pakiet 17, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści zwykły lancet bez plastikowej osłonki w aluminiowym opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 281

Pakiet 17, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej chromem o rozmiarze 0,8 x 3,6 x 0,01 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 282

Pakiet 17, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści szczotkę o wymiarach całkowitych 90x45x39, z włosiem wykonanym z polietylenu i gąbką z poliuretanu, pakowane po 40 sztuk?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 283

Pakiet 17, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści basen 1,2-1,5l?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 284

Pakiet 17, pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 875ml?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 285

Pakiet 19, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści lejce: $\varnothing 1,5 \times 1,0 \text{ mm} \times 40 \text{ cm}$; $\varnothing 2,4 \times 1,2 \text{ mm} \times 40 \text{ cm}$; $\varnothing 2,4 \times 1,2 \text{ mm} \times 75 \text{ cm}$, $\varnothing 5,0 \times 1,5 \text{ mm} \times 40 \text{ cm}$?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 286

Pakiet 5 pozycja 47-49 Czy Zamawiający dopuści dreny do podawania tlenu o długości 200cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 287

Pakiet 6 pozycja 2-5 Czy Zamawiający dopuści dreny redona z data ważności i opisem polskim na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 288

Pakiet 22 pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane z PCV?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 289

Pakiet 26 pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o opisie:

Wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP
 Uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F
 umożliwiające podłączenie do kompatybilnych
 produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej
 lub aparatu do znieczulenia
 Regulowana długość obwodu umożliwiająca
 dopasowanie długości układu oddechowego oraz
 optymalizację przestrzeni martwej
 Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160 cm,
 połączone łącznikiem Y
 Rozłączalne kolanko z portem Luer-Lock z koreczkiem
 Jednorazowego użytku
 Nie zawiera lateksu
 Nie zawiera ftalanów
 Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
 Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

PRZEZNACZENIE	ŚREDNICA RUR	DŁUGOŚĆ OBOWDU (MIN / MAX)
DOROŚLI	22 mm	60 cm / 160 cm
DZIECI	15 mm	60 cm / 160 cm

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 290

Pakiet 29 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 291

Pakiet 41, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 292

Pakiet 41, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 293

Pakiet 53, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe niebieskie?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 294

Pakiet 53, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe czarne?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 295

Pakiet 53, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe malinowe?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 296

Pakiet 66, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 297

Pakiet 54 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpydrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 $\geq 6,0N$. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Układane warstwowo, płasko, automatycznie. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 3 substancji na poziomie co najmniej 2), Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 12 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzeniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 200 szt.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 298

Pakiet 52 poz. 1-7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, AQL max. 0,65, średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, mankiety rolowane. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 299

Pakiet 52 poz. 8-9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, ortopedycznych, lateksowych bezpydrowych z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową ułatwiająca zakładanie, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, brązowe, poziom protein < 50 µg/g rękawicy, średnia grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm, długość min. 280-295 mm Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Mankiety rolowane z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, Typ min. B. Opakowanie 40 par. Rozmiary 6,0-9,0.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 300

Pakiet 52 poz. 10-14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpydrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; średnia grubość na palcu 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 16 N, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne. Długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6,

w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 301

Pakiet 52 poz. 10-14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, mankiety rolowane. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. Grubość (mediana) na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 7 substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min zgodnie z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1 (raport wystawiony przez jednostkę notyfikowaną). Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 302

Pakiet 52 poz. 15-17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL ≤1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), o grubości (mediana) na palcu 0,15mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,07 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony). Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 8 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, przebadane na penetrację min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978 oraz przebadane na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 i EN ISO 374-5. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzeniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 303

Pakiet 52 poz. 15-17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych niejałowych do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części dłoniowej, AQL 1,0; grubość na palcu (mediana) 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1 z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. Odporność na cytostatyki zgodnie z ASTM D 6978, potwierdzona raportem z wynikami badań, w tym Karmustyny i Thiotepa z czasem przenikania >40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Spełniające normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary XS-XL, oznaczenie kolorystyczne w zależności od rozmiaru, pakowane po 50 sztuk.

Odpowiedź:

Pytanie nr 304

Pakiet 52 poz. 20 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych, bezpudrowych, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Grubość na palcach, min. 0,06 mm, na dłoni 0,06 mm, na mankiecie min. 0,04 mm. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 305

Pakiet 50, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań operacyjnych o opisanych parapetach pakowanych w torbę z zaklejonym otworem.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy,

Pytanie nr 306

Pakiet 45, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna (taśma lepna dł. ok 80 cm)
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z mikrościągą zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H₂O) odpornego na rozzerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 307

Pakiet 45, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm z mocnej folii PE min. 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1x serweta na stół Mayo 80 x 142 składana rewersowo
- 2 x serweta boczna 75 x 100 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta górną 160x260 cm, przylepna
- 1 x serweta dolną 195x 200 cm, przylepna
- 1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, z zaokrągloną końcówką ułatwiająca rozdzielanie, dzięki której podczas rozpięcia nie spowoduje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna 2 cm końcówka z drugiej) część dolną i górną taśmy 2,5x 13 -14cm
- 4 x ręcznik chłonny z mikrościągą zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30
- Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepyłącego (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$) laminatu trójwarstwowego o gramaturze 66 g/m² bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta (w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 308

Pakiet 45, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

- 1x serweta na stół narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni
- 1x serweta na stół Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm
- 4x ręcznik chłonny 40x40 cm
- 1x taśma lepna 10x50 cm
- 1x taśma lepna 10x25 cm
- 2x serweta boczna 75x90 cm
- 1x serweta górną 150x240 cm
- 1x serweta dolną 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m² ± 1 , dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów >180 cm H₂O) odpornego na rozzerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia $\leq 1,2 \log_{10}$). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji

medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN, następnie zbiorczo w karton. Sterylizacja EO.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 309

Pakiet 45, Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu, dzięki czemu serwety są mniej pogniecione i nie posiadają nieprzyjemnego zapachu jak w przypadku sterylizacji radiacyjnej

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 310

Pakiet 45, Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 311

Pakiet 45, Czy zamawiający oczekuje zestawu z 4 etykietami do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 312

Pakiet nr 58, poz.4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku pokrytych równoważną do powłoki teflonowej powłoką hydrofilną, łożeczki owalne. Długość narzędzia 1600mm, średnica osłonki 2,3mm, otwarcie łożeczek kleszczy min. 6,6 mm, długość szczęk 4,0mm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 313

Pakiet nr 58, poz.5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku pokrytych równoważną do powłoki teflonowej powłoką hydrofilną, łożeczki owalne. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm, otwarcie łożeczek kleszczy min. 6,6 mm, długość szczęk 4,0mm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 314

Pakiet nr 60, poz.1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do poliektomii jednorazowego użytku o średnicy pętli od 25 do 30 mm, parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

DYREKTOR
SPZOZ Międzyclót

mgr Bartosz Grobelny⁽¹⁾