

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 02.07.2024
EZ/125/2023/...483.....

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sterylnego- (nr postępowania 125/2023).**

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PAKIET NR 5

Teleflex Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa
NIP 5223086403

Całkowita wartość zamówienia wynosi 4 002,90 zł netto; 4 323,13 zł brutto
Wpłynęła 1 oferta; odrzucono 0 ofert, wykluczono 0 Wykonawców.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty	Nazwa Oferenta/Wykonawcy	Cena oferty	punktacja
11	Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa NIP 5223086403	4 002,90 zł netto 4 323,13 zł brutto	100

PAKIET NR 33

Teleflex Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa
NIP 5223086403

Całkowita wartość zamówienia wynosi 25 940,00 zł netto; 28 015,20 zł brutto
Wpłynęła 1 oferta; odrzucono 0 ofert, wykluczono 0 Wykonawców.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty	Nazwa Oferenta/Wykonawcy	Cena oferty	punktacja
11	Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa NIP 5223086403	25 940,00 zł netto 28 015,20 zł brutto	100

PAKIET NR 53

NEOMED POLSKA Sp. z o.o.
ul. Orężna 6A,
Piaseczno, 05-501
NIP 123 128 41 33

Całkowita wartość zamówienia wynosi 58 500,00 zł netto; 63 180,00 zł brutto
Wpłynęły 4 oferty; odrzucono 0 ofert, wykluczono 0 Wykonawców.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty	Nazwa Oferenta/Wykonawcy	Cena oferty	punktacja
12	NEOMED POLSKA Sp. z o.o. ul. Orężna 6A, Piaseczno, 05-501 NIP 123 128 41 33	58 500,00 zł netto 63 180,00 zł brutto	100
17	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń.... NIP. 879-016-67-90.	62 550,00 zł netto 67 554,00 zł brutto	93,52
18	FAPOMED POLSKA Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/53 Warszawa 01-059 NIP: 7792447771	100 500,00 zł netto 108 540,00 zł brutto	58,21
31	ZARYS International Group spółka z ograniczoną ul. Pod Borem 18 Zabrze, 41-808 NIP PL 648-19-97-718	60 300,00 zł netto 65 124,00 zł brutto	97,01

PAKIET NR 54

Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
NIP 788-00-08-829

Całkowita wartość zamówienia wynosi 464 100,00 zł netto; 501 228,00 zł brutto
Wpłynęły 2 oferty; odrzucono 0 ofert, wykluczono 0 Wykonawców.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty	Nazwa Oferenta/Wykonawcy	Cena oferty	punktacja
-----------	--------------------------	-------------	-----------

14	Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl NIP 788-00-08-829	464 100,00 zł netto 501 228,00 zł brutto	100
16	OPTIMED PRO-OFFICE A.P. SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA ul. FORTECZNA 5 32-086 WĘGRZCE NIP 5130254345	451 500,00 zł netto 487 620,00 zł brutto	odrzucona

Zamawiający odrzuca ofertę firmy Optimed Pro Office A.P. Szewczyk Spółka jawna z siedziba w Węgrzycach.

W wyniku ponownej oceny ofert Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie złożonej oferty zadając mu pytania do zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Po ponownej wnikliwej analizie wyjaśnień stwierdzono, iż oferta nie spełnia opisu przedmiotu zamówienia.

W odpowiedzi na zapytania stwierdza się co następuje :

Punkt 1. Czy szybkość przepływu dla igły G20 wynosi 5ml/s?



Wykonawca Odpowiedział :

CT Injectable Ports

districAth

PETITS MODÈLES /

- Pacjenci z chemioterapią wymagają częstych badań obrazowych (CT)
- Port umożliwia podawanie kontrastu pod wysokim ciśnieniem
- Przepływ 5ml/sec @300psi

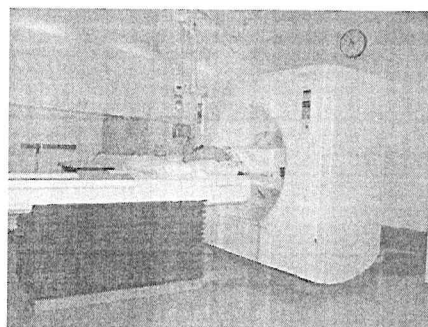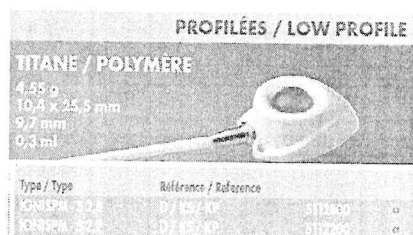

Producent potwierdza przepływ dla igły 5ml/s.

Odpowiedź ta nie zawiera rozmiaru igły (wymagany przepływ dla igły G20), ani klasy oferowanego produktu.

Zaoferowany asortyment w formularzu cenowym to : KP5112800 KP5112200 Districlass Medical SA, co z katalogu dołączonego przez Oferenta wynika, że jest to typ IONISPM (jak na rysunku powyżej).

Na oficjalnej stronie producenta Districlass Medical SA, Francja <https://districlass.com/wp-content/uploads/2023/01/2021-12-districath.pdf>

z załączonego do instrukcji obsługi dokumentu (str. 23 - zawierającego parametry poszczególnych klas produktów) wynika, że dla klasy

IONIS PM – szybkość przepływu pod ciśnieniem wynosi 3 ml/s dla igły 19G

Producent nie podaje parametru przepływu dla igły 20G wcale, a jest do igła cieńsza niż igła 19G, wobec czego można wnioskować, że szybkość przepływu będzie się zmniejszać a nie zwiększać.

Oczywiście inne produkty tego producenta mają przepływ 5ml/s, jednak również dla igły 19G i w klasach : IONIS, ELIES, AXIAL M oraz AXIAL G.

Punkt 2. Czy koszulka rozszerzacza naczyń jest wyposażona w służbę hemostatyczną (redukującą krwawienie i ryzyko zatoru powietrznego), powłokę hydrofobową oraz posiada wytłoczoną linię nacięcia?

Informacja od producenta: KP5112200 może być wyposażony w introduktor zaworu zgodnie z opisem ->"rozrywalna koszulka z rozszerzaczem naczyń wyposażona w służbę hemostatyczną redukującą krwawienie i ryzyko zatoru powietrznego"

Wiadomość napisana przez districlass@districlass.com w dniu 13 05 2024, o godz. 09:28.

Dear Marcin,

KP5112200 can be provided with a valve introducer as described.

The price is different, you do have to add 10 euros for that accessory.

Best regards,

M. Pascal BUTTIN

Directeur Général



districlass médical sa

110 Allée Louis Lépine
69970 CHAPONNAY - France

Tél : + 33 4 72 50 43 75

Le 10/05/2024 12:59, « Logistic » <logistic@optimedero-office.eu> a écrit :

Hello,

We need an answer to the following question for the tender: does the vascular port gown KP5112200 meet such conditions?

"Dilatable vasodilator sheath equipped with hemostatic lock, to reduce bleeding and risk of air embolism, sheath with hydrophobic coating and embossed incision line"

Regards,

Marcin Kowalski

W odpowiedzi na zapytanie Oferent dołączył scan e-maila, w którym to zapytanie do producenta dotyczyło jedynie zaoferowanego zestawu KP5112200 (a nie również oferowanego zestawu KP5112800) oraz tylko pierwszej części pytania tj. „Czy koszulka rozszerzacza naczyń jest wyposażona w służbę hemostatyczną (redukującą krwawienie i ryzyko zatoru powietrznego)”, a nie wszystkich cech oferowanych produktów czyli „powłokę hydrofobową oraz posiada wytłoczoną linię nacięcia?”

Z odpowiedzi wynika, że introduktor (w zestawie KP5112200) „może być wyposażony ... w służbę hemostatyczną redukującą krwawienie i ryzyko zatoru powietrznego” (dodatkowo za opłatą 10 Euro).

Brak jest na temat powłoki hydrofobowej oraz czy koszulka posiada wytłoczoną linię nacięcia (o co nawet nie pyta Oferent w w/w e-mailu).

Punkt 3. Czy igła Seldingera jest echogeniczna i przeciwwakłuciowa?

Zestaw wprowadzając zawiera igłę punkcyjną do techniki Seldingera 18 G - 70 mm (1,3 x 70) wykonaną ze stali nierdzewnej umożliwiającą łatwe wprowadzenie przewodnika. Igła echogeniczna pozwalająca na lepsze uwidocznienie w obrazie USG. Igła w osłonie przeciwwakłuciowej.

potwierdzenie producenta :Nasza igła Seldinger do nakłuwania jest echogeniczna 18G i 70mm.

Dear Marcin,

Our Puncture needle is a 18G and 70mm, echogenic.

Best regards,

M. Pascal BUTTIN

Directeur Général



districlass médical SA

110 Allée Louis Lépine
69970 CHAPONNAY – France
Tél. : + 33 4 72 50 43 75

Le 04/06/2024 11:34, « Magazyn » <magazyn@optimedpro-office.eu> a écrit :

Dear Pascal ,

Is the puncture needle Seldinger that comes in the kit (e.g. with the KP5112200 port): echogenic (visible on ultrasound) ?

Accessoria dostępne w zestawie (f) :

- 1 igła punkcyjna
18 G - 70 mm



Z odpowiedzi Oferenta wynika tylko, że zaofertowana igła Seldingera 18G 70 mm jest echogeniczna, jednak to że znajduje się w osłonce przeciwwakłuciowej nie oznacza, że oferowana igła jest przeciwwakłuciowa. W pytaniu do Producenta nie jest wyszczególniony ten parametr do potwierdzenia, a na oficjalnej stronie Producenta

<https://districlass.com/wp-content/uploads/2023/01/2021-12-districtath.pdf> str. 5

oferowane są tylko zwykłe igły 18G – 70 mm (jak na informacji powyżej w e-mailu)

Zapytanie również dotyczyło jedynie zastawu KP5112200, a nie obu proponowanych zestawów.

W związku z powyższymi oferta jest niezgodna z SWZ i dopuszczeniem i podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna art. 255 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Umowa dostępna w formie elektronicznej – prośbę proszę wysłać za pośrednictwem platformy zakupowej. Data podpisania umowy ...16.07.2024r.....

Z poważaniem,

Naczelną Pielęgniarką
dr n. o zdr. Anna Pleszczyńska
2805372P