

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Opole, dn. 08.02.2023r.

L.dz. 243/DO/2023


Nr sprawy: ZP 1/2023

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa wirówek i ciepłarek laboratoryjnych**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami), wyjaśniam co następuje:

- 1. Dot. OPZ, Zad nr 1 – Wirówka laboratoryjna z rotorem horizontalnym – 3 szt.**  
Czy Zamawiający dopuści wirówki o szerokości max. 45,7 cm, głębokości 60 cm, wysokości 41,8 cm oraz wysokości z otwartą pokrywą 82,2 cm? Jednocześnie rozmieszczenie nóżek wirówek pozwala na ustawienie ich na blacie o szerokości do 45 cm i głębokości do 55 cm.

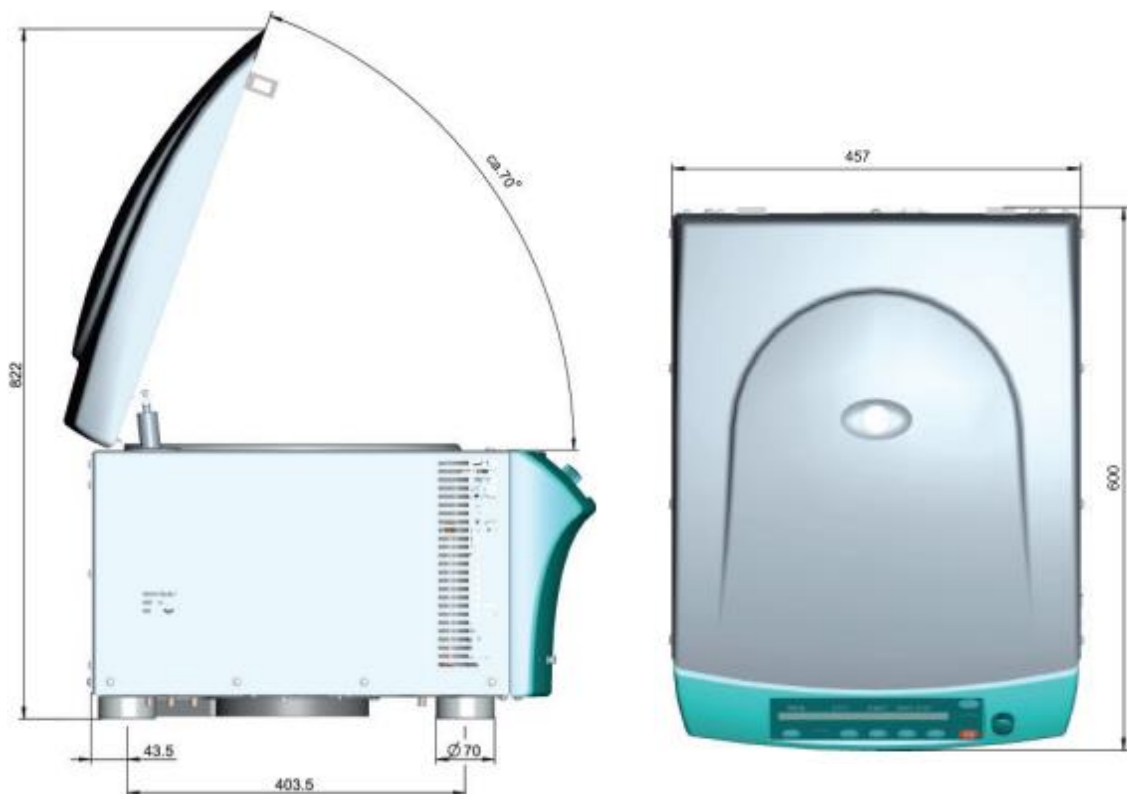

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę o maksymalnych wymiarach:**



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- a) szerokość 457 mm
  - b) głębokość 600 mm
  - c) wysokość 418 mm
  - d) wysokość z otwartą pokrywą 822 mm.
2. Dot. OPZ, Zad nr 1 – Wirówka laboratoryjna z rotorem horyzontalnym – 3 szt.  
Czy Zamawiający dopuści wirówki o wadze nie większej niż 51 kg?  
Parametr ten nie wpływa na funkcjonalność urządzeń.  
 **Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę o maksymalnej wadze 51 kg.**
3. Dot. OPZ, Zad nr 1 – Wirówka laboratoryjna z rotorem horyzontalnym – 3 szt.  
Czy Zamawiający dopuści wirówki o max. mocy 650W?  
Większa moc jest związana z wyższym zakresem obrotów (zakres od 50 do 15 000 obr/min).  
 **Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę o maksymalnej mocy 650W.**

Załącznikiem do niniejszego pisma jest ZMIENIONY w dn. 08.02.2023r. Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

*Powyzsza treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i należy ją uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.*