




Znak: AE/ZP-27-67/22

Tarnów, 2022-09-06

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę oraz niesterylnych jednorazowych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny, ochraniaczy na obuwie, pościeli, podkładów, prześcieradeł w roli, koszul i spodenek dla pacjentów, osłon na kończynę, pokrowców na słuchawki, pokrowców na zwłoki.


W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMMS?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zestaw nieznacznie różniący się jedynie rozmiarem dwóch serwet:
Serweta dolna 180 x 180 cm zamiast 180 x 175 cm
2 serwety boczne 75 x 100 cm zamiast 75 x 90 cm?
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym rozmiar otworów udowych posiada średnice 8,5 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 5 cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści serwetę z taśmą lepną?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści zestaw nieznacznie różniący się wymiarami o składzie;
 - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
 - 1 serweta 75 x 90cm;
 - 1 serweta 150 x 200cm;
 - 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm;
 - 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
 - 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
 - 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
 - 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
 - 4 ręczniki 30 x 40cm;

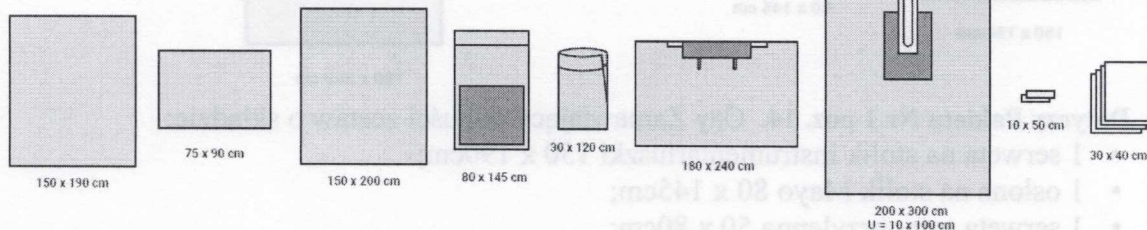


8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie nieznacznie różniącym się od opisanego

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta 100 x 150 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 foliowa osłona na przewody 15 x 250 cm;
- 1 serweta główna 200 x 300 cm, z otworem 25 x 20 cm otoczonym padem chłonnym 50 x 50 cm, ze zintegrowanym trójkątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtkę (szywnik), samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm i zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm

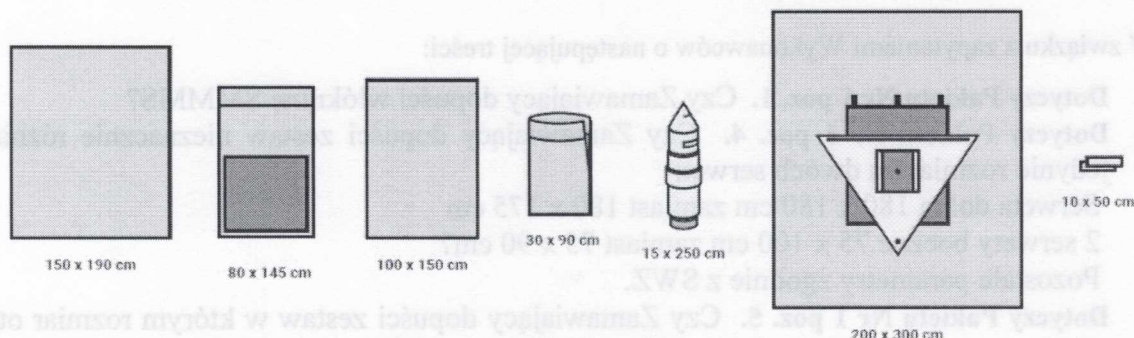

9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14.** Zamawiający dopuści zestaw o składzie:


- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przyklepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną z aperturą i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (szywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

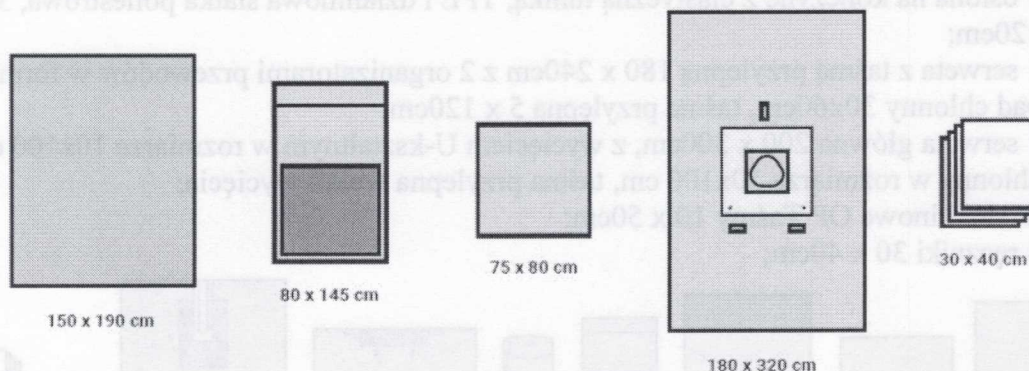

10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 50 x 80cm;
- 1 kieszeń dwukomorowa samoprzylepna 30 x 40cm;
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50cm;


- 1 serweta główna w kształcie litery T 250/150x300cm z otworem 35 x 35cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtki (szytwniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

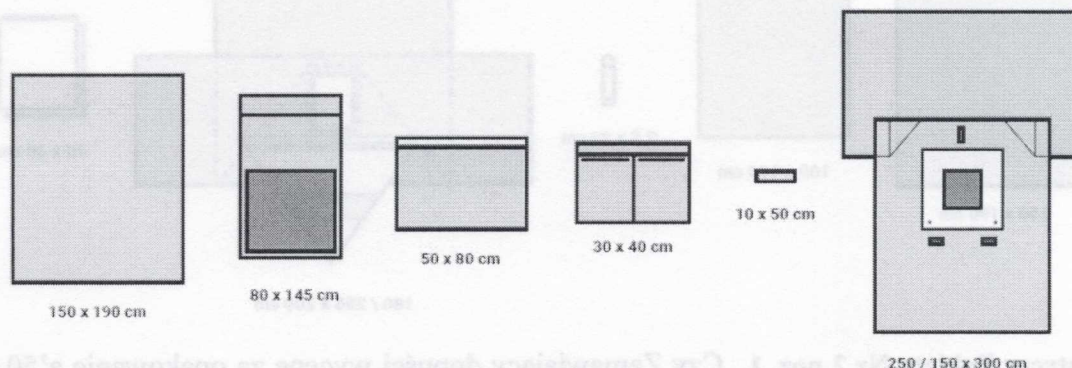

11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści zestaw różniący się jedynie rozmiarem serwety dolnej: 180x180 cm w zamian 180 z 175 cm?

12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie;


- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 przylepna kieszeń dwukomorowa 2 x 15 x 40 cm
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/240 x 280 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, otworem przylepnym 30 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną i otoczonym padem chłonnym 50 x 55 cm oraz otworem przylepnym 12 x 15 cm otoczonym padem chłonnym z płachtą umożliwiającą zakrycie otworu. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.;

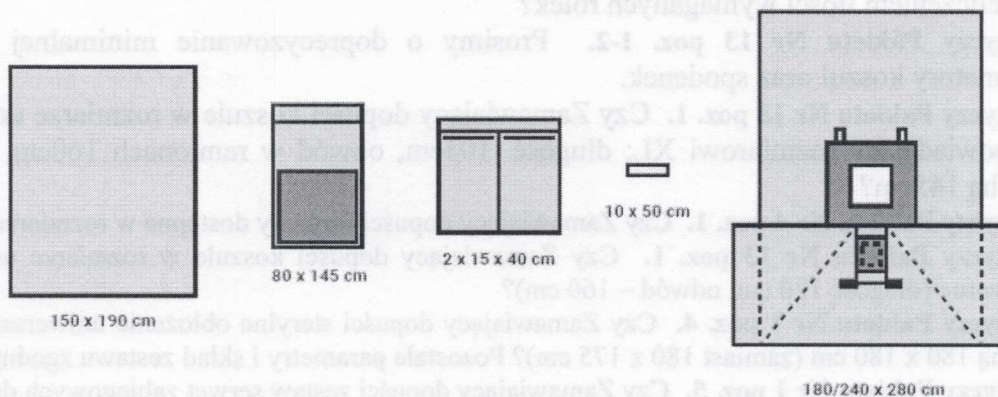

13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:


- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta 100 x 100 cm;
- 1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 23 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25 cm oraz trójkątnym zbiornikiem na płyny wyposażonym w kształtkę (szytwnik), separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka;

- 2 ręczniki 30 x 40 cm;

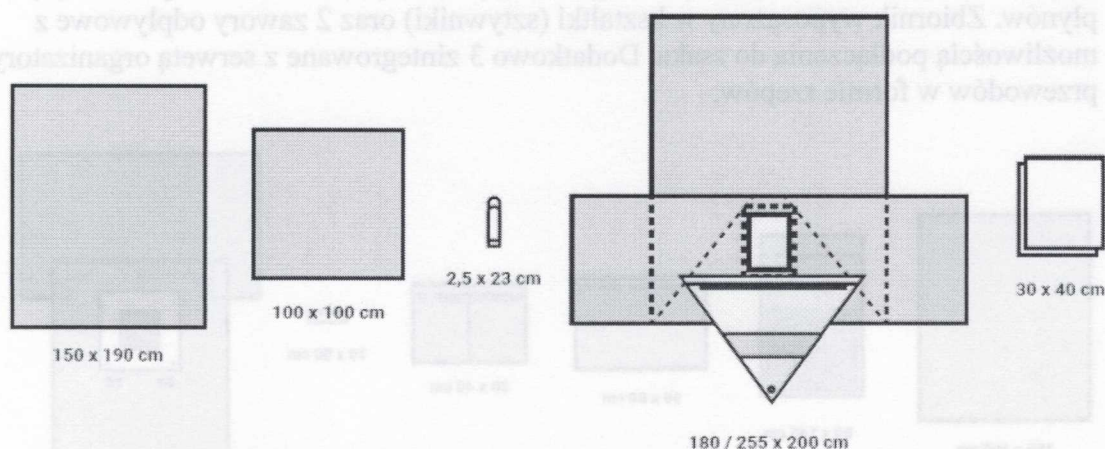

14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z przeliczeniem ilości?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-2.** Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane a'100 sztuk?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rozmiar Uniwersalny?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy o odstąpienie od normy EN14126
19. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie fartuchów uniwersalnych
20. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga aby ubrania spełniały normę EN 13795?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania posiadały trzy praktyczne ubrania na bluzie?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści rozmiar 140-160 x 80 cm?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradła długie 50mb z przeliczeniem ilości wymaganych rolek?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1-2.** Prosimy o doprecyzowanie minimalnej wymaganej gramatury koszul oraz spodenek.
25. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach L i XL?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym, obszernie (długość 120 cm, obwód – 160 cm)?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne z serwetą dolną 180 x 180 cm (zamiast 180 x 175 cm)? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z opisem.
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet zabiegowych do angiografii, z serwetą główną z dwoma otworami o średnicy 10cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety? Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².
30. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści 3 częściowy zestaw pokrowców na ramię C składający się z:
 - 1) Górna część z elastyczną gumką 100 x 160cm,
 - 2) Dolna z elastyczną gumką 80 x 150cm,
 - 3) 2 taśmy przyklepne 3 x 100cm

31. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego wykonany z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², serwety w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z SWZ.
32. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw przeznaczony do artroskopii kolana, wykonany z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², serweta w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z SWZ.
33. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw serwet do zabiegu cięcia cesarskiego z serwetą główną samoprzylepną o wymiarach 180cm/240cm x 215cm z otworem trapezowym o podstawach 22,5 cm i 32 cm i wysokości 22,5 cm, wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów (z usztywnionym brzegiem, wyposażony w zawór do podłączenia drenu). Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z SWZ.
34. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw serwet uniwersalnych z serwetą dolną o wymiarach 180 x 180 cm (zamiast 180 x 175 cm), oraz z serwetami bocznymi 75 x 90 cm z taśmą samoprzylepną o długości 85 cm na dłuższym boku? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z SWZ.
35. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie sterylne do zabiegów ginekologicznych kroczykowych, wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², o składzie:
- 1 x serweta 160/240cmx180cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cmx15cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35x50cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.




160/240x180cm
1szt./pc.




150x190cm
1szt./pc.

36. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
37. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw obłożenia o składzie:
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.



200x260cm
1szt./pc.



160x180cm
1szt./pc.



30x30cm
4szt./pc.




80x140cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

38. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę w kształcie beretu, o rozmiarze w stanie rozciągniętym 85 x 85 cm, maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 50 x 50 cm. Osłona zakończona elastyczną gumką do stabilizacji.
39. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na aparaturę w kształcie beretu, o rozmiarze w stanie rozciągniętym 105 x 105 cm, maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 60 x 60 cm. Osłona zakończona elastyczną gumką do stabilizacji.
40. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 20.** Czy Zamawiający dopuści osłonę przezroczystą, w kształcie walca, w rozmiarze 70 x 80 cm. Osłona zakończona elastyczną gumką do stabilizacji.
41. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 20.** Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na aparaturę w kształcie beretu, o rozmiarze w stanie rozciągniętym 120 x 120 cm, maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 70 x 70 cm. Osłona zakończona elastyczną gumką do stabilizacji.
42. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 23.** Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm. Zakładka do aseptycznej aplikacji 25cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².



114x150cm

43. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-2.** Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy tylko w rozmiarze L i XL?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający oczekuje fartucha podfoliowanego na całej powierzchni?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym poliestrowym mankietem?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy tylko w rozmiarze L i XL?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zgodność z normą EN 14126 oznaczona była na pojedynczym opakowaniu.
52. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1-2.** Czy Zamawiający ma na myśli osłony na kończynę sterylne?
53. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm?
54. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x60cm?
55. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy EN 14126 dla oferowanych osłon na buty.
56. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści pokrowce na zwłoki wykonane z nieprzezroczystej folii polietylenowej, zawierające dwie podwójne zakładki. Każdy worek wyposażony jest w cztery wypalane uchwyty do przenoszenia oraz dwie pary rękawic foliowych zapinany na zamek zgodnie z poniższym zdjęciem:



57. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy Zamawiający poszewkę na poduszkę w rozmiarze 60x80cm?
58. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3.** Czy Zamawiający podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
59. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1-2.** Czy Zamawiający podanie ceny za opakowanie handlowe z przeliczeniem zamawianej ilości?
60. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 3.** Czy Zamawiający podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
61. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 3.** Czy Zamawiający podkład o chłonności 1177ml?
62. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 4.** Czy Zamawiający podkład o długości 40m z przeliczeniem zamawianej ilości?
63. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną w rozmiarze uniwersalnym, o długości 120cm i obwodzie 140cm?
64. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
65. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający zaakceptuje fartuch w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry bez zmian.
66. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający zaakceptuje fartuch w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry bez zmian.
67. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści zaoferowanie półmasek FFP2 pakowanych w op. zbiorcze kartonowe - w każdym op. 5 woreczków foliowych, w każdym 10 maseczek. Na każdej maseczce nadrukowany jest numer partii, norma, nazwa producenta, numer jednostki notyfikowanej ? Reszta wymagań zgodna z SWZ.
68. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy zamawiający akceptuje oznaczenie wymaganej normy PN-EN 14683, wyłącznie na opakowaniu zbiorczym (50 szt.)?
69. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści fartuch spełniający normę EN 13795 zamiast EN 14126?

70. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy zamawiający akceptuje oznaczenie normy EN 14126 wyłącznie na opakowaniu zbiorczym (5 par)?
71. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy zamawiający akceptuje poszwę o rozmiarze 210x150cm?
72. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy zamawiający akceptuje poszwę bez zapięcia na zakładkę?
73. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy zamawiający akceptuje poszewkę o rozmiarze 80x75cm?
74. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy zamawiający akceptuje poszewkę bez zapięcia na zakładkę?
75. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1-3.** Czy zamawiający akceptuje pakowanie poszwy, poszewki i prześcieradła razem, jako komplet?
76. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1.** Czy zamawiający akceptuje koszule pacjenta z włókniny SMMS o gramaturze 35g/m², z krótkim rękawem, wiązaną na troki przy szyi i talii, uniwersalnego rozmiaru z przecięciem z tyłu, zakładanym z przodu?
77. **Dotyczy pkt. 22.18 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Wnosimy o modyfikację Rozdziału 22 pkt 22.18. SWZ poprzez obniżenie kary umownej nim przewidzianej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
78. **Dotyczy pkt. 22.35 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Wnosimy o modyfikację Rozdziału 22 pkt 22.35. SWZ poprzez dodanie do niego lit. m) o treści: „*zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.*”
79. **Dotyczy pkt. 22.37 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Wnosimy o modyfikację Rozdziału 22 pkt 22.37. SWZ poprzez nadanie mu następującej treści: „*Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem przypadków określonych w SWZ.*”
80. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
81. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
82. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
83. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?
84. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny; o wymiarach:
o Mankiet 5 cm
o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm.
85. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
86. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1-3.** Czy zamawiający dopuści wycenę za komplet pościeli składający się z poz. 1-3? Prosimy o podanie ilości kompletów pościeli w przypadku dopuszczenia.
87. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 4-5.** Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu.
88. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
89. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
90. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
91. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2.** Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
92. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów w rozmiarze oznaczonym literowo M-L zamiast L? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
93. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do angiografii o następującym składzie i parametrach:
1 ręcznik 30 cm x 40 cm
1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serweta do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x 12 cm otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm, ze zintegrowanymi pasami z przezroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego. Serweta wykonana z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną, cały zestaw zapakowany w serwetę 80cm x 100 cm stanowiącą owinięcie zestawu, z serwetą nieprzemakalną 100x150cm pakowaną oddzielnie?

94. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 6cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

95. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona w strefie krytycznej samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna, wzmocniona w strefie krytycznej, samoprzylepna 225 cm x

280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,4 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,0 g/m².

96. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do artroskopii o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,4 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,0 g/m²?

97. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych o następującym składzie i parametrach

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze laminatu 57,4 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura

laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,0 g/m².

98. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej przeźroczystej osłony do aparatu o średnicy 90cm w stanie rozciągniętym ?
99. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 23.** Czy Zamawiający wymaga aby worek na płyny w kształcie stożka posiadał sztywnik, co umożliwi jego swobodne modelowanie.
100. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poszwy w rozmiarze 200x140
101. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła w kolorze niebieskim.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMMS, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawów sterylnych obłożeń uniwersalnych różniący się od wymagań określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ jedynie rozmiarem dwóch serwet: serweta dolna 180 x 180 cm zamiast 180 x 175 cm, 2 serwety boczne 75 x 100 cm zamiast 75 x 90 cm; pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** zestawów sterylnych serwet zabiegowych do angiografii różniący się od wymagań określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ jedynie rozmiarem otworów udowych – otwory udowe o średnicy 8,5 cm, zamiast 7x10 cm; pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** sterylnej serwety z otworem 6x8 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** sterylnej serwety z otworem o średnicy 5 cm.

Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** sterylnej serwety z taśmą lepłą.

Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 12** sterylnych zestawów do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego opisanych w pytaniu.

Ad 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** sterylnych zestawów serwet przeznaczonych do artroskopii kolana opisanych w pytaniu.

Ad 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 14** sterylnych zestawów serwet do cięcia cesarskiego opisanych w pytaniu.

Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 14** sterylnych zestawów serwet do cięcia cesarskiego opisanych w pytaniu.

Ad 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 15** sterylnych zestawów serwet uniwersalnych różniący się od wymagań określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ jedynie rozmiarem serwety dolnej 180 x 180 cm zamiast 180 x 175 cm; pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** zestawów obłożeń sterylnych do zabiegów ginekologicznych kroczykowych opisanych w pytaniu.

Ad 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** zestawów obłożeń sterylnych do zabiegów ginekologicznych kroczykowych opisanych w pytaniu.

Ad 14, 43, 80 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** masek chirurgicznych w opakowaniach po 50 szt., pod warunkiem, że maski będą spełniały wymagania SWZ. Jeżeli wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 50 szt. to winien zaoferować 4000 opakowań.

Ad 15, 44, 81 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1-2** czepków chirurgicznych w opakowaniach po 100 szt., pod warunkiem, że czepki będą spełniały wymagania SWZ. Jeżeli wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien zaoferować w poz. 1 - 220 opakowań, a w poz. 2 - 90 opakowań.

Ad 16, 65, 84 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** fartuchów włókninowych w rozmiarze uniwersalnym.

Ad 17, 49, 85 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** fartuchów foliowych w opakowaniach po 100 szt., pod warunkiem, że fartuchy będą spełniały wymagania SWZ. Jeżeli wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien zaoferować 90 opakowań.

Ad 18, 69 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 1**.

Ad 19, 66 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** fartuchów barierowych w rozmiarze uniwersalnym.

Ad 20-21 Zamawiający wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** ubrania operacyjne spełniały wymagania określone w SWZ.

Ad 22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 2** podkładów w rozmiarze 140-160x 80 cm.

Ad 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 5** prześcieradła papierowego w roli o długości 50 m z przeliczeniem ilości, pod warunkiem, że prześcieradła te będą spełniały wymagania SWZ. W przypadku zaoferowania prześcieradeł w roli o długości 50 m należy zaoferować 2400 rolek.

Ad 24 Zamawiający wymaga jakiego musi spełniać przedmiot zamówienia oferowany w **Pakiecie Nr 13 poz. 2** określił w SWZ.

Ad 25 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** koszul dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym.

Ad 26, 45 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** fartuchów tylko w rozmiarze L i XL.

Ad 27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** koszul dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym i podtrzymuje wymagania określone w SWZ, w tym również dla rozmiaru oferowanych koszul.

Ad 28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawów sterylnych obłożeń uniwersalnych różniący się od wymagań określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ jedynie rozmiarem serwety dolnej 180 x 180 cm zamiast 180 x 175 cm; pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 29 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 5**, z uwzględnieniem dopuszczeń w związku z udzielonymi odpowiedziami.

Ad 30 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 11** zestawu pokrowców na ramię C opisanego w pytaniu

Ad 31 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 12**.

Ad 32 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 13**.

Ad 33 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 14** sterylnych zestawów serwet do cięcia cesarskiego opisanych w pytaniu.

Ad 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 15** sterylnych zestawów serwet uniwersalnych różniący się od wymagań określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ jedynie rozmiarem serwety dolnej 180 x 180 cm zamiast 180 x 175 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 35 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** zestawów obłożeń sterylnych do zabiegów ginekologicznych opisanych w pytaniu.

Ad 36 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 17** do osobnego pakietu.

Ad 37 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 17** sterylnych zestawów obłożeń opisanych w pytaniu.

Ad 38 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 18** osłony na aparaturę opisaną w pytaniu.

Ad 39 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 18** osłony na aparaturę w kształcie beretu, o rozmiarze w stanie rozciągniętym 105 x 105 cm, maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 60 x 60 cm, pod warunkiem, że można ją założyć na aparaturę o rozmiarze: szerokość 42 cm, długość 52 cm,

wysokość 15 cm, jest z gumką ściągającą, która umożliwi założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na niej gdy po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury, a ponadto spełniania pozostałe wymagania SWZ.

Ad 40 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 20** osłony na aparaturę w kształcie walca o rozmiarze 70 x 80 cm, zakończonej elastyczną gumką do stabilizacji, pod warunkiem, że można ją założyć na szybę o rozmiarze: szerokość 60 cm, wysokość 76 cm, jest z gumką ściągającą, która umożliwi założenie osłony na szybę, a równocześnie utrzymanie osłony na niej gdy po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części szyby, a ponadto spełniania pozostałe wymagania SWZ.

Ad 41 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 20** osłony na aparaturę opisanej w pytaniu.

Ad 42 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 23** sterylnej serwety porodowej opisanej w pytaniu.

Ad 46, 82 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** fartuchów z włókniny w opakowaniach po 10 szt., pod warunkiem, że fartuchy będą spełniały wymagania SWZ. Jeżeli wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 10 szt. to winien zaoferować 2500 opakowań.

Ad 47 Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** fartuchów z włókniny spełniających wymagania SWZ.

Ad 48 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** fartuchów z włókniny z rękawem zakończonym poliestrowym mankietem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 50 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** fartuchów tylko w rozmiarze L i XL.

Ad 51 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** fartuchów spełniających normę EN 14126; przy czym Zamawiający dopuszcza aby oznaczenie normy znajdowało się na zbiorczym opakowaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 52 Zamawiający wymaga dla osłon na kończynę oferowanych w **Pakiecie Nr 7 poz. 1 i 2** określił w SWZ, i nie miał na myśli osłon sterylnych ponieważ nie określił takiego wymagania.

Ad 53 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** osłon na kończynę w rozmiarze 35 x 120 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 54 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** osłon na kończynę w rozmiarze 30x60 cm.

Ad 55 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 8 poz. 2**.

Ad 56 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** pokrowców opisanych w pytaniu i przedstawionych na zdjęciu, pod warunkiem, że szczelnie zabezpieczają zwłoki.

Ad 57 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 2** poszewek na poduszkę w rozmiarze 60x80 cm.

Ad 58 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 3** prześcieradeł w opakowaniach po 10 szt., pod warunkiem, że prześcieradła te będą spełniały wymagania SWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 10 szt. to winien zaoferować 1700 opakowań.

Ad 59 Zamawiający nie wyraża zgody na podanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 1 i 2** ceny za opakowanie handlowe przedmiotu zamówienia, ponieważ Wykonawca nie podał wielkości tego opakowania.

Ad 60 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 3** podkładów w opakowaniach po 25 szt., pod warunkiem, że podkłady te będą spełniały wymagania SWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 25 szt. to winien zaoferować 40 opakowań.

Ad 61 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 3** podkładów o chłonności 1177 ml.

Ad 62 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 4** prześcieradła papierowo-foliowego w roli o długości 40 m, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ. W przypadku zaoferowania prześcieradeł w roli o długości 40 m należy zaoferować 188 rolek.

Ad 63 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** koszul dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym i podtrzymuje wymagania określone w SWZ, w tym również dla rozmiaru oferowanych koszul.

Ad 64 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** myjek-rękawic w opakowaniach po 50 szt., pod warunkiem, że będą spełniały wymagania SWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 50 szt. to winien zaoferować 200 opakowań.

Ad 67 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 1**.

Ad 68 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** masek chirurgicznych, które oznaczenie normy PN-EN 14683 mają na opakowaniu zbiorczym (50 szt.), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 70 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** osłon na buty długie, które oznaczenie normy EN 14126 mają na opakowaniu zbiorczym (5 par), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 71-72 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla poszew oferowanych w **Pakiecie Nr 11 poz. 1**.

Ad 73-74 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla poszewek oferowanych w **Pakiecie Nr 11 poz. 2**

Ad 75, 86 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie razem jako komplet: poszew, poszewek i prześcieradeł ujętych w **Pakiecie Nr 11 poz. 1-3**.

Ad 76 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** koszul dla pacjenta opisanych w pytaniu.

Ad 77-79. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów **pkt 22 SWZ**.

Ad 83 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** fartuchów z włókniny z rękawem zakończonym elastycznym bawełnianym mankietem, pod warunkiem, spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 87 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 12 poz. 4-5** do osobnego pakietu.

Ad 88 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 2** podkładu opisanego w pytaniu.

Ad 89 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 2** podkładu opisanego w pytaniu.

Ad 90 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 2** podkładu opisanego w pytaniu

Ad 91 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 12 poz. 2**.

Ad 92 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów w rozmiarze M-L zamiast L, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym zaoferowania rozmiaru XL i XXL.

Ad 93 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** zestawu do angiografii opisanego w pytaniu.

Ad 94 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** sterylnej serwety z otworem o średnicy 6 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 95 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 12** sterylnego obłożenia do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego opisanego w pytaniu.

Ad 96 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** sterylnego zestawu do artroskopii opisanego w pytaniu.

Ad 97 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych opisanego w pytaniu.

Ad 98 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 18** osłony na aparaturę o średnicy 90 cm w stanie rozciągniętym, pod warunkiem, że można ją założyć na aparaturę o rozmiarze: szerokość 42 cm, długość 52 cm, wysokość 15 cm, jest z gumką ściągającą, która umożliwi założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na niej gdy po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury, a ponadto spełniania pozostałe wymagania SWZ.

Ad 99 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 23** serwety pod pośladki z workiem spełniającej wymagania SWZ.

Ad 100 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** poszew w rozmiarze 200x140 cm..

Ad 101 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 3** prześcieradeł w kolorze niebieskim pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek