



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl
email: sekretariat@zzozwadowice.pl
Klauzule RODO: <https://zzozwadowice.pl/rodo>

Wadowice, dnia 27.04.2022r.

Znak: ZP.26.1.17.2022.1

Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji SWZ na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 137 ust 1 modyfikuję treść SWZ:

Pytanie nr 1 Pakiet 1, poz. 2,3,5,6 – Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 Pakiet 1, poz. 3,6 - Czy zamawiający dopuści aby długość drenu w aparatach do przetaczania krwi (pozycja 3) oraz przetaczania płynów (pozycja 6) wynosiła 150 cm zamiast 180 cm? Pozostała część opisu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 Pakiet 1 poz. 2,3,5 Czy zamawiający dopuści komorę kroplową wykonaną z bezpiecznego medycznego PVC? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. Wymagany opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia niż obecnie na rynku proponowany przyrząd posiada dren z medycznego PVC i tutaj powstała sprzeczność o wymóg komory wolnej od PVC , gdzie w całości przyrząd nie jest wolny od PVC.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 Pakiet 1 poz. 6 Czy zamawiający dopuści komorę kroplową wykonaną z bezpiecznego medycznego PVC? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. Wymagany opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia niż obecnie na rynku proponowany przyrząd posiada dren z medycznego PVC i tutaj powstała sprzeczność o wymóg komory wolnej od PVC , gdzie w całości przyrząd nie jest wolny od PVC.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 Pakiet 1 poz. 2,3,5 Czy zamawiający dopuszcza komorę wykonaną z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 Pakiet 1 poz. 2 Czy zamawiający dopuszcza dren o długości 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 Pakiet 1 poz. 6 Czy zamawiający dopuszcza dren o długości 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 Pakiet 1 poz. 6 Czy zamawiający dopuszcza równoważny asortyment dodatkowo wyposażony specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta. Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 pakiet 1, poz. 2,4,5 Czy zamawiający wydzieli poz.2,4,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 pakiet 1, poz. 2,5 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza powyższe rozwiązanie**, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 pakiet 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczeput na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 Pakiet 2: Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley w rozm.8 i 10ch z balonem 3-5ml, spełniających pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 Pakiet 2: Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley w rozm.12-22ch z balonem 5-10ml oraz w rozm.14-24ch z balonem 30-50ml.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 Pakiet 2: Poz.2 i 3: Prosimy o wyjaśnienie czy cewniki foley mają być wyposażone w sztywną zastawkę?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** i modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 15 Pakiet 2: Poz.2 i 3: Prosimy o sprecyzowanie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką mają być nadrukowane informacje dot.: marki cewnika, materiału wykonania, rozmiaru (ch), średnicy zewnętrznej (mm) i pojemności balonu, co pozwala na identyfikację cewnika bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 16 Pakiet 2: Poz.8: Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do irygacji ma być wyposażony w worek wykonany ze wzmocnionej folii, z uchwytem do zawieszenia oraz dren zakończony plastyczną kanką z otworem centralnym?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 17 Pakiet 2, poz. 1 - Czy zamawiający dopuszcza cewniki Foley'a CH6 z balonem o pojemności 3ml oraz CH8-CH10 z balonem o pojemności 3-5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 Pakiet 2, pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści Cewnik Foley'a CH 12-24 z balonem o pojemności 5-10 ml oraz CH 16-24 z balonem o pojemności 30ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 Pakiet 2, poz. 3 - Czy zamawiający dopuści Cewnik Foley'a CH 16 z balonem o pojemności 30ml?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 Pakiet 2, poz. 8 - Czy zamawiający dopuści zestaw do irygacji z workiem o pojemności 1500 ml lub zestaw sterylny z workiem 1750 ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** zestaw sterylny z workiem 1750 ml, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 Pakiet 3: Dotyczy pkt XIV oraz XVII swz: W związku z kryterium oceny jakościowej w zakresie pakietu 3 i zapisem „*Ocenie jakościowej podlegać będzie pozycja nr 5*” prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i wraz z ofertą ma być dostarczona próbka wyrobu zaoferowanego w zakresie pozycji nr 5 pakietu 3, a nie próbka w zakresie pozycji nr 10 (zgodnie z pkt.XIV.1 swz).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 22 Pakiet 3: Poz.2-4: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania górnych dróg oddechowych z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku oraz z fabrycznie nadrukowanym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu (tak jak w poz.5-8), spełniających pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 Pakiet 3: Poz.2-8: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich

symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 24 Pakiet 3: Poz.2-8: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy łącznik w cewniku do odsysania górnych dróg oddechowych ma posiadać wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 25 Pakiet 3: Poz.9: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów Kehra, tak jak obecnie stosowane, w rozm.9-24ch, spełniających pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 Pakiet 3: Poz.10: Prosimy o sprecyzowanie czy opisane „cztery otworki boczne” mają się cechować zaoblonymi krawędziami oraz średnicą nie większą niż 5mm?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 27 Pakiet 3: Poz.10: Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki Pezzera mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 28 Pakiet 3: Poz.11: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika do podawania tlenu przez nos z anatomiczną prostą końcówką do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 29 Pakiet 3: Poz.16: Prosimy o sprecyzowanie czy zdejmowalna osłonka w końcówce Pool ma posiadać 44 zagłębione otwory dla lepszej ochrony tkanek?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 30 Pakiet 3: Poz.18: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do odsysania OP-Flex Yankauer w opakowaniu zbiorczym po 10szt, spełniającego pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 31 Pakiet 3 poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści cewnik Kehra o długości ramion 450x180mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 32 Pakiet 3, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzera wyposażony w trzy otwory boczne, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 33 Pakiet 3, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 34 Pakiet 3, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 300cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 35 Pakiet 3, poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści dren Redona bez zmiennej średnicy otworów o długości 700mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 36 Pakiet 3, poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści dren Redona bez zmiennej średnicy otworów o długości 1700mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 37 Pakiet 3, poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści dren Redona o takiej samej średnicy otworów o długości 800mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 38 Pakiet 3, poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania typu Pool wykonaną w całości z materiału radiocieniującego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 39 Pakiet 3, poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 40 Pakiet 3, poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 41 Pakiet nr 4 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o średnicy 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 42 Pakiet nr 4 poz. 2,3 Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje elektrod do Holtera z podłużnym otworem służącym do przełożenia i zamocowania przewodu kabla EKG, bez przecięcia boków elektrody.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 43 Pakiet nr 4 poz. 5 Prosimy o podanie czułości wymaganego papieru: S czy HD?

Odpowiedź: S.

Pytanie nr 44 Pakiet nr 4 poz. 14 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Responder 2000 termicznego, kratkowanego o rozmiarze 60 mm x 25 m.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 45 Pakiet nr 4 poz. 19 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu EKG BIT-o8LT ECG termicznego o rozmiarze 210 mm x 25 m.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 46 Dotyczy SIWZ XIV pkt 13.4 (próbki dla pakietu nr 4) Czy w pozycji 3 pakietu nr 4 Zamawiający oczekuje 1 sztuki elektrody czy też 1 opakowania elektrod (jednostką miary w tej pozycji jest opakowanie).

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 1 opakowania elektrod, jednocześnie modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 47 pakiet 5, poz. 18 czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml do pomp typu ASCOR? Czy zamawiający wydzieli poz.18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 48 Pakiet 7 poz. 1 Czy zamawiający dopuszcza kaniule w rozmiarze wyposażonej w filtr hydrofobowy pełniący rolę zastawki atyzwrotnej wykonanej z PUR z wymaganych rozmiarach oraz 14 G w rozmiarze

Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm
14 G	2,1 x 45

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 49 Pakiet 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli dożylny wykonanej z biokompatybilnego PTFE Posiadająca dotykowy, samodomykający się port do wstrzyknięć minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadająca filtr hydrofobowy zapobiegający wpływowi krwi (rozwiązanie zgodne z normą ISO 10555-5) , wyposażona w mechanizm zabezpieczający kaniulę, zabezpieczenie igły z systemem chroniącym personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem (zadrażnieniem), zachlapaniem

krwią (plastikowa osłonka o gładkich krawędziach) . Rozmiar 22G-09, 20G-1,10, 18G-1,3; 17G-1,5; 16G-1,7; 14G-2,1.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 49A dot. pakietu nr 7, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula posiadała system chroniący personel medyczny przed zachlapaniem krwią w postaci kapilar? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 50 Pakiet nr 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o poniższych parametrach : Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające szczelnie całe światło igły, nie pozostawiające żadnych szczelin w celu ochrony przed zachlapaniem krwią. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, dwa paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm/32mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 51 Pakiet 8 poz. 1 Czy zamawiający dopuszcza kaniule bez dodatkowego otworu przy ostrzu. Pozostałe zapisy zgodnie SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 52 Pakiet 8 Prosimy Zamawiającego o o dopuszczenie kaniuli dożylniej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiający kaniulację naczyń. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w w USG bez pasków radiocieniujących .Wykonana z biokompatybilnego PTFE .bez Dodatkowego otwór przy ostrzu igły umożliwiającego natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Rozmiar 24G-0,7; 26G-0,6

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 53 Pakiet 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Bez dodatkowego portu górnego. Z zabezpieczeniem w pełni izolującym igłę po zakończonej kaniulacji. Cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu widoczny w RTG. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Rozmiar 24G-0,7; 26G-0,6

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 54 Pakiet 8, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę zgodnie z poniższymi parametrami:

igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG
kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka mocujące, bez portu górnego
uchwyt umożliwiający wykonanie wklucia jedną ręką
zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
dostępna w dwóch rozmiarach: 24 G i 26 G
jednorazowego użytku
nie zawiera lateksu
nie zawiera ftalanów
sterylizowana tlenkiem etylenu
pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym
zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 55 Pakiet 9: Poz.3:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o poniższym składzie:

- 1x serweta 75x90cm z bilaminatu
- 1x serweta chłonna 75 x 90 cm, z przyklepionym otworem Ø6cm z bilaminatu, niebieska
- 1x strzykawka 20 ml
- 1x ampulka z wodą destylowaną 20 ml
- 1x żel poślizgowy 5 g
- 1x kleszczyki plastikowe typu Kocher
- 5x kompres z włókniny 7,5x7,5 cm

Opakowanie jednostkowe sztywny blister zaopatrzona w dwie etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności kod kreskowy. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze 40 szt.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 56 Pakiet 10, poz. 9 Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczenia linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakkolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 57 Pakiet 10, poz. 23-25 - Czy zamawiający dopuszcza, aby zgłębniki dwunastnicze miały długość 1250 mm? Pozostały opis zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 58 Pakiet 10, poz. 26 - Czy zamawiający dopuszcza, aby długość zgłębników wynosiła 1050 mm zamiast 1000 mm oraz 3 znaczniki kontrastujące?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 59 Pakiet 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz ze standardowym obwodem mankietu 22-32 lub dodatkowy mankiety dla otyłych 32-42, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 60 Pakiet nr 11 Czy Zamawiający dopuści przetworniki o długości linii pomiarowej 120+30cm oraz długości linii pływającej 150cm z połączeniem z kablem bezpinowym, wodoszczelnym? Zakrzywiona igła w zbiorniku wyrównawczym w żaden sposób nie zabezpiecza systemu przed zapowietrzeniem, ponieważ znajduje się powyżej lustra płynu w zbiorniku wyrównawczym. Takie rozwiązanie nie daje żadnych korzyści dla Zamawiającego, a jest jedynie ograniczeniem uczciwej konkurencji, dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu ze zbiornikiem wyrównawczym z tradycyjnym systemem kropłowym. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.


Pytanie nr 61 Pakiet nr 11 Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available



Odpowiedź: Końcówka BD.

Pytanie nr 62 Pakiet nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:

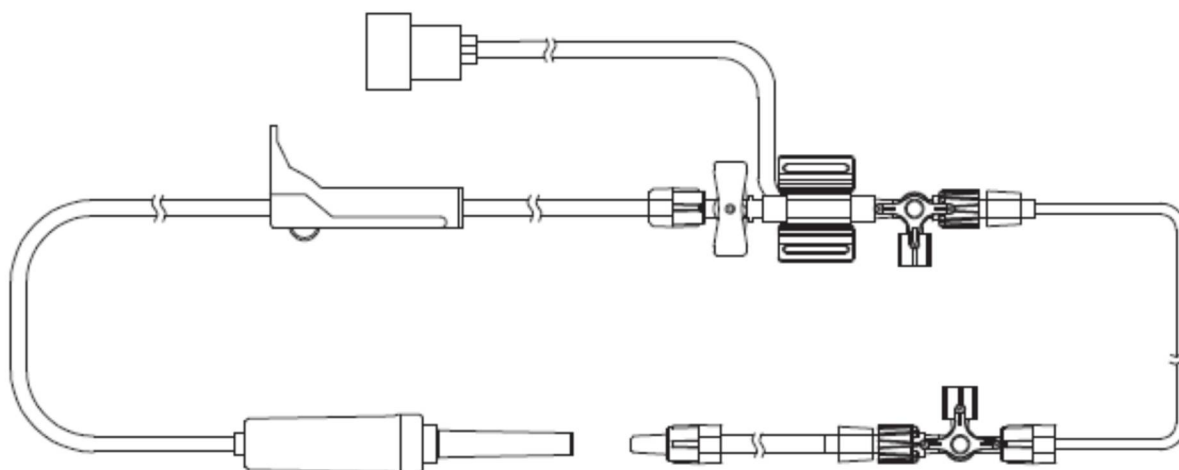

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 63 Pakiet nr 12 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści dren do ssaków w rozmiarze CH24 lub CH30?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 64 Pakiet nr 12 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści dren do ssaków o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 65 Pakiet nr 12 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści dren do ssaków w rozmiarze CH24 lub CH30?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 66 Pakiet nr 12 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści dren do ssaków o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 67 Pakiet nr 12 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rozmiar drenu CH30 i długość 300cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 68 Pakiet nr 12 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści rozmiar kaniuli CH21?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 69 Pakiet nr 12 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści rozmiar kaniuli CH21?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 70 Pakiet nr 12 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści rozmiar kaniuli CH18?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 71 Pakiet nr 12 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści rozmiar kaniuli CH 21-32?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 72 Pakiet nr 12 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści rozmiar drenu CH30?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 73 Pakiet nr 12. poz.7,8. Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny, gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz szeroki port do wsypywania proszku żelującego lub pobierania próbek. Ochrona przeciwbryzgowa przed wcześniejszym zamknięciem filtra (oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta) następuje dzięki wewnętrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. Wkłady oraz kanistry o pojemności 1000ml,2000ml. Kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową co 100ml (klasa I), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone w zaczep do zawieszenia

bez innych przyłączy typu ssanie. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnego systemu, produkowanego (wkłady, kanistry) zgodnie z opatentowaną, antybakteryjną technologią (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 74 Pakiet nr 12 poz.8. Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza powyższe rozwiązanie**, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 75 Pakiet nr 12 poz.3. Prosimy o dopuszczenie drenu fi 7mm/2,1m.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 76 Pakiet nr 12 poz.4. Czy Zamawiający dopuści dren (śred.wew.) fi 7mm/350cm z końcówkami żeńskimi, uniwersalnymi?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 77 Pakiet nr 12 poz.9. Proszę o wyjaśnienie zapisu "...rozmiar kaniuli CH 22-32". Jakie konkretnie rozmiary zamawiający będzie zamawiał?

Odpowiedź: Zamawiający będzie zamawiał kaniule w rozmiarach od CH 22 do CH 32.

Pytanie nr 78 Pakiet nr 13 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści objętość oddechową 150ml – 1500ml?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 79 Pakiet nr 13 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracyjną bakterii 99,999?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 80 Pakiet nr 13 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wagę do 22g?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 81 Pakiet nr 13 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści objętość oddechową 150ml – 1500ml?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 82 Dotyczy Pakiet nr 13 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml i przestrzeni martwej 53 ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 83 Dotyczy Pakiet nr 13 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml i przestrzeni martwej 33 ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 84 Pakiet 13 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny sterylny filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o objętości oddechowej 150-1500ml, przestrzeni martwej 55ml, masie 35,6g, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 85 Pakiet 13 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny sterylny filtr oddechowy o objętości oddechowej 150-1500ml, przestrzeni martwej 33ml, masie 21g, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 86 dot. pakietu 14 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści tacę na leki o wymiarach 400 x 320 x 60 mm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 87 Pakiet 15, poz. 1-8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie i wycenę etykiet na pojemniki z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości pojemników?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 88 Pakiet 15, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza, pojemnik do badań o pojemności 35 ml o wymiarach 35x61mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 89 Pakiet 15, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań o poj. 70ml o wymiarach 50x60mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 90 Pakiet 15, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań o pojemności 1100ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 91 Pakiet 15, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań o pojemności 150ml?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 92 Pakiet 15, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań o pojemności 5000ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 93 Pakiet 15, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań o pojemności 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 94 Pakiet nr 16 poz. 1, 2, 3 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na podanie ceny za opakowanie a' 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 95 Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 16, poz. 1, 2 i 3 zaoferowanie bezpiecznych nakłuwaczy igłowych o parametrach 21Gx1,8mm? Nakłuwacze o takim parametrze pozwolą na uzyskanie wystarczającej kropli krwi potrzebnej do badań.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 96 Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 16 w poz 1 - 3 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt.

Pytanie nr 97 Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 16 w poz 1 nakłuwacze igłowe o głębokości nakłucia 1,8 mm lub 2,4 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 98 Pakiet 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr. 16 poz 3 co umożliwiłoby złożenie korzystniejszej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 99 Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 16 w poz 3 nakłuwacz igłowy o głębokości nakłucia 1,2mm ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 100 Pakiet 17 Czy Zamawiający zgodzi się na zwrot próbki po zakończeniu postępowania lub zaliczenie jej na poczet wykonanych dostaw w przypadku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawca po zakończonym postępowaniu winien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o zwrot próbki.

Pytanie nr 101 Pakiet nr 18 Poz.1-4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie załadowanych odpowiednio staplerów oraz ładunków w rozmiarach 80mm i 100mm, nóż zintegrowany z ładunkiem, dwa rzędy zszywek ułożone naprzemiennie, możliwość odpalenia staplera z obu stron, nóż po odpaleniu staplera chowany w plastikową pochewkę, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,85mm, po zamknięciu 1,5mm oraz przed zamknięciem 4,5mm po zamknięciu 2,0mm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 102 Pakiet nr 18 Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych w rozmiarach 21, 26, 29, 32, 34mm. Z regulacją kompresji tkanki w zakresie 1,0-2,5mm, blokadą bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 103 Pakiet nr 18 Poz. 6-7 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych bez noża oraz ładunków, automatycznych, z dwoma dźwigniami (zamykającą i spustową), wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm; oraz przed zamknięciem 4,5mm po zamknięciu 2,0mm .

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 104 Pakiet 18 Poz. 1 Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, z dwoma podwójnymi

rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, stapler posiadający ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera bez łańcucha i pinu pozycjonującego tkanki, równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierna kompresja tkanki, informacja o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, długość 80 cm, ilość zszywek 84, wysokość zszywek 3,8?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 105 Pakiet 18 Poz. 2 Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, stapler posiadający ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera bez łańcucha i pinu pozycjonującego tkanki, równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierna kompresja tkanki, informacja o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, długość 100 cm, ilość zszywek 104, wysokość zszywek 3,8?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 106 Pakiet 18 Poz. 3 Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, stapler posiadający ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera bez łańcucha i pinu pozycjonującego tkanki, równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierna kompresja tkanki, informacja o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, długość 100 cm, ilość zszywek 104, wysokość zszywek 4,8?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 107 Pakiet 18 Poz. 4 Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści ładunki kompatybilne ze staplerami opisanymi w pytaniach do poz. 1, 2, 3?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 108 Pakiet 18 Poz. 5 Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,4 mm do 2,6 mm. Rozmiary staplera: 21, 24, 26, 29 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 21 i 24 – 4,5mm, dla rozmiaru 26 i 26 – 4,8mm oraz dla rozmiaru 32 – 5,0mm. Kowadełko zaopatrzone w otwory do przeprowadzenia szwu prowadzącego. Posiada zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa. Bez systemu obrotowego ostrza. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową powłoką. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 109 Pakiet 18 Poz. 6 Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, załadowany ładunkiem posiadającym 21 zszywek ułożonych w 2 rzędach. Zszywki wykonane z tytanu, o żądanych przez Zamawiającego wysokościach zszywek. Stapler wyposażony w

jedną dźwignię zamykająco-spustową kontrolującą wystrzał i przycisk otwierający stapler, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczany manualnie lub automatycznie?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 110 Pakiet 18 Poz. 7 Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, załadowany ładunkiem posiadającym 33 zszywek ułożonych w 2 rzędach. Zszywki wykonane z tytanu, o żądanych przez Zamawiającego wysokościach zszywek. Stapler wyposażony w jedną dźwignię zamykająco-spustową kontrolującą wystrzał i przycisk otwierający stapler, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczany manualnie lub automatycznie możliwość 7-krotnego przeładowania i 8-krotnego wystrzału staplera?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 111 Pakiet 18 Poz. 8 Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści ładunki kompatybilne ze staplerami opisanymi w pytaniach do poz. 6, 7?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 112 Pakiet nr 22 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków laparoskopowych z samorozprężalną obręczą przytwierdzoną na stałe do popychacza. Worki odpowiednio o pojemności 200ml, 400ml, 800ml, średnica prowadnicy 10mm, uchwyt oczkowy/nożycowy na dwa palce.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 113 Pakiet 22, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie woreczka 1x laparoskopowego do usuwania zresekowanych narządów, wykonanego z poliuretanu z samorozprężalną obręczą, przytwierdzoną na stałe do popychacza o pojemności od 100 ml - 200ml, o wymiarach 85mm x 158mm, składający się z prowadnicy o śr.10mm i długości ok. 40cm, z uchwytem nożycowym na dwa palce?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 114 pakiet nr 24 POZ. NR 3 Czy zamawiający ma na myśli 10 szt opakowań (op.=a20szt) ?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 115 Czy Zamawiający w pakiecie nr 25 pozycji nr 2 wymaga zestawu PEG zawierającego zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, która umożliwi jego trwałe umocowanie i kieruje położenia zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (90 stopni), co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza powyższe rozwiązanie**, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 116 Pakiet 26, poz. 1 - Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka na wymiociny o pojemności 2000ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 117 pakiet 26, poz. 1 Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty? Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE

w kolorze mlecznym- z możliwością obserwacji zawartości, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. X 16,5 cm szer.?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 118 pakiet 26, poz. 2 czy zamawiający dopuści gąbeczkę nienasączaną?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 119 Pakiet 26: Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jednorazowego worka na wymioty w kolorze mleczno-białym, spełniającego pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 120 Czy Zamawiający w **Pakiecie 27 w pozycji 1** wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki z racji na fakt, że Zamawiający zna i stosuje zestaw opisany w tej pozycji, oraz z racji na relatywnie wysoką wartość próbki zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki z racji na fakt, że każdy Wykonawca może złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu, a dostarczenie próbki służyć ma ocenie jakościowej zaoferowanego asortymentu.

Pytanie nr 121 Czy Zamawiający w **Pakiecie 27 w pozycji 5** dopuści zestaw z cewnikiem o długości: 20,5 cm (dla rozmiaru 9CH) i o długości 25,5 cm (dla rozmiaru 12CH); zestaw spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 122 Pakiet 28, poz. 1-3 - Czy zamawiający dopuszcza, aby zaproponować okularki do fototerapii o zakresie długości 290-355 mm; 310-375 mm; 330-395 mm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 123 Pakiet nr 28 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści obwód głowy 26-30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 124 Pakiet nr 28 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści obwód głowy powyżej 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 125 Część 28 okulary do fototerapii dla noworodka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

- Okularki jednoczęściowe
- Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.
- Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);
- Bez dodatku lateksu i kleju.
- Hypoalergiczne.
- Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.

- Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka
- Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.
- Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.
- Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii;
- Bezbolesne zdejmowanie.
- Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤ 900 g, < 1000 g i > 1000 g) i wielkości główki noworodka.



Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 126 Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza powyższe rozwiązanie**, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 127 dot. pakietu 31 – Czy Zamawiający dopuści termometr o dokładności pomiaru $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ w zakresie od $35,5^{\circ}\text{C}$ do $42,0^{\circ}\text{C}$ oraz $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ w zakresie $34,0^{\circ}\text{C}$ do $35,4^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 128 pakiet 32, poz. 1 Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. czy zamawiający dopuści dren o dł. 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 129 Pakiet nr 32 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- zamykany port do podawania leków z końcówką LUER
- przezroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 130 Pakiet nr 32 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści w komplecie tylko 1 maskę?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 131 Pakiet nr 32 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści jedną maskę w zestawie, natomiast drugą dołączoną osobno?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga dwóch masek w zestawie.

Pytanie nr 132 Pakiet nr 32 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści oznaczenie kolorystyczna dla rozmiaru 4-czerowny?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 133 Pakiet nr 32 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz słownie na korpusie maski?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 134 Pakiet nr 32 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 135 Pakiet nr 32 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rury o długości 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 136 Pakiet nr 32 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie możliwości stosowania obwodów oddechowych do 7 dni w postaci oświadczenia?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 137 Pakiet nr 32 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści rury karbowane wewnątrznie?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 138 Pakiet nr 32 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie możliwości stosowania obwodów oddechowych do 7 dni w postaci oświadczenia?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 139 Pakiet nr 32 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści łyżkę metalową, natomiast jej podstawę, służącą do zamocowania w rękojeści, wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy asortymentu opisanego w pakiecie 32 poz. 5.

Pytanie nr 140 Pakiet nr 32 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści rękojeść magnetyczną?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 141 Pakiet nr 32 poz. 12, 13, 14 Czy Zamawiający wyłączy pozycje 12, 13, 14 z Pakietu nr 32 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 142 Pakiet 32 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maski twarzowe posiadający pierścień mocujący kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru (oznaczenie kolorystyczne 4-czerwony). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 143 Pakiet 32 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maski krtaniowe, jednorazowe, 100% silikon przezroczysta, anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie, dla dorosłych i dzieci z nadmuchiwanym mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi i drenem mankieta nie wtopionym w ścianę rurki oddechowej, wzmocniona końcówka mankieta zapobiega podwijaniu się podczas zakładania, mankiet z balonikiem kontrolnym z barwnym kodem rozmiarów, czytelne oznaczenie maski i informacja o ilości powietrza potrzebnego do napełnienia mankieta na tubusie, bez lateksu, bez ftalanów, rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 144 Pakiet 32 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system dla rurki tracheostomijnej o długości 365mm spełniającej pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 145 Pakiet 36, poz. 1 - Czy zamawiający dopuszcza, aby przy wycenie podać cenę za opakowanie a'800 sztuk z uwzględnieniem zamawianej ilości i przeliczeniu na opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 146 Pakiet nr 36 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opaskę bez otworów? Dzięki temu jest ona znacznie wytrzymalsza, a ryzyko rozerwania praktycznie zerowe.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 147 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu w pakiecie 37, poz. 4, 5 (dreny jednorazowe, filtry do ssaka), które nie są wyrobami medycznym (stawka VAT 23%)?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**.

Pytanie nr 148 Pakiet nr 38 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści 3 znaczniki głębokości w postaci półpierścieni?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 149 Pakiet nr 38 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści znaczniki głębokości w postaci 2 półpierścieni?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 150 Pakiet nr 38 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z jednym celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 151 Pakiet nr 38 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści informację o średnicy mankietu umieszczoną na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 152 Pakiet 38, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rurkę ze znacznikiem głębokości z dwoma ringami o grubości 2mm w odległości 2cm od siebie?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 153 Pakiet 38. Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną według poniższych parametrów:

- Wykonana z termoplastycznego PVC, zapewniającego dużą elastyczność rurki
- Znacznik RTG na całej długości rurki
- Wyposażona w boczny otwór Murphy'ego
- Skalowanie co 1 cm
- Znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki – 2 pierścienie
- Wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający
- Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)
- Nazwa producenta umieszczona na wyrobie
- Balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru
- Odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm
- Opakowanie typu „banan”, utrzymujące anatomiczny kształt rurki
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 154 Pakiet 38, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci zgodnie z poniższymi parametrami:

Wykonany z plastikowej obudowy, dwóch piankowych filtrów, zastawki bezpieczeństwa oraz króćca do podłączenia tlenu
 Piankowe filtry ogrzewają, nawilżają oraz filtrują wdychane przez pacjenta powietrze
 Zastawka bezpieczeństwa uwalnia nadmiar ciśnienia, np. podczas kaszlu pacjenta, umożliwia odkrztuszanie znacznych ilości wydzieliny
 Króciec umożliwia podłączenie drenu tlenowego

parametry filtra:

objętość oddechowa (V_T): min. 250 ml
 przestrzeń martwa: 16 ml
 utrata wilgotności: 9,7 mg/l
 waga: 4,5 g
 długość: 33 mm

opór przepływu:

wartość przepływu	faza wdechu	faza wydechu
0,5 l / s	0,30 hPa	0,34 hPa
1,0 l / s	0,69 hPa	0,78 hPa
1,5 l / s	1,12 hPa	1,28 hPa

skuteczność nawilżania:

$V_T = 500$ ml	11,1 mg / l
$V_T = 750$ ml	12,0 mg / l
$V_T = 1000$ ml	13,9 mg / l

połączenie: 15 mm ISO

czas użycia: maksymalnie 24 h

nie zawiera lateksu

nie zawiera ftalanów

jednorazowego użytku

sterylizowany tlenkiem etylenu

pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 155 Pakiet 39 Dotyczy pozycji 4 Znając specyfikę oddziału neonatologicznego u Państwa na oddziale, różnorodność wyboru rozmiarów ułatwia pracę personelowi na oddziale oraz zapewnia dobro

pacjenta, wobec tego czy Zamawiający wymaga czapeczki w rozmiarach od XXS do XXXL oznaczonych kolorami do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 156 Pakiet 39 Dotyczy pozycji 5 Znając specyfikę oddziału neonatologicznego u Państwa na oddziale , różnorodność wyboru rozmiarów ułatwia pracę personelowi na oddziale oraz zapewnia dobro pacjenta, wobec tego Czy Zamawiający wymaga maseczek w rozmiarach od XS do XL do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 157 Pakiet 39 Dotyczy pozycji 6 Znając specyfikę oddziału neonatologicznego u Państwa na oddziale , różnorodność wyboru rozmiarów ułatwia pracę personelowi na oddziale oraz zapewnia dobro pacjenta, wobec tego Czy Zamawiający wymaga końcówek donosowych w rozmiarach od XS do XL do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 158 Pakiet 39 Dotyczy pozycji 1 Czy Zamawiający wymaga W PAKIECIE 39 POZ. 1 Układu oddechowego jednorazowego dla noworodków kompatybilny z aparatem medinCNO :

Zestaw posiada:

- dren wdechowy podgrzewany o dł. 1,1m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 25 cm, średnicy zew.13 mm
- dren ciśnieniowy
- odcinek od nawilżacza do aparatu o dł. 0,6 m z obydwu stron z zakończeniem 22F
- wymagane podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów.
- komorę nawilżacza (w jednym foliowym opakowaniu) z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850

Parametry te wymagane są z kompatybilnością urządzenia, które jest na wyposażeniu Zamawiającego. Dbając o dobro pacjenta prosimy o wymóg w/w parametrów wody w komorze oraz dren do nakłucia butelki z wodą z odpowietrznikiem. Komora wraz z układem pakowana w jednym opakowaniu foliowym.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 159 Pakiet 40 (Pakiet 40. Poz. 2.) Prosimy o potwierdzenie iż nastąpiła omyłka pisarska i w/w pozycji powinno być: Dren płuczący, z kontrolą ciśnienia, jednorazowy, sterylny, do pompy HAMOU ENDOMAT oraz do pompy ENDOMAT Select do zastosowania w artroskopii /opak. 10 szt/. Reszta zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 160 Pakiet 40 Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz na obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 i wojny a także światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 40 do 30 dni od złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 161 Pakiet 40 Czy Zamawiający zrezygnuje z dostaw na CITO- w ciągu 24 h w przypadku asortymentu wymienionego w pakiecie nr 40? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** i modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 162 Pakiet 40 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawiania próbek na asortyment w Zadaniu 40 poz. 1. Prośbę swą motywujemy tym, że produkt jest Zamawiającemu dobrze znany, Wykonawca oferuje produkty dotychczasowo stosowane w Państwa placówce.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki z racji na fakt, że każdy Wykonawca może złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu, a dostarczenie próbki służyć ma ocenie jakościowej zaoferowanego asortymentu.

Pytanie nr 163 Pakiet 40 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od możliwości zamawiania oferowanego w pakiecie 40 asortymentu w sztukach. Produkty te są oryginalnie pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze i producent nie zaleca ich rozpakowywania.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 164 Pakiet 41, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową w opakowaniu foliowym, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 165 Pakiet nr 41 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby rurka ustno-gardłowa była wykonana z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 166 Pakiet 43: Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnego worka do zbiórki żółci po zabiegach chirurgicznych z zaworem zwrotnym lub bez zaworu zwrotnego z dokładną podziałką co 100ml o całkowitej pojemności worka 2l.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 167 Pakiet 43, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie worka do zbiórki żółci o pojemności 400ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 168 Pakiet 43, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści wycenę worka do dobowej zbiórki moczu w opakowaniu a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 169 Pakiet 43, poz. 5-6 - Czy zamawiający dopuści wycenę worków do pobierania moczu w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 170 Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki z dodatkowym dołączonym oddzielnie portem bezigłowym zapewniającym szczelność po odłączeniu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 171 Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści aplikator wyposażony w szczelną zatyczkę samozatraskową zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem i wyciekami leku?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 172 Pakiet nr 50 Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do zakładania szwów w następującym składzie:

- 1 x kleszcze plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm
- 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki
- 1 x igłotrzymacz 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11,6 cm
- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)
- 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 173 Pakiet 50, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 174 Pakiet 50, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami gazowymi?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 175 Pakiet 50, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami włókninowymi?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 176 Pakiet 50, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami wysokochłonnymi włókninowo-celulozowymi, z nieprzemakalną spodnią warstwą z hydrofobowej włókniny?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 177 Pakiet 51 Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski do podawania tlenu z drenem w jednym uniwersalnym rozmiarze dedykowanym dla osób dorosłych, spełniającej pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 178 Pakiet 51 Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski do podawania tlenu z drenem w jednym uniwersalnym rozmiarze dedykowanym dla dzieci, spełniającej pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 179 Pakiet 51 Poz.3: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania nebulizatora z maską w jednym uniwersalnym rozmiarze dedykowanym dla osób dorosłych, spełniającego pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 180 Pakiet 51 Poz.3 i 4: Prosimy o sprecyzowanie czy dren tlenowy w zestawie do nebulizacji ma być wyposażony w kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora?

Odpowiedź: Nie, nie musi być wyposażony w kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora.

Pytanie nr 181 Pakiet 51 Poz.3 i 4: Prosimy o sprecyzowanie czy nebulizator ma się cechować pojemnością 10ml?

Odpowiedź: Nie, nie musi się cechować pojemnością 10ml.

Pytanie nr 182 Pakiet 51 Poz.4: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania nebulizatora z maską pediatryczną w jednym uniwersalnym rozmiarze, spełniającego pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 183 Pakiet nr 51 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści dozownik z łącznikiem prostym obrotowym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 184 Pakiet nr 53, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania filtra powietrza z silikonową ramką z narożnym wcięciem, zapewniającym szczelne dopasowanie do systemu Airvo2, kompatybilnego z systemem Airvo2?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza powyższe rozwiązanie,** ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 185 Pakiet 53, poz. 3 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli donosowej Optiflow + co oznacza, kaniulę z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin w drenie jak również posiadającą stabilizatory na policzki w celu prawidłowego umocowania kaniuli w nosie, kompatybilną z systemem Airvo2?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza powyższe rozwiązanie,** ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 186 Pakiet 53, poz. 4 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania Zestawu, który zawiera rurę z wbudowanymi czujnikami temperatury, do oddychania ogrzonym i nawilżonym powietrzem z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną oraz spiralą izolacyjną zawierającą ogrzane powietrze otaczającej gaz

oddechowy zmniejszający ryzyko tworzenia się skroplin, oraz samonapniającą się komorę z dwoma pływakami, kompatybilny z urządzeniem Airvo2.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza powyższe rozwiązanie**, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 187 Pakiet 53, poz. 5 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompatybilnego z Airvo2 zestawu do dezynfekcji Airvo2, który zawiera czerwoną rurę do dezynfekcji, wraz z filtrem do dezynfekcji, gąbką na patyku do czyszczenia urządzenia (2szt.), okrywą do sterylnego przechowywania Airvo2 (2szt) oraz instrukcją obsługi zestawu do dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza powyższe rozwiązanie**, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 188 Pakiet 53, Poz. 1-5 Informujemy, że zgodnie z dokumentem „warunki Gwarancji” dostarczanym przy zakupie urządzeń Airvo2, (producent Fisher&Paykel Healthcare), które są na wyposażeniu Państwa Szpitala, użytkowanie niezatwierdzonego przez producenta asortymentu jednorazowego (układów oddechowych, komór wodnych, kaniul donosowych, filtrów powietrza, zestawów do dezynfekcji), może skutkować utratą gwarancji na urządzenia. Ponadto producent urządzenia w związku z faktem, iż inny niż wskazany w instrukcji obsługi urządzenia Airvo2 asortyment jednorazowy nie został przetestowany, sprawdzony a jego bezpieczeństwo potwierdzone w środowisku kontrolowanym nie bierze odpowiedzialności za błędy w działaniu urządzenia oraz ewentualne incydenty medyczne z udziałem pacjentów. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o informację, czy wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanego asortymentu jednorazowego z posiadanymi urządzeniami wydanego przez producenta urządzenia Airvo2?”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 189 Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie 54** zestawu do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierającego: 2 igły wprowadzające: z koszulka i bez, strzykawkę, skalpel, prowadnice, zakrzywiony rozszerzacz, cewnik (rurkę) do wentylacji - radiocieniującą wyposażoną w standardowe złącze 15mm o śr. wewn. 3,5mm długości 3,8cm lub 4mm, długości 4,2cm lub 6mm długości 7,5cm i taśmę tracheotomijną.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 190 Projekt umowy – par. 2 ust. 3 Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 2 ust. 3. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**. Zapisy art. 144 pzp i art. 36 ust 1 pkt 3 mają inną treść. Zamawiający prowadzi postępowanie zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).

Pytanie nr 191 Projekt umowy – par. 8 ust. 1.7 Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Pytanie nr 192 Dotyczy projektu umowy § 3 ust.1 pkt. 1.1 W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność różnych produktów, w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu: *„Zamawiający, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp., dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora. W takiej sytuacji Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.”*

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**. Ten warunek zawiera się w stwierdzeniu „zwłoka” rozumiana jako zawinione opóźnienie.

Pytanie nr 193 Dotyczy projektu umowy § 7 pkt. 6 Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 7 ust. 6 na następujący: *„Warunkiem dokonania zakupu przedmiotu umowy od osoby trzeciej jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, jeżeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną pisma o wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu). W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, np. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym), przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”*

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Pytanie nr 194 Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania

umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Pytanie nr 195 Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 196 Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Pytanie nr 197 W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 5 mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Pytanie nr 198 Dotyczy wzoru umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Pytanie nr 199 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej? Wykonawca proponuje następującą treść

ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 200 Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 i wiążących się z nią kłopotów w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji, braków kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w świadczeniu usług.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 201 Prosimy o udostępnienie Wykonawcom pliku JEDZ w formacie XML, który umożliwi Wykonawcom zaimportowanie pliku JEDZ za pośrednictwem <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl>.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ wraz z załącznikiem nr 2 stanowią osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 202 Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego aby wprowadził wymóg przedmiotowego środka dowodowego w postaci załączenia do oferty zgłoszenia lub powiadomienia do URPL zaoferowanych wyrobów medycznych, z uwagi na możliwość weryfikacji na etapie składania ofert czy zaoferowany wyrób ww. dopuszczenie posiada.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 203 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3% Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces. Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.” Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową (24 miesiące z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego. Dodatkowo z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi

rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**. Przesłanki waloryzacji zostały określone arbitralnie.

Pytanie nr 204 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli dot. wprowadzania zmian do umowy: Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do przewidzenia. W konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności pozostające w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy. Na tej zasadzie Wykonawca ma możliwość skorzystania z przyznanych mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie kierowania do Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w tej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie obowiązywania Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**. Powyższe wynika z przepisów ogólnych.

Pytanie nr 205 dotyczy umowy §4 punkt 6 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania asortymentu w sztukach, a nie w opakowaniach zbiorczych.” Prosimy o potwierdzenie, że w/w punkt umowy obowiązuje jedynie w odniesieniu do produktów, które są zarejestrowane do sprzedaży w Polsce w pojedynczych sztukach i nie dotyczy produktów wyraźnie oznaczonych w ofercie przetargowej jako zarejestrowane w Polsce do sprzedaży w pełnych opakowaniach. Zgodnie z przepisami unijnymi i prawem polskim produkt medyczny powinien być sprzedawany Zamawiającemu w takim opakowaniu, jakie zostało zatwierdzone podczas procedury dopuszczenia produktu medycznego do obrotu. Ponadto oryginalne opakowanie zbiorcze jest elementem bezpieczeństwa stosowania i przechowywania produktów medycznych. Zawiera ono również ulotkę informacyjną i instrukcję obsługi produktów. Pozwoli to także na większą konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 206 Dotyczy §6 wzoru umowy Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów punktów poprzez dodanie zapisu „po wcześniejszym dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy oraz określenia terminu dodatkowego” realizacji ”. Zamawiający w umowie przewidział kary umowne za opóźnienia w realizacji postanowień umownych, obecny zapis jest bardzo niekorzystny dla Wykonawców ponieważ przewiduje możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego po jednym uchybieniu.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Pytanie nr 207 Dot. par. 2 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o zwiększenie wartości wykonania umowy do 80% wartości brutto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Pytanie nr 208 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Pytanie nr 209 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 1.1 i 1.2:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1.1 Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy, w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

1.2. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 210 Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 211 Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary o której mowa we wzorze umowy §7 ust. 1 pkt. z 10% na 5% ?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 212 Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary o której mowa we wzorze umowy §7 ust. 2 z 0,2% na 0,1% ?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody.** Kara odnosi się do wartości niezrealizowanego asortymentu.

Pytanie nr 213 Pytanie do wzoru umowy: W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 214 Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Lub też czy może podać realny % realizacji umowy na czas trwania umowy? Uzasadnienie: Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie

można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający szacuje realny procent realizacji umowy na 50%.

Pytanie nr 215 Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Pytanie nr 216 Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Zmodyfikowana SWZ wraz z załącznikami stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 05.05.2022r.** do godz. 10:00. Próbki należy złożyć w Sekretariacie ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice nie później niż do dnia otwarcia ofert. Otwarcie ofert i próbek następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **05.05.2022r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 02.08.2022r.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

Wykonawcy (e-mail)

1 x a/a.