

Nr sprawy 18/2020

Olsztyn, dn. 22 kwietnia 2020 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje" (Część III).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zestaw I

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego dopuścić pulsoksymetr w najwyższej technologii uznanej na rynku światowym, jako ŻŁOTY STANDARD pulsoksymetr w technologii Masimo SET o parametrach:

Lp	Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne i funkcjonalne
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2019 lub 2020
2.	Do pomiaru saturacji i tętna oraz APG (Acceleration Plethysmogram) u dorosłych
3.	Wyświetlanie indeksu APG
4.	Wbudowany czujnik saturacji na palcowy
5.	Urządzenie przenośne
6.	Wyświetlacz LED
7.	Wyświetlanie stanu naładowania baterii
8.	Zakres pomiarowy SpO2: min. 0 – 100 %
9.	Zakres pomiarowy częstotliwość pulsu 25 - 240 uderzeń/minutę
10.	Zasilanie bateryjne
11.	Trwałość baterii około 1800 kontroli pojedynczych praca ciągła ponad 12 H
12.	Waga: 73 g z bateriami
13.	Instrukcja obsługi w języku polskim 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Projekt dofinansowany w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz budżetu państwa
Realizacja projektu pn. „Onkoinnowacje” nr POIS.09.02.00-00-0164/19

Pytanie 2

Czy ze względu na najczęściej występujące problemy z pomiarem pacjentów **z niską perfuzją, obrzękiem kończyn, zimnymi kończynami** a przede wszystkim pacjentem **pobudzonym i w ruchu**

Czy Zamawiający oczekuje pulsoksymetru, który:

- zbiera sygnał Indeksu Perfuzji od co najmniej 0,02% (pacjenci z krytycznymi parametrami, z obrzękiem lub wychłodzeniem kończyn)
- pokazuje pomiar w czasie rzeczywistym – czas uśredniania pomiaru co 8 sec
- przedstawia precyzyjny wynik pomiaru wysycenia krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta, tzn. eliminuje wzbudzony ruchem puls żylny prowadzący do fałszywego zaniżania pomiaru – największy problem większości urządzeń
- bezproblemowo radzi sobie z pomiarem pomimo lakieru na paznokciach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy Zad. nr 7 – Lampy bezcieniowe

1)Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy bezcieniowej z następującymi ustawieniami temperatury barwowej: 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4350 K i 5000 K.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2)Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy bezcieniowej z soczewkami sferycznymi dzięki którym plama świetlna jest równomierna i okrągła.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3)Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy bezcieniowej z indywidualnym odbłyśnikiem każdej diody o średnicy 40 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

4)Termin dostawy

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 60 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zad. nr 23 – Stoły operacyjne

1)Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie blatu stołu przeziernego dla promieniowania RTG – przystosowanego do monitorowania ramieniem C, z częściową nieprzeziornością podglówka poza obszarem pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

2)Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego zawieszonego na czterech podwójnych kółkach obrotowych o średnicy min. 100 mm, obracanych o 360 stopni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3)Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z całkowitą szerokością blatu (bez szyn) 52 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

4)Poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z regulacją wysokości blatu stołu bez materaca w zakresie 57,5 cm do 107,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

5)Poz. 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z regulacją podglówka w zakresie +/-60°

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

6)Poz. 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z wizualnym systemem kontroli orientacji blatu na pilocie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

7)Poz. 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego w którym blokowanie/odblokowywanie stołu do podłoża odbywa się za pomocą chowanie kół w podstawę co jest rozwiązaniem bardziej nowoczesnym i gwarantuje największą z możliwych stabilność podczas operacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

8)Termin dostawy

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 60 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary umowne wynikające z zapisu §14 ust.1.1 wynosiły 0,2% wartości sprzętu, którego kara dotyczy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary umowne wynikające z zapisu §14 ust.1.2 wynosiły 0,5% wartości sprzętu, którego kara dotyczy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary umowne wynikające z zapisu §14 ust.1.4 i ust.1.5 wynosiły 0,2% wartości sprzętu, którego kara dotyczy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zestaw II

Dot. Zad 3 Elektryczny podnośnik pacjenta

1. (Lp 7) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik elektryczny pacjenta o wadze urządzenia nie przekraczającej 43 kg? Parametr ten jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. (Lp 10) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik elektryczny pacjenta ze stałą jedną prędkością opuszczania i podnoszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. (Lp 12) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik elektryczny pacjenta z ergonomicznym uchwytem bez gumowej powłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

4. (Lp 15,16) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik elektryczny pacjenta z wieszakami bez gumowej powłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

5. (Lp 17) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik elektryczny pacjenta z maksymalnym odchyleniem ramienia od końca podstawy jezdnej w najwyższym punkcie = 668 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

6. (Lp 18) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik elektryczny pacjenta z minimalnym odchyleniem ramienia od końca podstawy jezdnej w najniższym punkcie = 250 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

7. (Lp 19) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik elektryczny pacjenta z maksymalną wysokością 1765 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

8. (Lp 20) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik elektryczny pacjenta z zakresem unoszenia 1535 mm? Parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

9. (Lp 23) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik elektryczny pacjenta o szerokości wewnętrznej przy złożonych nogach = 670 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadanie 7 Lampy bezcieniowe- Lampa bezcieniowa zabiegowa jezdną 1

1. (Lp 4) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością regulacji temperatury barwowej w zakresie 3500-4000-4500-5000-5500 K? Parametr ten jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. (Lp 5) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze źródłem światła LED, w której diody umieszczone są w odbłyśnikach gwarantujących bezcieniowość i wysoką jednolitość światła?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 13

Kozetka lekarska

1. Czy Zamawiający dopuści kozetkę wyposażoną w cztery koła do przetaczania oraz cztery stopki, na których stół stoi podczas zabiegów, badań itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Stolik zabiegowy

1. Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy wykonany w całości z odlewu z tworzywa sztucznego typu Poliuretan?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy z blatem roboczym zagłębionym, wykonanym z Poliuretanu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Wózek do badań i transportu chorych

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 211cm i szerokości 76cm, przy wymiarach leża 193cm x 66cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-90 stopni, segmentu uda w zakresie 0-40 stopni oraz podudzia w zakresie 0-17stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 23

1. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, które segmenty łączone są ze sobą za pomocą złączy blokowanych mechanicznie poprzez śruby zaciskowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie 69-105cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych w obu kierunkach 20 stopni (20 stopni w lewo i 20 stopni w prawo)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją pozycji Trendelenburga 30 stopni oraz antyTrendelenburga 30 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z funkcją przesuwu wzdłużnego w zakresie 285mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją segmentu nożnego za pomocą sprężyn gazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści regulacja pozycji Beach Chair za pomocą kilku przycisków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją segmentu pleców w zakresie -40 do +70 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją pozycji Flex do 210 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją segmentu nożnego w zakresie -90 do +30 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją segmentu podglówka w zakresie od -50 do +40 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z blokadą do podłoża za pomocą elektrycznej blokady centralnej kół, uruchamianą pilotem oraz panelem na kolumnie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z dopuszczalnym obciążeniem roboczym 454kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zadanie 24

1. Czy Zamawiający dopuści stół o nośności 240kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości blatu 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją sekcji nóg w zakresie od -50 do +35 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści stół z zagłówkiem zintegrowanym z segmentem pleców z otworem w kształcie owalnym/półwałka, który stabilizuje głowę pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw III

Pytania dotyczące zadania nr 23: Stoły operacyjne:

1. Dotyczy punktu 4:

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w system napędu elektromechanicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

2. Dotyczy punktu 5:

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w 4 podwójne koła skrętne, obracane 360 stopni o średnicy min. 100 mm? Koła te zapewniają maksymalny komfort przemieszczania stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy punktu 8:

Czy Zamawiający dopuści blat minimum 4 segmentowy? Główna część blatu jest złożona z dwóch części złączonych za pomocą zmotoryzowanych przegubów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

4. Dotyczy punktu 18:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, które polega na uzyskaniu pozycji beach-chair za pomocą szybkiego wyboru sterowanego z ekranu dotykowego? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy punktu 25:

Czy Zamawiający dopuści część nożną odchylaną o minimum 45° względem osi wzdłużnej stołu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

6. Dotyczy punktu 26:

Czy Zamawiający dopuści podglówek regulowany w zakresie $+45^{\circ}/-30^{\circ}$. Podglówek ma możliwość wypiętrzenia ponad blat min. 15 cm. Poduszka blatu posiada wyraźne wgłębienie na głowę, przez co nie wymagane jest używanie dodatkowych pozycjonerów głowy. W celu maksymalnego zwiększenia komfortu użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta ruch podglówka jest wspomagany przez sprężynę gazową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy punktów 31 i 32:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne składające się z:

1. podpory pod rękę regulowane za pomocą przegubów kulowych blokowanych jednym pokrętkiem, które pozwalają dowolne ułożenie ręki pacjenta w każdej pozycji (na plecach, na brzuchu, na boku), mocowane do szyn bocznych – min. 2 szt.
2. Podpór bocznych regulowanych w 3 osiach z możliwością blokady każdej osi z osobna, zapewniające mocne podpieranie pacjenta, mocowane do szyn bocznych – 4 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy punktu 38:

Czy Zamawiający dopuści stół o dopuszczalnym obciążeniu min. 450 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

9. Dotyczy punktu 39:

Czy Zamawiający dopuści stół dla którego masa pacjenta to maksymalnie 225 kg, z możliwością wykorzystania wszystkich funkcji stołu oraz 450 kg przy ograniczonym zakresie ruchomości stołu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw IV

Zadanie nr 14

Poz.17) Imadło o dł. 135mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zadanie nr 31

Poz.5) Kleszczyki o nazwie własnej Crile-Rankin, identyczne z wymaganymi lub kleszczyki o nazwie własnej Halsted o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.6) Uchwyt o dł. 210mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.8) Zgryzac Kerrison identyczny z wymaganym o kącie 40° (odpowiednik 130°)- kąt liczony od wewnątrz a nie od zewnątrz.

Poz.10) Pinceta bez otworów w uchwycie, funkcjonalnie identyczne.

Poz.11) Imadło o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.14) Hak o wym. łopatki 16x3mm i 19x3mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.15,42,43,46) Z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie jej z zadania i utworzenie nowego odrębnego co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców przy

zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Poz.16) Igłotrzymacz o nazwie własnej Mayo-Hegar, funkcjonalnie identyczne.

Poz.17) Nożyczki o dł. 165mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.22) Łyzeczka o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.23) Łyzeczka o dł. 170mm i śr. 5mm zamiast 4,5mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.24) Łyżeczka o dł. 180mm i śr.3mm i 4mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.26) Podważka o dł. 190mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.28) Szpatułka o szer. 18/23mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.29) Hak o dł. 230mm i wym. 30x7mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.30) Hak o dł. 230mm i wym. 25x12mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.31) Hak o dł. 120mm i wym. 10x25mm i 17x32mm oraz 10x30mm i 17x35mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.33) Imadło o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.34) Haczyk o dł. 160mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.35) Sonda o śr. 0,6/07mm lub 0,8/0,9mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.37) Nożyczki o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.39) Wziernik o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.40) Osteotom o dł. 150mm i szer. 2,5mm, 4mm lub 6,5, lub o dł. 220mm i szer. 8mm, 12mm lub 16mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.42) Osteotom o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczne lub o dł. 150mm i szer. 6,5mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.43) Osteotom o szer.6,5mm bez stopniowania, standardowy, funkcjonalnie identyczne.
Poz.46) Hak Obwegeser o dł. 225mm i dł. roboczej: 18mm, 25mm, 35mm, 42mm, 55mm, 70mm lub 80mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.48) Tuba ssąca o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne

Odpowiedź:

Zamawiający we wszystkich ww. poz. zad. Nr 31 wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zestaw V

Zadanie nr 22

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie ilości staplerów okrężnych. Czy Oferent ma złożyć ofertę na 3 szt. do wyboru przez Zamawiającego z rozmiarów 21mm, 25mm, 28 mm, 31 mm, czy po 3 szt. z każdego z tych rozmiarów w sumie 12 staplerów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty na 3 szt. Rozmiar zostanie określony na etapie realizacji.

2. Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne w rozmiarach 21mm, 25mm, 31mm z dwoma rzędami zszywek, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia określi średnicę staplera.

Zestaw VI

Pytanie 1 – zał. nr 8 do SIWZ, zadanie 30, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie narzędzia z okrągłym uchwytem?
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 2 – zał. nr 8 do SIWZ, zadanie 30, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie narzędzia z okrągłym uchwytem?
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 3 – zał. nr 8 do SIWZ, zadanie 30, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pęsety mikrochirurgicznej o długości całkowitej 135 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zestaw VII

Zadanie 16. Zestaw pomp infuzyjnych

Nazwa urządzenia /typ/ model

Producent.....

Kraj pochodzenia.....

Rok produkcji.....

Ilość: 5 zestawów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw pomp wraz ze stacją dokującą jak poniżej opisany:

Skład jednego zestawu:

- stacja dokująca – 1 szt.
- pompa infuzyjna strzykawkowa – 5 szt. jednotorowych
- pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt.

Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 6 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych.

Mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem transportowym.

Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i ze stacji.

Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji.

Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny).

Masa stacji dokującej maksymalnie: 6,2 kg.

Ochrona klasy IP24.

Nowoczesna pompa strzykawkowa renomowanego producenta o parametrach jak poniżej:

Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie

Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację.

Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w pełni manualne. Możliwość zamontowania i przygotowania strzykawki przy wyłączonym urządzeniu.

Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym 4,3" ekranie dotykowym

Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V

Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 12 h przy przepływie 5ml/h

Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin

Ochrona przed zalaniem: IP 24

Funkcja Stand-by z możliwością programowania przez użytkownika w zakresie od 1 min do 25 godzin +/- 1min

Waga 1,7 kg

Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na min. 10 poziomach

Możliwość rozbudowy o tryb wzywania pielęgniarki

Wbudowane gniazdo USB

Regulacja głośności: min. 10 poziomów

Możliwość ręcznego i automatycznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian parametrów

Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu min. 1, 2, 5, 10, 30 min

Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – nie dopuszcza się zasilacza zewnętrznego

Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących

Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym w postaci procentowej lub pozostałego czasu do rozładowania urządzenia

Możliwość resetowania ustawień użytkownika przed kolejną infuzją. Nie akceptuje się resetowania urządzenia do ustawień fabrycznych.

Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki bez użycia dodatkowych elementów z możliwością zapisania jej nazwy i parametrów bezpośrednio w pompie

Napisy na wyświetlaczu w języku polskim

Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu

I. Parametry podaży

Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 50/60 ml

Co najmniej 6 trybów infuzji:

- Tryb podstawowy: ml/h
- Tryb programowania leku na podstawie masy ciała pacjenta
- Tryb dawki indukcyjnej (wysycającej)
- Tryb sekwencyjny z max. 5 etapami
- Tryb podnoszenia i opuszczania
- Tryb TIVA

Dokładność podaży: +/- 2%

Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia:

- ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml

Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania:

- ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min, h, 24h
- ng/kg/, ug/kg/, mg/kg/, g/kg/, U/kg/, KU/kg/, IU/kg/, IE/kg/, mmo/kg/, mol/kg/, kcal/kg/ na min, h, 24h

Regulowane progi ciśnienia w zakresie:

- 75 – 900 mmHg
- 12 poziomów
- rozdzielczość min. 75 mmHg

Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. Klawiatura wyświetlana na ekranie dotykowym.

Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy przed infuzją oraz automatyczny programowalny podczas infuzji

Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie.

Mechanizm blokujący tłok strzykawki zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu się strzykawki podczas wymiany

Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu nie zintegrowanego z pompą. Możliwość demontażu w celu oszczędności miejsca i zmniejszenia wagi urządzenia.

Automatyczna funkcja antybolus lub redukcji ciśnienia okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml

Zmiana szybkości infuzji, objętości do podania i czasu bez konieczności przerywania wlewu

Możliwość wyzerowania objętości podanej pacjentowi bez konieczności przerywania wlewu

Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością

Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h

Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h

Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1800 ml/h dla strzykawki 50ml

Funkcja programowania objętości do podawania min. 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml

Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: min. 100 – 1800 ml/h

Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika

Lista leków: min. 40 leków.

Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.

Parametry infuzji dla leków:

- Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus
- Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego
- Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej

Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w strzykawce w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania akumulatora w formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość używanej strzykawki, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany

II. Alarmy

Wskaźnik pracy pompy

Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń

Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji

Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki

Alarm pustej strzykawki

Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji

Alarm okluzji

Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora

Alarm rozładowanego akumulatora

Alarm braku lub źle założonej strzykawki

Alarm wstępny przed końcem infuzji

Alarm braku zasilania

Alarm przypominający o przerwaniu procesie programowania infuzji z możliwością programowania czasu przypomnienia min. 2, 5, 10, 15, 20, 30 min

Czujnik prawidłowego założenia strzykawki w popychaczu tłoka

III. Stacja dokująca

Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 IP 24 (bryzgoszczelna), oraz wytrzymała konstrukcja zapewnia ciągłe użytkowanie w trudnych warunkach, szczególnie intensywnej terapii

Możliwość zamontowania min. 6 pomp strzykawkowych na jednej stacji

Stacja wyposażona w gniazda zasilające do pomp

Szybki i pewny, przykręcany system mocowania pompy do stacji.

Pełna kompatybilność z pompami strzykawkowymi

IV. Warunki ogólne oraz gwarancja i serwis

Instalacja i adaptacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty

Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim drukowana 1szt. – dostarczona wraz z dostawą aparatu

Gwarancja min. 24 miesięcy

Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi

Bezpłatne, okresowe przeglądy gwarancyjne wg zaleceń producenta

Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz.

Czas skutecznej naprawy max. 5 dni licząc od dnia zgłoszenia

Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego

Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby

Paszport techniczny

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia

Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres min. 10 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego?

Nowoczesna pompa objętościowa renomowanego producenta o parametrach jak poniżej:

I. Dane ogólne

Pompa objętościowa do podawania dożylnego i tętniczego sterowana elektronicznie umożliwiającą współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi

Pompa dostosowana do użytku dla pacjentów: dorosły, dziecko, noworodek

Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację.

Aparat infuzyjny mocowany od frontu pompy. Dren w urządzeniu w pozycji poziomej.

Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym min. 4" ekranie dotykowym

Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V

Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 9h przy przepływie 25ml/h

Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin

Ochrona przed zalaniem: IP 24

Funkcja Stand-by z możliwością programowania przez użytkownika w zakresie od 1 min do 25 godzin +/- 1min

Waga poniżej 2 kg

Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na min. 10 poziomach

Możliwość rozbudowy o tryb wzywania pielęgniarki

Wbudowane gniazdo USB

Regulacja głośności: min. 10 poziomów

Możliwość ręcznego i automatycznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian parametrów

Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu min. 1, 2, 5, 10, 30 min

Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – nie dopuszcza się zasilacza zewnętrznego

Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących

Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym w postaci procentowej lub pozostałego czasu do rozładowania urządzenia

Możliwość resetowania ustawień użytkownika przed kolejną infuzją. Nie akceptuje się resetowania urządzenia do ustawień fabrycznych.

Możliwość automatycznej kalibracji dowolnego aparatu infuzyjnego z możliwością zapisania jego nazwy i parametrów bezpośrednio w pompie

Napisy na wyświetlaczu w języku polskim

Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu

II. Parametry podaży

Możliwość precyzyjnej pracy z lub bez czujnika kropli

Wysoka czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza $\leq 0,02$ ml

Co najmniej 6 trybów infuzji:

- Tryb podstawowy: ml/h
- Tryb programowania leku na podstawie masy ciała pacjenta

- Tryb dawki indukcyjnej (wysycającej)
 - Tryb sekwencyjny z max. 5 etapami
 - Tryb podnoszenia i opuszczania
 - Tryb kroplówki (z zastosowaniem czujnika kropli)
- Dokładność podaży: +/- 5%
- Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia:
- ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml
- Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania:
- ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min, h, 24h
 - ng/kg/, ug/kg/, mg/kg/, g/kg/, U/kg/, KU/kg/, IU/kg/, IE/kg/, mmo/kg/, mol/kg/, kcal/kg/ na min, h, 24h
- Regulowane progi ciśnienia w zakresie:
- min. 75 – 900 mmHg
 - min. 12 poziomów
 - rozdzielczość min. 75 mmHg T
- Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. Klawiatura wyświetlana na ekranie dotykowym.
- Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy przed infuzją oraz automatyczny programowalny podczas infuzji
- Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie.
- Mechanizm blokujący swobodny przepływ płynu zainstalowany w pompie
- Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu nie zintegrowanego z pompą. Możliwość demontażu w celu oszczędności miejsca i zmniejszenia wagi urządzenia.
- Automatyczna funkcja antybolus lub redukcji ciśnienia okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml
- Zmiana szybkości infuzji, objętości do podania i czasu bez konieczności przerywania wlewu
- Możliwość wyzerowania objętości podanej pacjentowi bez konieczności przerywania wlewu
- Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością
- Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h
- Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h
- Zakres prędkości podaży 0,01-1200 ml/h
- Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1200 ml/h
- Funkcja programowania objętości do podawania min. 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml
- Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: min. 100 – 1200 ml/h
- Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika
- Lista leków: min. 40 leków.
- Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.
- Parametry infuzji dla leków:
- Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus
 - Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego
 - Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej
- Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w aparacie w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania akumulatora w formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość używanego aparatu, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany

III. Alarmy

Wskaźnik pracy pompy

Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń
zależności od ważności.

Hierarchia alarmów w

Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji

Alarm końca infuzji

Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji

Alarm okluzji

Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora

Alarm rozładowanego akumulatora

Alarm braku lub źle założonego aparatu

Alarm wstępny przed końcem infuzji

Alarm braku zasilania

Alarm przypominający o przerwaniu procesie programowania infuzji z możliwością programowania czasu przypomnienia min. 2, 5, 10, 15, 20, 30 min

Czujnik wykrywania powietrza w drenie, jeden między pacjentem a pompą, drugi między pompą a pojemnikiem z płynem

IV. Warunki ogólne oraz gwarancja i serwis

Instalacja i adaptacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty

Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim drukowana 1szt. – dostarczona wraz z dostawą aparatu

Gwarancja min. 36 miesięcy

Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi

Bezpłatne, okresowe przeglądy gwarancyjne wg zaleceń producenta

Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.

Czas skutecznej naprawy max. 5 dni licząc od dnia zgłoszenia

Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego

Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby

Paszport techniczny

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia

Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres min. 10 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zadanie 18. Pompy infuzyjne strzykawkowe

Pompy infuzyjne strzykawkowe

Nazwa urządzenia /typ/ model

Producent.....

Kraj pochodzenia.....

Rok produkcji.....

Ilość: 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne pompy strzykawkowe renomowanego producenta o parametrach funkcjonalnych jak poniżej:

Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie.
Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiającą współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi.
Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie.
Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację.
Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w pełni manualne. Możliwość zamontowania i przygotowania strzykawki przy wyłączonym urządzeniu.
Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym 4,3" ekranie dotykowym
Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V
Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 12 h przy przepływie 5ml/h
Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin
Ochrona przed zalaniem: IP 24
Funkcja Stand-by z możliwością programowania przez użytkownika w zakresie od 1 min do 25 godzin +/- 1min
Waga 1,7 kg
Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na min. 10 poziomach
Możliwość rozbudowy o tryb wzywania pielęgniarki
Wbudowane gniazdo USB
Regulacja głośności: min. 10 poziomów
Możliwość ręcznego i automatycznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian parametrów
Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu min. 1, 2, 5, 10, 30 min
Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – nie dopuszcza się zasilacza zewnętrznego
Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących
Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym w postaci procentowej lub pozostałego czasu do rozładowania urządzenia
Możliwość resetowania ustawień użytkownika przed kolejną infuzją. Nie akceptuje się resetowania urządzenia do ustawień fabrycznych.
Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki bez użycia dodatkowych elementów z możliwością zapisania jej nazwy i parametrów bezpośrednio w pompie
Napisy na wyświetlaczu w języku polskim
Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu

I. Parametry podaży

Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 50/60 ml
Co najmniej 6 trybów infuzji:

- Tryb podstawowy: ml/h
- Tryb programowania leku na podstawie masy ciała pacjenta
- Tryb dawki indukcyjnej (wysycającej)
- Tryb sekwencyjny z max. 5 etapami
- Tryb podnoszenia i opuszczania
- Tryb TIVA

Dokładność podaży: +/- 2%

Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia:

- ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml

Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania:

- ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min, h, 24h
- ng/kg/, ug/kg/, mg/kg/, g/kg/, U/kg/, KU/kg/, IU/kg/, IE/kg/, mmo/kg/, mol/kg/, kca/kg/ na min, h, 24h

Regulowane progi ciśnienia w zakresie:

- 75 – 900 mmHg
- 12 poziomów
- rozdzielczość min. 75 mmHg

Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. Klawiatura wyświetlana na ekranie dotykowym.

Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy przed infuzją oraz automatyczny programowalny podczas infuzji

Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie.

Mechanizm blokujący tłok strzykawki zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu się strzykawki podczas wymiany

Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu nie zintegrowanego z pompą. Możliwość demontażu w celu oszczędności miejsca i zmniejszenia wagi urządzenia.

Automatyczna funkcja antybolus lub redukcji ciśnienia okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml

Zmiana szybkości infuzji, objętości do podania i czasu bez konieczności przerywania wlewu

Możliwość wyzerowania objętości podanej pacjentowi bez konieczności przerywania wlewu

Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością

Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h

Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h

Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1800 ml/h dla strzykawki 50ml

Funkcja programowania objętości do podawania min. 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml

Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: min. 100 – 1800 ml/h

Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika

Lista leków: min. 40 leków.

Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.

Parametry infuzji dla leków:

- Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus
- Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego
- Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej

Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w strzykawce w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania akumulatora w formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość używanej strzykawki, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany

II. Alarmy

Wskaźnik pracy pompy

Akustycznie – optyczny system alarmów i ostrzeżeń

Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji

Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki

Alarm pustej strzykawki

Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji

Alarm okluzji

Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora

Alarm rozładowanego akumulatora

Alarm braku lub źle założonej strzykawki

Alarm wstępny przed końcem infuzji

Alarm braku zasilania

Alarm przypominający o przerwaniu procesu programowania infuzji z możliwością programowania czasu przypomnienia min. 2, 5, 10, 15, 20, 30 min

Czujnik prawidłowego założenia strzykawki w popychaczu tłoka

III. Stacja dokująca

Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 IP 24 (bryzgoszczelna), oraz wytrzymała konstrukcja zapewnia ciągłe użytkowanie w trudnych warunkach, szczególnie intensywnej terapii

Możliwość zamontowania min. 6 pomp strzykawkowych na jednej stacji

Stacja wyposażona w gniazda zasilające do pomp

Szybki i pewny, przykręcany system mocowania pompy do stacji.

Pełna kompatybilność z pompami strzykawkowymi

IV. Warunki ogólne oraz gwarancja i serwis

Instalacja i adaptacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty

Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim drukowana 1szt. – dostarczona wraz z dostawą aparatu

Gwarancja min. 24 miesiące

Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi

Bezpłatne, okresowe przeglądy gwarancyjne wg zaleceń producenta

Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz.

Czas skutecznej naprawy max. 5 dni licząc od dnia zgłoszenia

Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego

Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby

Paszport techniczny

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia

Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres min. 10 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 21. Pulsoksymetry

Nazwa urządzenia /typ/ model

Producent.....

Kraj pochodzenia.....

Rok produkcji.....

Ilość: 1 szt.

Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny pulsoksymetr renomowanej firmy bez funkcji APG?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny pulsoksymetr renomowanej firmy bez możliwości wyświetlania indeksu APG?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny pulsoksymetr renomowanej firmy z ekranem LCD?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny pulsoksymetr renomowanej firmy o masie poniżej 300g?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zestaw VIII

Zadanie 26

Celem zwiększenia konkurencyjności złożonych ofert oraz co może przyczynić się do zwiększonej ilości rozstrzygnięć zadań w pierwszej turze postępowania przetargowego, co ma bezpośredni wpływ na celowe wydatkowanie środków, czy Zamawiający zgodzi się na rozdzielenie zadania 26 na poszczególne 3 zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zadanie 26

Wirówka medyczna – oddział wewnętrzny

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę laboratoryjną spełniającą wszystkie wskazane wymagania wraz z wirnikiem kątowym 8 miejscowym który ma możliwość wirowania próbek we wskazanych pojemnościach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę laboratoryjną o nieco większych wymiarach nie przekraczających 300 x 370 x 460 mm (WxSxD) i wadze do 25kg, oferującą znacznie szerszy zakres regulacji prędkości do 6000 obr./min i znacznie lepszym i dokładniejszym skokiem sterowania co 1 obr./min, spełniającą wszystkie pozostałe wskazane wymagania? W przypadku negatywnej odpowiedzi bardzo proszę o jej uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zadanie 26

Wirówka medyczna – Chirurgia Szczękowo-Twarzowa

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę laboratoryjną o nieco większych wymiarach nie przekraczających 300 x 370 x 460 mm (WxSxD) z dokładniejszym skokiem sterowania co 1 obr./min co jest bardzo ważne dla właściwego pozyskiwania PRF, A-PRF i I-PRF, spełniającą wszystkie pozostałe wymagane parametry?

W przypadku negatywnej odpowiedzi bardzo proszę o jej uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zadanie 26

Wirówka laboratoryjna - Patomorfologia

Zamawiający w opisie tej wirówki nie przekazał żadnych informacji dotyczących wyposażenia tej wirówki. Zwracam się wobec tego z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający zamawia wirówkę bez wirnika lub doprecyzowanie jakiego typu wirnika wymaga (kątowy czy

wychylny), jak dużo próbek ma być wirowanych, jakich pojemności i wymiarów mają być te próbki?

Odpowiedź:

Możliwość wirowania próbek o pojemnościach (zakres minimalny): 10ml / 7ml / 5ml. Rotor na min. 12 pojemników na próbki.

Zestaw IX

Zadanie 26 - Wirówka medyczna – Oddział Wewnętrzny

1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę medyczną posiadającą skokową regulację prędkości co 1 rpm ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę medyczną wyposażoną w wirnik kątowy 8x15/10 ml, oraz wirnik kątowy 12x10 ml wraz z wkładkami redukcyjnymi bez dna (fi13,3mm) ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
3. Czy Zamawiający dopuści wirówkę medyczną o wymiarach zewnętrznych: (wys. x szer. x głęb.) 300x367x455 mm ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
4. Czy Zamawiający dopuści wirówkę medyczną o wadze 22 kg ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
5. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z oznaczeniem na obudowie wymaganej treści – poprzez naklejenie etykiety z oznaczeniem: USK Olsztyn ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający dopuszcza.
3. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.
4. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.
5. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zadanie 26 - Wirówka medyczna – Chirurgia Szczękowo-Twarzowa

1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę medyczną wyposażoną w wirnik kątowy 8x15/10 ml? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę medyczną z rotorem nie mającym możliwości sterylizacji w autoklawie? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
3. Czy Zamawiający dopuści wirówkę medyczną o wymiarach zewnętrznych: (wys. x szer. x głęb.) 300x367x455 mm ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
4. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z oznaczeniem na obudowie wymaganej treści – poprzez naklejenie etykiety z oznaczeniem: USK Olsztyn ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. Jest to opcjonalne i stanowi element kryterium oceny ofert.
3. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.
4. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zadanie 26 - Wirówka laboratoryjna – Patomorfologia

1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z oznaczeniem na obudowie wymaganej treści – poprzez naklejenie etykiety z oznaczeniem: USK Olsztyn ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
2. Bardzo proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego ilości wymaganych przeglądów okresowych ?
3. Bardzo proszę o określenie przez Zamawiającego wymaganego doposażenia do wirówki laboratoryjnej w postaci rotorów, wkładek redukcyjnych itp. ?

Odpowiedź:

1. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.
2. Częstotliwość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Możliwość wirowania próbek o pojemnościach (zakres minimalny): 10ml / 7ml / 5ml.
Rotor na min. 12 pojemników na próbki.

Zestaw X

Dotyczy: Zadanie 23 Stoły operacyjne – 1 kpl.

Pytanie 1 - dotyczy punktu 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny wykonany z materiałów nierdzewnych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, z pokrywą podstawy wykonaną z włókna szklanego, bez przetłoczeń technologicznych i zagłębień? Pokrywa podstawy również odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i łatwa w utrzymaniu w czystości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - dotyczy punktu 13

Prosimy o dopuszczenie stołu z regulacją wysokości w zakresie od 60 cm do 106 cm. Taki zakres regulacji wysokości pozwala na przeprowadzenie wszystkich procedur operacyjnych, w tym również wysokospecjalistycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 - dotyczy punktu 14

Prosimy o dopuszczenie stołu z przechyłami bocznymi w obie strony od poziomu o kąt 20°, co w żaden sposób nie wpływa na obniżenie funkcjonalności stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 - dotyczy punktu 15

Prosimy o dopuszczenie stołu z przechyłem Trendelenburga od poziomu o kąt 30°, co w żaden sposób nie wpływa na obniżenie funkcjonalności stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 5 - dotyczy punktu 16

Prosimy o dopuszczenie stołu z przechyłem anty – Trendelenburga od poziomu o kąt 30°, co w żaden sposób nie wpływa na obniżenie funkcjonalności stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 6 - dotyczy punktu 26

Prosimy o dopuszczenie stołu wyposażonego w podglówek z regulacją kąta ustawienia podglówka w zakresie +90°/- 45° oraz płynnym wypiętrzeniem podglówka względem blatu o 15cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 - dotyczy punktu 28

Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego z wizualnym systemem kontroli orientacji blatu na pilocie sterującym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 8 - dotyczy punktu 29

Prosimy o dopuszczenie stołu z informacją o stanie naładowania akumulatora na panelu sterowania na kolumnie stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 9 - dotyczy punktu 30

Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego z funkcją blokowania/odblokowywania stołu do podłoża elektrohydraulicznie. Centralna blokada podstawy stołu – funkcja sterowana za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego. Stół w pozycji „zablokowany” nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach. Funkcja stabilnego posadowienia całej podstawy stołu na podłodze gwarantuje uzyskanie jak największej stabilności stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 10 - dotyczy punktu 38 i 39

Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem wynoszącym 450 kg, przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości przeprowadzania zabiegów operacyjnych z pacjentem o wadze do 450 kg. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego niż możliwość maksymalnego obciążenia stołu masą min 470 kg i dopuszczalną wagą pacjenta 250 czy też 270 kg.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wydaje się zupełnie nie przydatnym parametrem możliwość obciążenia maksymalnego stołu masą 470kg w przypadku kiedy nie można operować na nim pacjenta o wadze większej niż 270 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania 7 Lampy bezcieniowe

Pytanie 1 - dotyczy punktu 4

Prosimy o dopuszczenie lampy bezcieniowej o temperaturze barwowej: 4300°K.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2 - dotyczy punktu 6

Prosimy o dopuszczenie lampy bezcieniowej o wymiarach odbłyśnika 676 mm x 291 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 1 - dotyczy Umowy § 15 ust. 1

Zgodnie z treścią § 15 ust. 1 Umowy, Zamawiający podał, że:

„Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umownych z powodu wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np.: pożar, powódź, osuwisko, trzęsienie ziemi, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz.”

Zamawiający w w/w postanowieniu Umowny doprecyzował kiedy zaistniałą okoliczność uznać można za siłę wyższą. Słusznie wskazane zostało, że strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umownych spowodowane nieprzewidzianym wydarzeniem, które wystąpi niezależnie od woli stron i po zawarciu umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych.

Zamawiający dokonał również wskazanie przykładowego katalogu, okoliczności, które uznać można będzie za siłę wyższą. Wśród tych przykładów próżno szukać okoliczności związanych z klęską epidemiczną, która z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Wyżej omówiona sytuacja jest niezrozumiała w szczególności z uwagi na brzmienie art. 15 r w ust. 6 Ustawy o COVID-19, który wskazuje, że:

„6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.”

Ponadto, w art. 15 s Ustawy o COVID-19 ustawodawca odstąpił od sankcji przewidzianej w ramach dyscypliny finansów publicznych, za nieustalenie lub niedochodzenie kar umownych, powstałych w związku z epidemią COVID-19, wskazując, że:

Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284):

- 1) nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1;*
- 2) zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4.*

Takie sformułowanie przez ustawodawcę, zacytowanych wyżej przepisów, daje Zamawiającym jasną wskazówkę interpretacyjną, że z uwagi na panującą epidemię COVID-19 powinni stosować mniej restrykcyjne podejście wobec wykonawców realizujących umowy. Przykładem takiego mniej restrykcyjnego podejścia jest uwzględnienie wprost kryzysy epidemicznego jako siły wyższej w umowie, pozwalając tym samym zabezpieczyć się potencjalnemu wykonawcy ale i również Zamawiającemu przed skutkami tego kryzysu, których przewidzieć nie można a które wpływają na wykonanie umowy w całości lub w części.

Wyrażona w w/w przepisach dyrektywa interpretacyjna jest podstawą do dokonania systemowej wykładni, która wskazuje, że Zamawiający powinien ograniczyć odpowiedzialność, za okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19.

Mając na względzie powyższe, Spółka zwraca się z następującym pytaniem do Zamawiającego:

Czy Zamawiający zmieni §15 ust. 1 Umowy i doda do katalogu przykładowych okoliczności uznawanych za siłę wyższą również „kryzys epidemiczny”?

Odpowiedź:

Zamawiający w §16 ust. 3 pkt 2 przewidział w umowie zmiany w obowiązujących przepisach mających wpływ na przedmiot i warunki umowy.

Zestaw XI

Załącznik nr 8: zadanie 23. Stoły operacyjne

1. Punkt 6 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który nie posiada dodatkowego piątego koła sterującego, aktywowanego przyciskiem na pilocie? Oferowany stół posiada podstawę Supermobil- na dużych kołach, o średnicy 150 mm dzięki czemu bardzo łatwo manewruje się stołem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. Punkt 12 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o całkowitej szerokości blatu bez szyn akcesoryjnych 57 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

3. Punkt 13 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości (bez materacy) w zakresie: 58, 5cm- 105 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

4. Punkt 18 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym pozycję :Beach chair” uzyskuje się za pomocą 4 przycisków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

5. Punkt 22 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem zabezpieczonym przed przypadkowym uruchomieniem poprzez konieczność naciśnięcia jednego przycisku ale dwa razy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

6. Punkt 23 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją pochylenia dzielonego segmentu nożnego $+35^{\circ}$ / -90° ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

7. Punkt 26 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kąta ustawienia podglówka $+45^{\circ}$ / -30° ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


8. Punkt 30 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym blokowanie/ odblokowywanie stołu do podłoża następuje za pomocą centralnej blokady kół, uruchamianej za pomocą 1 przycisku, który znajduje się zarówno na pilocie, jak i na panelu sterującym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

9. Punkt 32 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podpórki do ułożenia bocznego o następującym opisie i parametrach technicznych:

służy do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, stosowany z obu stron pacjenta. Składa się z materaca o walcowatym kształcie o wymiarach: $\varnothing$ 80 mm x 300 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta. Podpórka nie posiada przegubu kulowego.

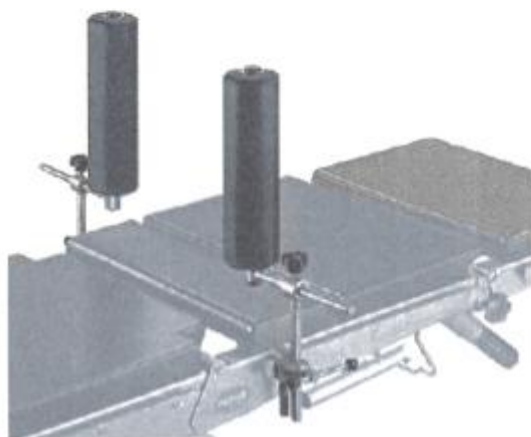

Odpowiedź:

Pytanie niepełne w zapytaniu Wykonawcy brak części treści pytania. Zamawiający nie rozumie pytania.

13. Punkt 32 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podpórkę ręki o następującym opisie i parametrach technicznych:

Podpórka służy do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, wyposażona w materac z pianki poliuretanowej obszytej skajem. Wymiary: 40 mm x 200 mm x 600 mm. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej. Podpórka nie posiada przegubu kulowego.




Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

14. Punkt 32 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podpórkę ręki o następującym opisie i parametrach technicznych:

Podpórka służy do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta. Wyposażona w materac wykonany z pianki poliuretanowej obszytej skajem. Wymiary 60 mm x 250 mm x 380 mm. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowne ustawienie powierzchni materaca, a także zmianę odległości i wysokości podpórki od blatu stołu. Podpórka nie posiada przegubu kulowego.

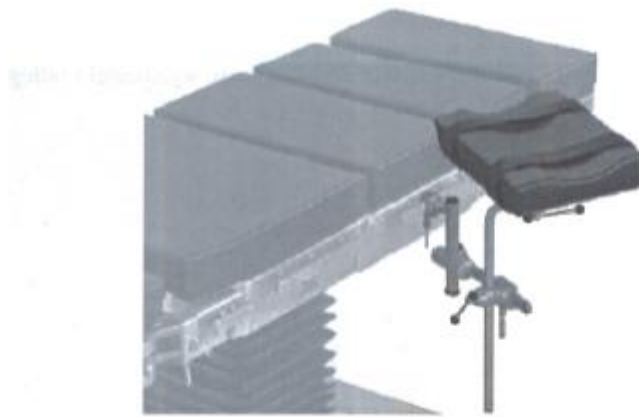

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

15. Punkt 34 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podglówek Specjalistyczny o poniższym opisie i parametrach technicznych:


Podglówek Specjalistyczny służy do podpierania głowy pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu, na plecach i w pozycji bocznej. Składa się z materaca poliuretanowego w kształcie podkowy o wymiarach 70 x 190 x 235 mm oraz szkieletu metalowego, wykonanego ze stali nierdzewnej. Konstrukcja podglówka, dzięki dwóm obrotowym węzłom, zapewnia regulację wysokości, pochylecia kąтового oraz wzdłużnego materaca.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

16. Punkt 35 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który nie posiada dodatkowego segmentu blatu o długości 25 cm? Oferowany stół jest stołem operacyjnym, składającym się z 6 segmentów i nie wymaga dodatkowych blatów. Zdjęcie poglądowe poniżej:

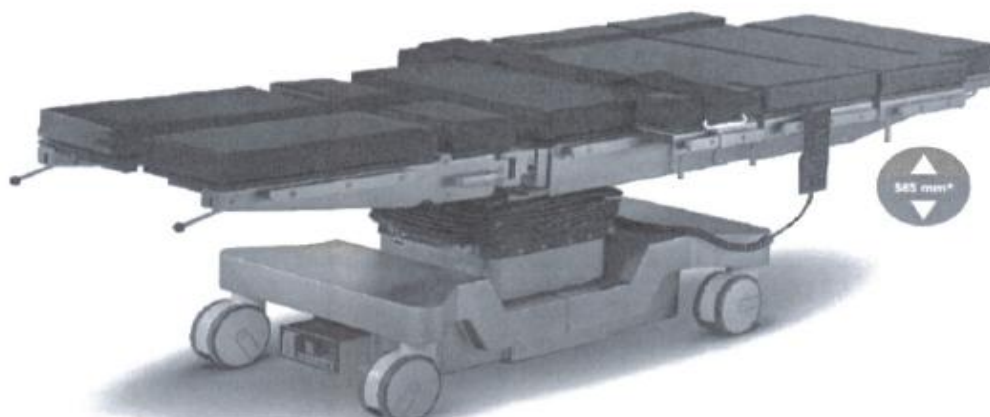

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zestaw XII

Lampa nr 1

Lp.4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową 150klux wyposażoną w diody LED, w której temperatura barwowa regulowana jest w 5 krokach w zakresie 3100 – 5000 K?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Lampa nr 2

Lp.5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową 70klux, w której średnica pola światła wynosi 250-180 mm (1m)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw XIII

Część nr 35– OPTYKA ENDOSKOPOWA

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 światłowód kompatybilny z optyką, o długości 250 cm i średnicy 4,8 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian ?



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Dot. SIWZ

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 14 ust. 1:

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 3 lub dostaw niezgodnych z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości, w wysokości 0,5% za każdy dzień roboczy (poniedziałek – piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) opóźnienia licząc od wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem, że termin opóźnienia nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej w terminie lub niezgodnej części dostawy**

2) jeżeli opóźnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 przekroczy 2 dni robocze, za każdy kolejny dzień opóźnienia w wysokości **0,5% niewykonanej części** umowy brutto, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto **niewykonanej w terminie części** Umowy,

3) za opóźnienie czynności określonych w § 12 ust. 8 w wysokości 0,2% za każdy dzień roboczy (poniedziałek – piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od wartości części umowy brutto, **której dotyczy naprawa**, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto **danej części** Umowy,

4) w przypadku niedotrzymania terminu przeglądu technicznego przewidzianego przez producenta sprzętu, o którym mowa w § 12 ust. 13 oraz dokonania wpisu w dokumentacji urządzenia (np. w paszporcie technicznym) w wysokości **200,00 zł** brutto za każdy dzień roboczy (poniedziałek – piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)

opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części Umowy, której dotyczy niewykonany w terminie przegląd,

5) w przypadku niedotrzymania terminu i zakresu szkoleń personelu o których mowa w § 10 w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień roboczy (poniedziałek – piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) nienależytego wykonania umowy bądź niewykonania umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczy niewykonane w terminie szkolenie

6) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

7) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

8) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, w przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zestaw XIV

Pytanie 1. Dot. LAMPY CHIRURGICZNEJ CZOŁOWEJ ZADANIE 8, POZYCJA 1

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej JAKOŚCIOWO I CENOWO - prosimy o wydzielenie (z osobną kwotą wadium) dopuszczenie **również** lampy przenośnej o ultra-lekkim czepcu z opatentowaną podporą potylicy – przeznaczonej także do wielogodzinnych procedur (w tym neuro i kardiochirurgicznych), **produkowanej w 100% w USA, u renomowanego producenta – LIDERA systemów ultra-lekkich czołowych w technologii LED w Stanach Zjednoczonych i Europie** o następujących parametrach technicznych:

Lp	Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne i funkcjonalne	Parametry wymagany
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: min. 2019.	Tak
2.	Lampa czołowa ze światłem	Tak
3.	Lampa czołowa ze światłem o temperaturze barwowej 4500° Kelvina	Tak
4.	Wskaźnik odwzorowania koloru (CRI) > 90	Tak
5.	Specjalny wskaźnik dla koloru czerwonego: R9 > 75	Tak
6.	Natężenie światła: > 60.000 lx w odległości ok. 25 cm (+/- 5%)	Tak
7.	Technologia lampy: LED HQ	Tak
8.	Regulacja pola oświetlenia w zakresie od 20mm do 110mm średnicy	Tak
9.	Płynna regulacja jasności	Tak
10.	Regulacja pochyleń lampy na czepcu (przegub lampy na czepcu)	Tak
11.	Lampa wyposażona w akumulator pozwalający na min. 3 godziny pracy bez ładowania	Tak Czas pracy 3 – 5 h – 0 pkt, pow.

		5 h – 10 pkt.
12.	Ładowarki do ładowania min. 2 akumulatorów lampy jednocześnie	Tak
13.	Możliwość szybkiej wymiany baterii umożliwiającej kontynuację pracy w polu operacyjnym	Tak
14.	Torba do przechowywania lampy i akcesoriów	Tak

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw XV

Dotyczy lampa bezcieniowa min. 120 000 lx

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej regulowanej w 3 krokach, w zakresie 3800-4400-5000 K, czyli w przedziale zbliżonym do oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze średnicą kopuły wynoszącą 67 cm (75 cm wraz z otaczającym ją relingiem) i średnicą soczewki pojedynczej diody wynoszącą 3,3 cm, co zapewnia doskonale parametry świetlne urządzenia? Większa średnica kopuły zapewnia większą bezcieniowość, a średnica pojedynczego odbłyśnika nie ma żadnego znaczenia użytkowego dla odbiorcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy lampa bezcieniowa min. 55 000 lx

Pyt. 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze stałą średnicą pola światła, mieszczącą się w przedziale 300-150 mm w odległości 1 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której włączenie i wyłączenie oraz regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% odbywa się płynnie, poprzez obrót uchwyty sterylnej? Pozwala to na regulację parametru ze strefy sterylnej i jest rozwiązaniem lepszym niż panel na czaszy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw XVI

Zadanie 7. Lampy bezcieniowe

pkt. 4 zał.8 FWT-WG

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z możliwością ustawiania temperatury barwowej w zakresie 4500-5000 st K? W przypadku lamp zabiegowych jest to wystarczający i optymalny zakres pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw XVII

Zadanie 21. Pulsoksymetry

poz. 2 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu analizy APG

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

poz. 3 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wyświetlania funkcji APG.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

poz.6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jasnego, czytelnego wyświetlacza TLT

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wagi ok 130 g wraz z bateriami.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zadanie 16. Zestaw pomp infuzyjnych

poz. 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiaru stacji dokującej szer. 205 cm x wys.815 cm x gł. 250 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

poz. 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie statywu o Stabilnej konstrukcji zapewniającej wygodne i bezpieczne mocowanie stacji dokujących i pomp. Wymiary w mm (szer./wys./gł.) 480 x 1560 x 530 Waga 15 kg. Maksymalne obciążenie 35 kg. Z możliwością montażu klemy do średnic 20 – 36 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

poz. 20 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu montowania strzykawki automatycznie od czoła pompy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

poz. 22 Czy zamawiający wymaga pompy w której programowanie i sterowanie pompy jest używane przy pomocy ekranu dotykowego i klawiatury alfanumerycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

poz.39 Prosimy o dopuszczenie opcji przeliczenia w zakresie 0,1 do 4,5 m2, przyrost co 0,01 m2. Waga: od 0,1 kg do 300 kg, z przyrostem co 0,01 pomiędzy 0,1 do 9,99 kg; z przyrostem 0,1 kg pomiędzy 10 a 99,9 oraz 1kg od 100 do 300 kg, czyli przyrost co 10 g jest możliwy od 0,1 do 9,99 kg, potem co 100 g, a potem co 1kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

poz. 40. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego manualnego przesunięcia tłoka strzykawki z funkcją zliczania prezentacji podanej objętości na ekranie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

poz. 44 Czy Zamawiający dopuści 12 progów poziomu ciśnienia okluzji z trzema jednostkami do wyboru mmHg, kPa, PSI.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

poz. 52. Czy Zamawiający dopuści pompę posiadającą dodatkowe elementy łączące pompy w moduły?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

poz. 63 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu urządzenia przystosowanego w pracy w środowisku elektromagnetycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

poz. 69 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wagi 2,3kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

poz. 7 Czy Zamawiający dopuści ciśnienie okluzji programowane w zakresie 75-900 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zadanie 18. Zestaw pomp infuzyjnych

poz. 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu montowania strzykawki automatycznie od czoła pompy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

poz. 24. Prosimy o dopuszczenie opcji przeliczenia w zakresie 0,1 do 4,5 m², przyrost co 0,01 m². Waga: od 0,1 kg do 300 kg, z przyrostem co 0,01 pomiędzy 0,1 do 9,99 kg; z przyrostem 0,1 kg pomiędzy 10 a 99,9 oraz 1kg od 100 do 300 kg, czyli przyrost co 10 g jest możliwy od 0,1 do 9,99 kg, potem co 100 g, a potem co 1kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

poz. 29 Czy Zamawiający dopuści 12 progów poziomu ciśnienia okluzji z trzema jednostkami do wyboru mmHg, kPa, PSI.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

poz. 37. Czy Zamawiający dopuści pompę posiadającą dodatkowe elementy łączące pompy w moduły?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

poz.88 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie czasu pracy baterii/akumulatora przy pełnym naładowaniu 5h przy 1200 ml/h.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw XVIII**Dotyczy: zadanie 13 – Meble medyczne, Kozetka lekarska**

1. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści całkowitą długość leża 178 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści szerokość leża 62 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wysokość – zakres regulacji 57-87 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści 2 koła ułatwiające przetaczanie stołu i 2 nylonowe stopki bez regulacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: zadanie 13 – Meble medyczne, Parawan metalowy dwuczęściowy

5. Prosimy (w pkt. 5) o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby parawan posiadał wypełnienie zasłonką z materiału – poliestru z powłoką wodoodporną (6 kolorów do wyboru), czy wypełnienie z białej płyty z tworzywowa PC poliwęglan?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: zadanie 13 – Meble medyczne, Stolik zabiegowy

6. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści stolik zabiegowy wykonany ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wymiary stolika: szerokość 72 cm, głębokość 61 cm, wysokość 108 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw XIX

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dokona wyodrębnienia z pakietu (zadania) nr 8 o treści LAMPY CZOŁOWE dwóch zawartych w nim zadań, do dwóch oddzielnych pakietów, co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty na każde z zadań w pakiecie nr 8?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zestaw XX

Zadanie nr 13. Meble medyczne

Poz. 2: Parawan dwuczęściowy wykonany z metalowych rurek

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan metalowy dwuczęściowy z ekranem parawanu wykonanym z poliestru z wodoodporna powłoką z możliwością prania i dezynfekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3: Stolik zabiegowy

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy o szerokości 670mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy o głębokości 570mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw XXI

1. Załącznik Nr 8. Formularz wymagań technicznych – warunków granicznych

Zadanie 16. Zestaw pomp infuzyjnych

Punkt 61. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego min. 8 godz. przy przepływie 25 ml/godz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. Załącznik Nr 8. Formularz wymagań technicznych – warunków granicznych

Zadanie 18. Pompy infuzyjne strzykawkowe

Punkt 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z zasilania z akumulatora wewnętrznego min 6 godz. przy przepływie 5 ml/godz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Załącznik Nr 8. Formularz wymagań technicznych – warunków granicznych

Zadanie 37. Pompa infuzyjna strzykawkowa dwutorowa

Punkt 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z prędkością dozowania: min. 0,1 – 1200 ml/h

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Punkt 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z czasem infuzji min. 96 godz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Punkt 13. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z dokładnością dozowania: max. $\pm 3\%$

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Punkt 14. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z prędkością KVO: $0 \div 5$ ml, programowana co 0,1 ml/h. Przy czym 0 – KVO wyłączone

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw XXII

1. Dotyczy zad. 4 pozycja 2 - Fotel toaletowy sanitarny (Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych)- pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 103,5 cm, co nieznacznie różni się od wymaganej wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy zad. 4 pozycja 2 - Fotel toaletowy sanitarny (Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych)- pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości siedziska 48 cm, co nieznacznie różni się od wymaganej wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy zadania 4 pozycja 3 - Fotel ginekologiczny

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji do osobnego zadania, co umożliwi zwiększyć konkurencję, a co za tym idzie umożliwi uzyskanie ofert o niższych cenach i lepszych warunkach realizacji zamówienia?

Dzięki temu Zamawiający lepiej zadba o finanse szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

4. Dotyczy zadania 4 pozycja 4- Fotel zabiegowy (Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej)

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji do osobnego zadania, co umożliwi zwiększyć konkurencję, a co za tym idzie umożliwi uzyskanie ofert o niższych cenach i lepszych warunkach realizacji zamówienia?

Dzięki temu Zamawiający lepiej zadba o finanse szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

5. Dotyczy zadania 4 pozycja 5- Fotel zabiegowy (Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej)

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji do osobnego zadania, co umożliwi zwiększyć konkurencję, a co za tym idzie umożliwi uzyskanie ofert o niższych cenach i lepszych warunkach realizacji zamówienia?

Dzięki temu Zamawiający lepiej zadba o finanse szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

6. Dotyczy zadania 13 pozycja 1- Kozetka lekarska- pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o długości całkowitej 186 cm oraz szerokości leża 63 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy zadania 13 pozycja 1- Kozetka lekarska- pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści kozetkę wyposażoną w dwa niezależne systemy: transportowy i stacjonarny do bezpiecznego i stabilnego posadowienia w czasie wykonywania procedur medycznych? System transportowy oparty jest na 4 chowanych kołach, z których każde jest wyposażone w niezależny hamulec.

System stacjonarny jest oparty na 4 stopach z czego jedna jest wyposażona w specjalny system poziomowania gwarantujący bezpieczne posadowienie nawet przy nierównościach podłogi. Jest to rozwiązanie stabilniejsze i bezpieczniejsze od wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy zadania 13 pozycja 4- Wózek do badań i transportu chorych

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji do osobnego zadania, co umożliwi zwiększy konkurencję, a co za tym idzie umożliwi uzyskanie ofert o niższych cenach i lepszych warunkach realizacji zamówienia?

Dzięki temu Zamawiający lepiej zadba o finanse szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

9. Dotyczy zadania 27 pozycja 1-5: Wózek zabiegowy – OIT/ Wózek zabiegowy – Chirurgia/ Wózek zabiegowy – Neurochirurgia/ Wózek zabiegowy – Chirurgia szczękowo-twarzowa/ Wózek zabiegowy – Endoskopia

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, Zamawiający oczekuje wózków lakierowanych farbami o właściwościach antybakteryjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

10. Dotyczy zadania 27 pozycja 6- Wózek do przewożenia chorych – Chirurgia

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji do osobnego zadania, co umożliwi zwiększy konkurencję, a co za tym idzie umożliwi uzyskanie ofert o niższych cenach i lepszych warunkach realizacji zamówienia?

Dzięki temu Zamawiający lepiej zadba o finanse szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

11. Dotyczy zadania 27 pozycja 10-11: Wózek medyczny zabiegowy – Otorinolaryngologia/Wózek oddziałowy – Laryngologia- pytanie 1

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie wózka wykonanego ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo? Nadmieniamy, iż zarówno blacha ocynkowana, jak i ze stali kwasoodpornej nie ulega procesowi korozji, jak również może być stosowana w środowisku wilgotnym, tym bardziej, że Zamawiający oczekuje wózka lakierowanego proszkowo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

12. Dotyczy zadania 27 pozycja 10-11: Wózek medyczny zabiegowy – Otorinolaryngologia/Wózek oddziałowy – Laryngologia- pytanie 2

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Zamawiający oczekuje wózków lakierowanych farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi o właściwościach antybakteryjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

13. Dotyczy zadania 27 pozycja 1-5 i 10-11: Wózek zabiegowy – OIT/ Wózek zabiegowy – Chirurgia/ Wózek zabiegowy – Neurochirurgia/ Wózek zabiegowy – Chirurgia szczękowo-twarzowa/ Wózek zabiegowy – Endoskopia/ Wózek medyczny zabiegowy – Otorinolaryngologia/ Wózek oddziałowy – Laryngologia- pytanie 1

Czy Zamawiający oczekuje wózków wykonanych w technologii podwójnej ścianki z wygłuszeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy zadania 27 pozycja 1-5 i 10-11: Pytania do Wózek zabiegowy – OIT/ Wózek zabiegowy – Chirurgia/ Wózek zabiegowy – Neurochirurgia/ Wózek zabiegowy – Chirurgia szczękowo-twarzowa/ Wózek zabiegowy – Endoskopia/ Wózek medyczny zabiegowy – Otorinolaryngologia/ Wózek oddziałowy – Laryngologia- pytanie 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby producent wózków posiadał wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością, zgodnie z EN ISO 13485:2016?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

15. Dotyczy zadania 27 pozycja 7: Wózek prysznicowy, toaletowy – Wewnętrzny- pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja jest wykonana z trwałego i mocnego aluminium odpornego na wilgoć?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

16. Dotyczy zadania 27 pozycja 7: Wózek prysznicowy, toaletowy – Wewnętrzny- pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości całkowitej 1035 mm, co nieznacznie różni się od wymaganej wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

17. Dotyczy zadania 27 pozycja 7: Wózek prysznicowy, toaletowy – Wewnętrzny- pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści trwałe oznaczenie wózka na obudowie inne niż grawerowanie lub oznaczenie laserowe np. przynitowanie blaszki z wygrawerowanym lub oznaczeniem laserowym oczekiwanego napisu USK Olsztyn i przyzna za takie oznaczenie 10 pkt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

18. Dotyczy zadania 27 pozycja 8: Wózek inwalidzki do transportu pacjentów

Czy Zamawiający dopuści trwałe oznaczenie wózka na obudowie inne niż grawerowanie lub oznaczenie laserowe np. przynitowanie blaszki z wygrawerowanym lub oznaczeniem laserowym oczekiwanego napisu USK Olsztyn i przyzna za takie oznaczenie 10 pkt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

19. Dotyczy zadania 27 pozycja 9: Krzesło do przewożenia pacjentów- pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 71 cm, co nieznacznie różni się od wymaganej wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

20. Dotyczy zadania 27 pozycja 9: Krzesło do przewożenia pacjentów- pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści trwałe oznaczenie wózka na obudowie inne niż grawerowanie lub oznaczenie laserowe np. przynitowanie blaszki z wygrawerowanym lub oznaczeniem laserowym oczekiwanego napisu USK Olsztyn i przyzna za takie oznaczenie 10 pkt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw XXIII

Zadanie 7 Lampa bezcieniowa:

Pytanie 1: Tabela 1 pkt 4: Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową z regulowaną w 3 krokach temperaturą barwową w zakresie 3800°K / 4300°K / 4800°K ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Tabela 1 pkt 5: Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową z wyselekcjonowanymi diodami LED najnowszej technologii (najwyższe współczynniki odwzorowania na rynku) oraz z soczewkami wykonanymi w oparciu o „Technologię wielu soczewek” tj. połączenie soczewki centralnej; systemu soczewek Fresnela oraz soczewki TIR + mikrostruktura na powierzchni modułu (dla gładkiego, jednorodnego światła)? Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy jednorodne światło w polu operacyjnym jak również całkowicie ograniczony efekt oślepienia operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Tabela 1 pkt 6: Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową o konstrukcji zwartej, bez połączeń śrubowych, z bezszwową pokrywą soczewek ze zintegrowanymi uszczelkami oraz konstrukcją pozwalającą użytkownikowi na samodzielną wymianę modułów świetlnych bez konieczności otwierania obudowy czaszy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Tabela 2 pkt 5: Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o średnicy pola światła 170 mm z odległości 1m? Dzięki wysokim współczynnikom odwzorowania światła oraz dużej wartości głębokości oświetlenia wynoszącego 164,5cm, zakres pracy lampy pozwala na odsunięcie jej na dystans ponad 1,6m nie tracąc tym samym parametrów świetlnych w polu operacyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw XXIV

Zadanie nr 7

I Lampa bezcieniowa zabiegowa, jezdna (1 szt.), pierwsza:

1. Czy Zamawiający dopuści płynną i szerszą regulację temperatury barwowej w zakresie 3700-6700K?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści diody LED z soczewkami sferycznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 6 dopuści lampę o średnicy całkowitej 500 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

II Lampa bezcieniowa zabiegowa, jezdna (1 szt.), druga:

1. Czy Zamawiający dopuści średnicę pola świetlnego 270-150 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw XXV

Zadanie 1

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie krążka obrotowego o antypoślizgowej powierzchni, przeznaczonego do transferu / obracania pacjenta, o średnicy 42 cm, udźwigiem do 135 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu, zszytego w formie rękawa, wykonanego z materiału o właściwościach ślizgowych, o wymiarach 60 x 41 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Lub

Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu, zszytego w formie rękawa, wykonanego z materiału o właściwościach ślizgowych wewnątrz oraz miękkiego materiału zewnętrznego, o wymiarach 50 x 60 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 3

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zadanie 3

Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z jedną prędkością podnoszenia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pkt. 15, 16

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z 4 punktowym wieszakiem (po 2 zaczepy po każdej ze stron), posiadającym zaczepy, na które mocuje się uchwyty nosidła

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pkt. 17, 19

Prosimy o dopuszczenie maksymalnej wysokości podnoszenia 181 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pkt. 18

Prosimy o dopuszczenie minimalnej wysokości podnoszenia 60 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pkt. 20

Prosimy o dopuszczenie zakresu podnoszenia od 60 do 181 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pkt. 21

Prosimy o dopuszczenie maksymalnej szerokości podstawy jezdnej 98 cm, przy rozłożonej podstawie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pkt. 20

Prosimy o dopuszczenie minimalnej szerokości podstawy jezdnej 65 cm, przy złożonej podstawie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pkt. 25

Prosimy o dopuszczenie podwieszki z 3 poziomami zawieszania, oznaczonymi kolorystycznie i przyznanie za ten parametr odpowiedniej ilości punktów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zadanie 12

Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie materaca próżniowego, zbudowanego z elastycznej i trwałej foli PUR - folia poliuretanowa (biokompatybilna) z wypełnieniem z mikrokulek styropianowych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 20

Poz. 18, 19

Prosimy o podanie, czy Zamawiający oczekuje pozycjonerów pięć po 1 sztuce czy po jednej parze z każdego rozmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje po 1 szt.

Zestaw XXVI

Pytanie 1 - dotyczy zadania 35 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści endoskopy bez nadruku informującego o śr. kompatybilnego światłowodu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 2 - dotyczy zadania 35 poz. 6

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając światłowody o śr. 2.5 mm zamiast 3.5 mm. Światłowód o śr. 3.5 mm dedykowany jest do optyki o śr. 4.0 mm. Prosimy o dopuszczenie światłowodów o śr. 3.5 mm i dł. 230 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 3– dotyczy zadania 8 lampa czołowa ze światłem poz. 3

Czy Zamawiający dopuści lampę czołową ze światłem o temperaturze barwowej w granicach 2800 – 6500 Kelvina. Do wyboru przez użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4 – dotyczy zadania 8 lampa czołowa ze światłem poz. 4,5

Prosimy o dopuszczenie lampy czołowej bez podania parametrów odwzorowania koloru i wskaźnika dla koloru czerwonego. Parametry te nie są podawane przez większość renomowanych producentów lamp czołowych. Zwiększy to konkurencyjność oferty i obniży cenę zakupu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 5 - dotyczy zadania 8 lampa czołowa ze światłem poz. 6

Prosimy o dopuszczenie lampy czołowej o natężeniu światła 80 000 lx w odległości ok. 25 cm. Lampa jest wyposażona w ręczną płynną regulację jasności.

Odpowiedź:

80 000 lx mieści się w wymaganiach (min. 50 000lx).

Pytanie 6 - dotyczy zadania 8 lampa czołowa poz. 4

Czy Zamawiający dopuści lampę czołową o temperaturze barwowej w granicach 2800 – 6500 Kelvina. Do wyboru przez użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 7 – dotyczy zadania 8 lampa czołowa poz. 7

Czy Zamawiający dopuści lampę bez regulacji wielkości diagnozowanego pola. W przypadku lampy wyposażonej w lustro jest to niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zestaw XXVII

1. Pakiet 18, poz. 3, 18, 20

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z systemem mocowania strzykawki w trybie pół-automatycznym, przy włączonej pompie? Dzisiejsze nowoczesne systemy infuzyjne posiadają zabezpieczenia przed podaniem przypadkowego bolusa przy instalowaniu strzykawki przez nadmierne dosunięcie głowicy pompy do tłoka, niemniej żadne z nich nie funkcjonują przy wyłączonej pompie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Pakiet 18, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści pompę z bolusem typu Emergency (tzw. „bolus z ręki”) poprzez ciągłe trzymanie naciśniętego przycisku na pompie, uruchamiającego natychmiast podaż bolusa (ze stałą, programowalną prędkością), oferującą dodatkowy 3 rodzaj bolusa w funkcji czasu (wyliczenie prędkości)? Opisane rozwiązanie: „manualne przesunięcie popychacza” może stwarzać zagrożenie dla pacjenta, ponieważ przy takiej podaży nie ma kontroli nad prędkością podaży bolusa, a tym samym jego ciśnieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Pakiet 18, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w 9 poziomów programowania ciśnienia okluzji od 0,2 do 1,2 bara, określane w jednostkach wyłącznie mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Pakiet 18, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści zamiennie pompę o parametrach prędkości infuzji programowanej co 0,01 ml/h w pełnym zakresie, od 0,01 – 999,9 mln/h?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Pakiet 18, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści zamiennie pompę z możliwością programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Pakiet 18, poz. 33

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, o jaką dokładnie funkcję chodzi, ponieważ wydaje się, że wybór stężenia jest pomiędzy dwiema takimi jednostkami: „jedn. / ml”? ?

Odpowiedź:

Funkcja programowania rozcieńczenia: X jednostek/ml lub X jednostek/V ml.

7. Pakiet 18, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową w wyposażoną w system alarmów, w którym pompa zamiennie do alarmu odłączenia zasilania sygnalizuje odłączenie od zasilania przy pomocy odpowiedniego piktogramu widocznego na ekranie? Pompa automatycznie przechodzi w tryb zasilania akumulatorowego, w którym co najmniej pół godziny przed wyczerpaniem akumulatora powiadamia użytkownika alarmem wizualno-akustycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw XXVIII

Zadanie nr 4. Fotele zabiegowe

Poz. 1: Fotel do pobierania krwi z regulowanym oparciem (Klinika Otorinolaryngologii)

1. W związku z wymogiem uzyskania pozycji leżącej i półleżącej (poz. 5.), Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do pobierania krwi z segmentem nóg regulowanym za pomocą sprężyny gazowej? Bez zastosowania w takim fotelu segmentu nóg nie mam możliwości uzyskania pozycji leżącej oraz półleżącej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o całkowitej szerokości fotela z podłokietnikami 920mm? Nadmienię, że nie są osiągalne na rynku fotele o szerokości 1350-1500mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o szerokości siedziska (części tapicerowanej, bez wyposażenia) 600mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi bez dodatkowego wyposażenia w postaci blatu zabiegowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Poz. 3: Fotel ginekologiczny

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z podstawą w zaproponowanym kształcie podwójnej litery Y zobrazowanym na zdjęciu poniżej, zapewniającą pełną stabilizację całej konstrukcji? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.



Zdjęcie poglądowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o szerokości leża 600mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z leżem o długości 1675mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z segmentem pleców o długości 840mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z odejmowanym segmentem nóg o długości 415mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z odejmowanym segmentem nóg o długości 430mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z podstawą wyposażoną w 4 podwójne koła o średnicy 75mm, wszystkie koła z indywidualną blokadą montowane na stałe oraz system poziomowania gwarantujący bezpieczne posadowienie fotela również przy nierównościach podłoża?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulację wysokości, segmentu pleców i siedziska regulowanym za pomocą sterownika nożnego wbudowanego w podstawę fotela?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 600-900mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie -50/+750?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4: Fotel zabiegowy regulowany elektrycznie (Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej)

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 600-850mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z obciążeniem na poziomie 160kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Poz. 5: Fotel zabiegowy (Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej)

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z obciążeniem na poziomie 160kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zadanie nr 7. Lampy bezcieniowe

Poz. 1: Lampa bezcieniowa zabiegowa, jezdna – 1 szt.

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze stałą temperaturą barwową równą 4400K? Jest to jedna z wartości zamieszczonych w tabeli (Zał. 8).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z trzema odbłyśnikami o średnicy 155mm każdy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z sześcioma odbłyśnikami o średnicy 155 mm każdy i z siódmym o średnicy 230mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 2: Lampa bezcieniowa zabiegowa, jezdna – 1 szt.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o średnicy pola światła d10=220mm i d50=110mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 13. Meble medyczne

Poz. 1: Kozetka lekarska

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o szerokości leża 620mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 540-900mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z podstawą wyposażoną w 4 podwójne koła oraz system chowanych kół w celu posadowienia stołu na konstrukcji podstawy wyposażonej w 4 podgumowane stopki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 3: Stolik zabiegowy

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy o szerokości 500mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy z blatem wykonanym ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Poz. 4: Wózek do badań i transportu pacjentów

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do badań i transportu pacjentów o długości 2150mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do badań i transportu pacjentów o szerokości 830mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do badań i transportu pacjentów o wymiarach leża 1950x710mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do badań i transportu pacjentów z segmentem pleców regulowanym w zakresie 0 do 870? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do badań i transportu pacjentów z segmentem uda regulowanym w zakresie 0 do 350? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do badań i transportu pacjentów z segmentem podudzia regulowanym w zakresie 0 do 300? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do badań i transportu pacjentów wyposażony w materac o grubości 100mm? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 24. Stoły zabiegowe

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o nośności 225kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu pleców wspomaganą sprężyną gazową?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu pleców w zakresie 0 do 800°?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o szerokości 620mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Zestaw XXIX

Pytania do zadania nr 4, Fotel zabiegowy (Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej)

Pyt. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści fotel o nieznacznie krótszej długości – 186 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania do zadania nr 4, Fotel ginekologiczny

Pyt. Nr 1 dot. Pkt 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotelu ginekologicznego w którym elektrycznie sterowana jest wysokość siedziska, nachylenie siedziska oraz nachylenie oparcia. Z opisu przedmiotu zamówienia nie wynika jasno jakie funkcje mają być regulowane elektrycznie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 2 dot. Pkt 6, 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu o konstrukcji w kształcie wydłużonego i rozjeżdżającego się „H” z leżem 3-sekcyjnym, tapicerowanym materiałem skóro podobnym o właściwościach trudnopalnych. Rozwiązanie takie jest równoważne do opisanego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 3 dot. Pkt 8, 9, 10, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu o całkowitej długości 1800 mm (3 sekcje) i 1350 mm (po odjęciu ostatniej sekcji) z oparciem (długość: 900mm) i sekcją siedziska z wycięciem litotomijnym (długość 385 mm) o szerokości 600 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 4 dot. Pkt 12, 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela osadzonego na 4 podwójnych kołach Ø100 mm z niezależnymi hamulcami, które gwarantują bezpieczne posadowienie nawet przy nierównościach podłogi. Rozwiązanie to jest równoważne do opisanego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 5 dot. Pkt 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela o wymiarach leża 1800 x 600 mm. Rozwiązanie to różni się nieznacznie względem opisanego i zapewnia większą niż opisana powierzchnię dla pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 6 dot. Pkt 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela o wysokości regulowanej w zakresie 470 mm do 1000mm. Jest to szerszy zakres niż opisany, a co za tym idzie jest to rozwiązanie nadrzędne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 7 dot. Pkt 17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela o regulowanym oparciu w zakresie -8° do 58°. Jest to nieznaczna różnica względem wymaganych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 8 dot. Pkt 23 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela wyposażonego w:

- ☐ podpory Goepel'a
- ☐ misa ze stali nierdzewnej montowana na obrotowym wysięgniku
- ☐ regulowane podpory na ręce
- ☐ uchwyt na prześcieradło jednorazowe
- ☐ wysięgnik na płyny infuzyjne

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania do zadania nr 7

Pytania do pierwszej lampy zabiegowej

Pyt. Nr 1 dot. Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści lampę o zmiennej temperaturze barwowej w zakresie 3500 /4000 /4500 /5000 /5500 K? Proponowane rozwiązanie jest nadrzędne względem opisanego bo zapewnia większy zakres regulowanej temperatury.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 2 dot. Pkt 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o średnicy czoła 586mm. Jest to minimalna różnica względem opisanego rozwiązania i nie wpływa na funkcjonalność lampy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania do drugiej lampy zabiegowej

Pyt. Nr 1 dot. Pkt 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy zabiegowej regulowanej za pomocą regulatora na czaszy lampy. Proponowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 2 dot. Pkt 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy zabiegowej o średnicy pola światła 140 mm. Różnica ta jest nieznaczna i nie wpływa negatywnie na użytkowanie lampy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 3 dot. Pkt 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy zabiegowej o temperaturze barwowej 4900K. Proponowane rozwiązanie jest wyższe od wymaganego i zapewnia światło o barwie białej/chłodno białej pozwalające na bardzo dokładne odwzorowanie kolorów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 4 dot. Pkt 8 Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony jeżeli oferowana lampa charakteryzuje się emisją ciepła nie większą niż 1°C. Pragniemy zauważyć, że przy obecnym zapisie żaden oferent nie jest w stanie złożyć oferty, ponieważ nie istnieje światło nie emitujące ciepła.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytania do zadania 13 – Parawan metalowy dwuczęściowy

Pyt. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści parawan wykonany z rurek pokrytych farbą chromowaną, co gwarantuje stabilność i trwałość? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania do zadania 13 – kozetka lekarska

Pyt. Nr 1 Czy Zamawiający dopuści kozetkę o regulacji zagłówka +400? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania do zadania 13 – stolik zabiegowy

Pyt. Nr 1 dot. Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy o konstrukcji wykonanej ze stali spawanej (bez elementów skręcanych) z blatem i frontami szuflad z polietylenu oraz uchwytem z poliamidu? Takie rozwiązanie jest nadrzędne względem opisanego.

Zastosowane materiały mają bardzo wysoką odporność jednocześnie będąc lekkimi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 2 dot. Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści blat roboczy zagłębiony z polietylenu o wysokiej odporności m. in na 100% czysty alkohol, wybielacze, detergenty, roztwory mydła, oleje, lakiery, roztwory amoniowe i inne? Blat jest zaokrąglony zarówno zewnątrz jak i wewnątrz zagłębienia. Proponowane rozwiązanie jest nadrzędne do opisanego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 3 dot. Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści wózek z większą ilością szuflad do wyboru na etapie zamówienia? Proponowane rozwiązanie jest nadrzędne względem opisanego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pyt. Nr 4 dot. Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 640x480x1043?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 5 dot. Pkt. 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kosza na odpady z pokrywą na pedał o pojemności 25l. zamiast stelaża. Proponowane rozwiązanie jest nadrzędne względem wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania do zadania 24

Pyt. Nr 1 dot. Pkt. 3, 9 Czy Zamawiający dopuści stół 2 sekcyjny? Stoły zabiegowe ze względu na specyfikę nie mają potrzeby posiadania więcej niż 2 sekcji, takie rozwiązanie może natomiast znacząco zwiększać cenę i narazić zamawiającego na wyższe koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pyt. Nr 2 dot. Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji sekcji pleców od 0° do 73°. Różnica na tym poziomie jest nieznaczna i nie wpływa na funkcjonalność stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 3 dot. Pkt. 11, 12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu stojącego w czasie wykonywania zabiegów na 4 podwójnych kołach blokowanych hamulcem centralnym. Jest to rozwiązanie równoważne do opisanego i łatwiejsze w obsłudze.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania do zadania 25

Pyt. Nr 1 Czy Zamawiający dopuści system ucisku sekwencyjnego do profilaktyki przeciwzakrzepowej żył głębokich (DVT), równoważny do opisanego w SIWZ:

Aparat (system) ucisku sekwencyjnego do profilaktyki przeciwzakrzepowej żył głębokich (DVT).

Wyposażony w, czytelny ekran LCD, akumulator zapewniający czas pracy urządzenia do 8h. System zapewnia sekwencyjny, obwodowy ucisk na podudzie, udo i kończyny dolne z zachowaniem predefiniowanego ciśnienia, wykrycia gradientu ciśnień dla stosowanych mankietów.

System pozwala na stosowanie mankietów: stopowych, stopowo-łydkowych, udowych.

Czas trwania cyklu kompresji i dekompresji pary mankietów wynosi 60 sekund.

Mankiet do ucisku sekwencyjnego kompatybilny z oferowanym aparatem.

- Mankiet 4 komorowy na rzep zapewniający precyzyjną i wysoce wydajną terapię przeciwzakrzepową żył głębokich (DVT)

- Profil ucisku 45 mmHg, 42 mmHg, 39 mmHg, i 36 mmHg

- Rozmiar mankietu mały (S) dla obwodu uda 44-60 cm
- Rozmiar mankietu średni (M) dla obwodu uda 54-76 cm
- Rozmiar mankietu duży (L) dla obwodu uda 54-82 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytania do zadania 27

Pytanie 1. Dotyczy: Pakiet 27. Wózek do przewożenia chorych – Chirurgia

Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji pleców za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy: Pakiet 27. Wózek do przewożenia chorych – Chirurgia

Czy Zamawiający dopuści wózek o nieznacznie większych wymiarach: 228 x 80 cm oraz z regulacją wysokości 51 – 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw XXX

dot. zadanie nr 27 Wózki i krzesła medyczne

Pytanie nr 1.

Prosimy o wyłączenie z Zadania 27 następujących pozycji:

- Wózek zabiegowy – OIT – 1 szt.
- Wózek zabiegowy – Chirurgia – 2 szt.
- Wózek zabiegowy – Neurochirurgia – 2 szt.
- Wózek zabiegowy – Chirurgia szczękowo-twarzowa - 2 szt.
- Wózek zabiegowy – Endoskopia – 2 szt.
- Wózek medyczny zabiegowy – Otorynolaryngologia – 2 szt.
- Wózek oddziałowy – Laryngologia – 1 szt.

oraz utworzenie z nich odrębnego Zadania.

Umieszczenie tak zróżnicowanego sprzętu medycznego w jednym Zadaniu pozwala na składanie ofert tylko firmom handlowym, jednocześnie uniemożliwiając wzięcia udziału w postępowaniu producentom mebli i sprzętu. Produkty te nie są kompatybilne ze sobą, zatem nie muszą być dostarczone przez jednego producenta.

Wyodrębnienie tych produktów umożliwi przedstawienie oferty większej ilości

Wykonawcom, co korzystnie wpłynie na konkurencyjność ofert, a także ceny oferowanych produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

dot. zadanie nr 27 Wózek zabiegowy – Chirurgia – 2szt.

Pytanie nr 2.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w szufladę pracującą na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem z mechanizmem cichego samodomykania. Oferowany parametr jest lepszy od wskazanego w SIWZ. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3.

Prosimy o dopuszczenie wózka o szerokości 500 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 4.

Prosimy o dopuszczenie wózka o szerokości 650 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 5.

Prosimy o dopuszczenie wózka o głębokości 500 mm. Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednoznacznie nie wpływając na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

dot. Zadanie nr 27 Wózek zabiegowy – Neurochirurgia – 2szt.

Pytanie nr 6.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w szufladę pracującą na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem z mechanizmem cichego samodomykania. Oferowany parametr jest lepszy od wskazanego w SIWZ. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7.

Prosimy o dopuszczenie wózka o szerokości 500 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 8.

Prosimy o dopuszczenie wózka o szerokości 650 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 9.

Prosimy o dopuszczenie wózka o głębokości 500 mm. Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednoznacznie nie wpływając na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w 2 szyny sprzętowe wykonane ze stali kwasoodpornej o nośności min. 5kg. Podane przez Zamawiającego wyposażenie dodatkowe: pojemnik na zużyte igły oraz 2x kosz na odpady nie zmieszczą się na jednej szynie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadanie nr 27 Wózek zabiegowy – Chirurgia szczękowo-twarzowa – 2szt.

Pytanie nr 11.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w szufladę pracującą na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem z mechanizmem cichego samodomykania. Oferowany parametr jest lepszy od wskazanego w SIWZ. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12.

Prosimy o dopuszczenie wózka o szerokości 500 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 13.

Prosimy o dopuszczenie wózka o szerokości 650 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 14.

Prosimy o dopuszczenie wózka o głębokości 500 mm. Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednoznacznie nie wpływając na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w 2 szyny sprzętowe wykonane ze stali kwasoodpornej o nośności min. 5kg. Podane przez Zamawiającego wyposażenie dodatkowe: pojemnik na zużyte igły oraz 2x kosz na odpady nie zmieszczą się na jednej szynie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

dot. Zadanie nr 27 Wózek zabiegowy – Endoskopia – 2szt. (pozycja 1 i 2)

Pytanie nr 16.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w szufladę pracującą na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem z mechanizmem cichego samodomykania. Oferowany parametr jest lepszy od wskazanego w SIWZ. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17.

Prosimy o dopuszczenie wózka o szerokości 500 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 18.

Prosimy o dopuszczenie wózka o szerokości 650 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 19.

Prosimy o dopuszczenie wózka o głębokości 500 mm. Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednoznacznie nie wpływając na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w 2 szyny sprzętowe wykonane ze stali kwasoodpornej o nośności min. 5kg. Podane przez Zamawiającego wyposażenie dodatkowe: pojemnik na zużyte igły oraz 2x kosz na odpady nie zmieszczą się na jednej szynie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

dot. Zadanie nr 27 Wózek medyczny zabiegowy – Otorynolaryngologia – 2 szt.

Pytanie nr 21.

Prosimy o określenie materiału, z którego ma być wykonany wózek.

W punkcie 3 opisu przedmiotu zamówienia widnieje zapis o wykonaniu wózka ze stali kwasoodpornej, natomiast w punkcie 4 i 5 widnieje zapis o stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo. Oba te punkty wykluczają się wzajemnie, gdyż stal kwasoodporna nie jest stalą ocynkowaną.

Odpowiedź:

Punkt 3 zależy od Wykonawcy, stanowi to kryterium oceny ofert. Natomiast w pkt 5 Zamawiający dopuszcza wykonanie wózka ze stali kwasoodpornej. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w szuflady pracujące na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem z mechanizmem cichego samodomykania. Oferowany parametr jest lepszy od wskazanego w SIWZ. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23.

Czy Zamawiający dopuści wózek uchwytami szuflad bez przetłoczenia na frontach szuflady? Front szuflady bez przetłoczenia niweluje zbieranie się zanieczyszczeń, jednocześnie jest łatwiejszy do dezynfekcji.

Zdjęcie proponowanego rozwiązania poniżej:



Zdjęcie poglądowe- uchwyty bez przetłoczenia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24.

Prosimy o dopuszczenie wózka z blatem ze stali lakierowanej proszkowo, z pogłębieniem, blat otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, o przekroju kołowym o średnicy 20 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływając na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26.

Prosimy o dopuszczenie wózka o wysokości całkowitej (bez wyposażenia dodatkowego) równej 1000mm. Powyższe rozwiązanie jest optymalne przy zastosowaniu podanej przez Zamawiającego ilości szuflad zachowując ich praktyczną powierzchnię użytkową. Ponadto wysokość ta jest zdecydowanie bardziej ergonomiczna podczas pracy na stojąco.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27.


Prosimy o dopuszczenie wózka o głębokości całkowitej bez wyposażenia dodatkowego 550 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w ażurowy koszyk na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej, o wymiarach: 115x155x500 mm. Zdjęcie proponowanego rozwiązania poniżej:

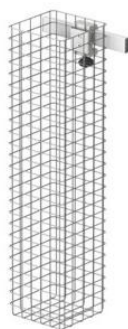

Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w pojemnik na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej z frontem z przezroczystego tworzywa, wysuwany; wewnątrz podzielone na dwa kanały. Wymiary pojemnika: 120x60x500 mm
Zdjęcie proponowanego rozwiązania poniżej:



Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w 3 szyny sprzętowe wykonane ze stali kwasoodpornej. Podane przez Zamawiającego wyposażenie dodatkowe nie zmieści się na dwóch szynach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

dot. Zadanie nr 27 Wózek oddziałowy – Laryngologia – 1 szt.

Pytanie nr 31.

Prosimy o określenie materiału, z którego ma być wykonany wózek.

W punkcie 3 opisu przedmiotu zamówienia widnieje zapis o wykonaniu wózka ze stali kwasoodpornej, natomiast w punkcie 4 i 5 widnieje zapis o stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo. Oba te punkty wykluczają się wzajemnie, gdyż stal kwasoodporna nie jest stalą ocynkowaną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pkt 5 wykonanie wózka ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 32.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w szuflady pracujące na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem z mechanizmem cichego samodomykania. Oferowany parametr jest lepszy od wskazanego w SIWZ. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33.

Czy Zamawiający dopuści wózek uchwytami szuflad bez przetłoczenia na frontach szuflady? Front szuflady bez przetłoczenia niweluje zbieranie się zanieczyszczeń, jednocześnie jest łatwiejszy do dezynfekcji.

Zdjęcie proponowanego rozwiązania poniżej:



Zdjęcie poglądowe- uchwyty bez przetłoczenia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34.

Prosimy o dopuszczenie wózka z blatem ze stali lakierowanej proszkowo, z pogłębieniem, blat otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35.

Prosimy o dopuszczenie wózka o wysokości całkowitej (bez wyposażenia dodatkowego) równej 1000mm. Powyższe rozwiązanie jest optymalne przy zastosowaniu podanej przez Zamawiającego ilości szuflad zachowując ich praktyczną powierzchnię użytkową. Ponadto wysokość ta jest zdecydowanie bardziej ergonomiczna podczas pracy na stojąco.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36.

Prosimy o dopuszczenie wózka o głębokości całkowitej bez wyposażenia dodatkowego 550 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37.

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w 2 szyny sprzętowe wykonane ze stali kwasoodpornej. Podane przez Zamawiającego wyposażenie dodatkowe nie zmieści się na dwóch szynach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

dot. Załącznik nr 9 do SIWZ- umowa (wzór)

Pytanie nr 38.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu określonego w § 2 ust.3, § 6. ust.5 umowy i usunięcie wymogu instalacji w zakresie zadania nr 27.

Przedmiot zamówienia, jakim są krzesła i wózki medyczne, dostarczane są w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymagają instalacji i montażu w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. W § 2 ust.3 umowy Zamawiający ogólnie określił, cyt. „...*(zależnie od danego rodzaju sprzętu)*...”. W przypadku § 6. ust.5 określił „*Dostarczyć w terminie określonym w § 3 na własny koszt i ryzyko przedmiot Umowy, zainstalować oraz uruchomić wszystkie elementy oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia*”. Zapis dotyczy głównie terminu dostawy oraz w przypadku pozostałe czyli instalacja oraz uruchomienie (elementy mogą być zdekompletowane i wymagać kompletacji – Zamawiający nie posiada wiedzy w jakiej formie Wykonawca będzie transportował przedmiot zamówienia) odnosi się do złożenia, skręcenia czy montażu oraz przekazania Zamawiającemu dokumentem przekazania, np. Protokołem zdawczo – odbiorczym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ i powinien być realizowany na zasadach określonych w Załączniku Nr 9 do SIWZ wzór umowy.

Pytanie nr 39.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu określonego w § 6. ust.6, i § 8 ust. 6 pkt 4 i usunięcie wymogu dostarczenia książki jakości i paszportu technicznego, w zakresie zadania nr 27.

Przedmiot zamówienia, jakim są krzesła i wózki medyczne, nie są aparaturą medyczną, w związku z czym nie wymaga posiadania książki jakości i paszportu technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał elementów przedmiotu zamówienia w przypadku braku konieczności posiadania ich przez oferowany asortyment.

Pytanie nr 40.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w §6 ust 8 i §10 odstąpienie od wymogu szkolenia w zakresie zadania nr 27, oraz jednocześnie o usunięcie § 14. ust. 1 pkt 5 umowy.

Przedmiot zamówienia, jakim są krzesła i wózki medyczne, dostarczane są w formie złożonej, gotowej do użytku, a wystarczającym dokumentem jest Instrukcja Obsługi.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w Załączniku Nr 8 do SIWZ, które części zamówienia wymagają szkolenia. W przypadku braku wyszczególnienia takiego zapisu, zrozumiałym jest, że Zamawiający może wymagać jedynie instruktażu na wyraźną jego prośbę.

Pytanie nr 41.

Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy § 12 ust.10, lub wyjaśnienie jakie badania zlecone innemu podmiotowi medycznemu ma na myśli Zamawiający.

Odpowiedź:

Zapisy ww paragrafie są ogólne do wszystkich części zamówienia. W przypadku ww części zamówienia oczywistym jest zapis o terminie naprawy, pozostałe z przyczyn oczywistych nie będą miały zastosowania.

Pytanie nr 42.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w §12 ust 2 i 13 w zakresie zapewnienia przeglądów technicznych sprzętów dla zadania 27 oraz jednocześnie o usunięcie § 14. ust. 1 pkt 4 umowy.

Przedmiot zamówienia, jakim są krzesła i wózki medyczne, zgodnie z oświadczeniem producenta nie wymaga przeglądów.

Odpowiedź:

Zamawiający jw. informuje, że treść umowy jest ogólna dla wszystkich części zamówienia. W przypadku ww części zamówienia oczywistym jest zapis że przedmiot zamówienia nie wymaga serwisowania poza serwisem gwarancyjnym.

Zestaw XXXI

Pakiet 35

1. Ze względu specjalistyczny charakter zamówienia oraz na fakt że towar znajduje się na magazynie zewnętrznym poza granicami kraju czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla Pakietu 35 do 56 dni roboczych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ

2. W przypadku naprawy jeśli zajdzie konieczność sprowadzenia części zamiennych do urządzenia istnieje możliwość wydłużenia czasu naprawy do 14 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

3. Dodatkowo W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej i możliwej do realizacji oferty przetargowej, korzystając z uprawnień przysługujących nam jako wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej – p.z.p. oraz na mocy praw wynikających z dyspozycji Art. 15r.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej – u.o.s.r.), czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązкови, niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści SIWZ (załącznik nr ... - istotne postanowienia umowy/wzór) w/w postępowania:

- a) Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 9 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

- b) Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?
- c) Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 14 ust. 1.1) wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?

Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści §14 ust. 1. wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź:

Zamawiający w §16 ust. 3 pkt 2 przewidział w umowie zmiany w obowiązujących przepisach mających wpływ na przedmiot i warunki umowy.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings