



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 30.09.2022r.

EZP 405/2022

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu D-28/2022 na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 12 mógłby doprecyzować, czy zestaw (tak, jak dotychczas stosowany przez Zamawiającego) będzie oparty na użyciu dedykowanego narzędzia tj. peana wielorazowego użytku (które to narzędzie nie jest elementem składowym opisanego zestawu uzupełniającego).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zestaw z zadania 12 będzie oparty na użyciu dedykowanego narzędzia tj. peana wielorazowego użytku.

Pytanie nr 2

Zadanie 41 pozycja 1

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Mata na podłogę, o dużej wchłaniałości (minimum 1,5l) płynów, z możliwością przytwierdzenia do podłogi w 4 miejscach. O wymiarach 81cm (+/- 1 cm) x 122cm (+/- 1 cm)

Ilość w opakowaniu 25 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Zadanie 41 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Mata na podłogę, o dużej wchłaniałości (minimum 1,5l) płynów, z możliwością przytwierdzenia do podłogi w 4 miejscach. O wymiarach 81cm (+/- 1 cm) x 152cm (+/- 1 cm)

Ilość w opakowaniu 25 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Zadanie 4 pozycja 1

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.

Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 228cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłaniałość min.3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). W zestawie z prześcieradłem do transportu pacjenta o udźwigu 250kg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

Zadanie 4 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.

Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 228cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłaniałość min.3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

Zadanie 4 pozycja 3

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.

Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 152cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłaniałość min.3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

ZADANIE 36, POZYCJA 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk o wymiarach: 80 x 50 x 37 mm ?





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8

ZADANIE 36, POZYCJA 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk sterylizowane EO?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9

ZADANIE 36, POZYCJA 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk z gęstym systemem miękkich włosków, które rozmieszczone są w ok. 40 rzędach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 10

ZADANIE 36, POZYCJA 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk z włosiem jednakowej długości? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórki, ale także ułatwia dokładne umycie rąk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11

uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 14, poz. 1: Kateter moczowodowy typu Nelaton w widoczny w RTG, skalowany co 1 cm, wykonany z poliuretanu z adapterem Luer-Lock o długości 70 cm, w rozmiarach 3 – 8 Ch.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 14, poz. 2: Zestaw do szynowania moczowodów. Cewnik wykonany z poliuretanu w rozm 3Ch;4Ch;4,8 Ch;5Ch ;6 Ch. Stent w zestawie z popychaczem 75 cm dla rozmiarów 3Ch;4Ch;4,8 Ch;5Ch i 45 cm dla cewnika 6Ch , prowadnica 150 cm. Kateter zakończony z obu stron krzywizną typu pigtail, średnica pętli 2 cm od strony nerki oraz pęcherza moczowego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Zadanie nr 14, poz. 3: Prowadnica Lunderquista wykonana ze stali nierdzewnej, sztywna , o długości 80 cm i średnicy 0,035” z końcówką miękką prostą lub zagiętą typu J.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania nr. 26 pozycji numer 1 oraz 3 (linie próbkujące i pułapki wodne)? Wydzielenie tych pozycji nie zmieni zakresu zamówienia a jedynie zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15

Zadanie 15. Poz.1

Czy Zamawiający dopuści równoważną elektrodę dla dorosłych do badań Holterowskich i wysiłkowych, o rozmiarze 55 x 41 mm, żel stały, mocny, zapewniający dobre przewodzenie oraz stabilność elektrody podczas ruchów pacjenta, pianka polietylenowa, elastyczna. Elektroda posiada specjalne nacięcie i otworek do przełożenia i umocowania kabla pacjenta, co zapobiega artefaktom w czasie badania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 15 poz. 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowanie = 50 szt. i odpowiednie przeliczenie wymaganych ilości w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 15 poz. 1, 2, 3

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 18

Zadanie nr 15 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda do badań holterowskich i wysiłkowych ma posiadać podłużny otwór o wymiarach 25 x 3 mm bez przecięcia boków elektrody służący do przełożenia kabla?

Odpowiedź:

Tak, elektroda do badań holterowskich i wysiłkowych ma posiadać podłużny otwór o wymiarach 25 x 3 mm bez przecięcia boków elektrody służący do przełożenia kabla.

Pytanie nr 19

Zadanie nr 15 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o średnicy 50 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 20

Zadanie nr 15 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji oryginalnego papieru Schiller AT2 o rozmiarze 210 x 280 mm x 180 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 144 składanki (sztuki), ponieważ producent zmienił w oryginalnym papierze ilość kartek w składance z 215 szt. na 180 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 21

Zadanie nr 15 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie wyceny op. = 10 rol. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 22

Zadanie nr 15 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny papieru o rozmiarze 112 x 100 mm x 150 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 160 składanek (sztuk).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 23

Zadanie nr 15 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepack o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 24

Zadanie nr 15 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie wyceny op. = 10 rol. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 25

Zadanie nr 15 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 x 70 mm x 314 kartek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 26

Zadanie nr 15 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie wyceny op. = 5 rol. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 27

Zadanie nr 15 poz. 14





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 152 x 90 mm x 160 kartek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 28

Zadanie nr 15 poz.15

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny czy zamawiający dopuści również papier nieoryginalny tzw. zamiennik?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamiennik.

Pytanie nr 29

Zadanie nr 15 poz. 18

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny żelu do USG o pojemności 500 ml z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 500 szt. (szt. = 500 ml).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 30

Zadanie nr 4 poz. 1

W związku z wycofaniem z produkcji podkładu o parametrach wymienionych w poz. 1 prosimy o dopuszczenie w poz. 1 podkładu stanowiącego jego zamiennik o następujących parametrach: podkład 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 140 cm x 230 cm. Warstwa chłonna min. 70 cm x 230 cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1 min. od zmożenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 85 ± 5 g/m², niebieska dolna warstwa PE 35g/m². Niesterylny klasy 1, zgodny z normą EN 13795. Elektrostatyczny zgodnie z normą UNE-EN1149-1/UNE-EN1149-5. Możliwość przenoszenia do 150kg. Grubość 0,5mm. Chłonność 4000ml/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 31

Zadanie nr 4 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu bez gumek ściągających na narożnikach, pozostałe parametry oferowanych podkładów będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.


Pytanie nr 32

Zadanie nr 4 poz. 3

Jeśli Zamawiający nie dopuści w ww. pozycji podkładu bez gumek ściągających na narożnikach prosimy o dopuszczenie wówczas podkładów o następującym opisie: 4-warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia ,utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, narożniki zakończone gumką ściągającą tak aby zakładać na narożnik materaca, rozmiar 140cm x 230cm.Warstwa chłonna min. 90cmx230cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmożenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 85 ± 5 g/m², niebieska dolna warstwa PE



8



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



35g/m² .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795.Możliwość przenoszenia do 150kg.Grubość 0,5mm.Chłonność 4000ml/m².

Odpowiedź:

Patrz odp. nr 31 (Zamawiający wyraził zgodę.)

Pytanie nr 33

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź:

Szpital nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia.

Obowiązku wprowadzenia takiej regulacji w umowie nie przewiduje Prawo Zamówień Publicznych. W sytuacji zaś, jeśli w stosunku do daty złożenia oferty nastąpi nadzwyczajna zmiana stosunków uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia, wykonawca będzie mógł złożyć stosowny w tym zakresie wniosek.

Pytanie nr 34

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
- 2) za zwłokę w realizacji dostaw na podstawie zamówień Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości netto Rękawic niedostarczonych w terminie, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto Rękawic niedostarczonych w terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?



H



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia projekt umowy o powyższy zapis i podaje adres:
<https://brokerpexpert.efaktura.gov.pl>.

Pytanie nr 36

Dotyczy zadania 32, poz. 12, czy Zamawiający dopuści wycenę Transition Connector to ENLock/Funnel tube, 30 szt, 589732 w ilości 2 op ? Opakowania Producenta x 30szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe z odpowiednim przeliczeniem ilości do danej pozycji.

Pytanie nr 37

Dotyczy zadania nr 32, czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie, nie za szt.? z odpowiednim przeliczeniem ilości do danej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 38

ZADANIE 31

Pozycja 1-Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku o szerokości ostrza tnącego 36mm, kompatybilnych z zaoferowaną w pozycji 5 strzygarką.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 39

ZADANIE 31

Pozycja 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności (wymóg dyrektywy MDR 2017/745) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności.

Pytanie nr 40

ZADANIE 31

Pozycja 2-Prosimy o dopuszczenie ostrzy jednorazowego użytku o szerokości ostrza tnącego 36mm do włosów grubych, kompatybilnych z zaoferowaną w pozycji 5 strzygarką. Prosimy o dopuszczenie pakowania 1 szt./ blister; 25 blistrów/ pudełko.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 41

ZADANIE 31


Pozycja 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności (wymóg dyrektywy MDR 2017/745) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 42

ZADANIE 31

Pozycja 3-Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku o szerokości ostrza tnącego 36mm, podczas gdy strzygarka kompatybilna z nimi posiada obrotową głowicę ułatwiającą golenie trudnodostępnych miejsc.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 43

ZADANIE 31

Pozycja 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności (wymóg dyrektywy MDR 2017/745)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności.

Pytanie nr 44

ZADANIE 31

Pozycja 4-Prosimy o odstąpienie od wymogu "Ostrza do golenia krótkiego zarostu u pacjentów" przy zaoferowaniu ostrzy do strzygarki z trzyzakresową obrotową głowicą: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. Ponadto wymaganie przedstawione przez zamawiającego jest na rynku oferowane tylko przez jedną firmę. Opis dokładnie wskazuje na konkretnego producenta co zakłóca zasady uczciwej konkurencji.

W myśl art. 16 Pzp, czynności Zamawiającego powinny zmierzać do zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców. Stosownie z kolei do art. 99ust. 2 Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności – zgodnie z art. 99 ust. 3 Pzp – w sposób który wskazywałby na konkretny produkt lub wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.

Pytanie nr 45

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności (wymóg dyrektywy MDR 2017/745)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności.

Pytanie nr 46

Zadanie 31 Pozycja 5-Prosimy o dopuszczenie trzyzakresowej, obrotowej strzygarki posiadającej trzy pozycje:

- Kąt 45 stopni w prawo
- Kąt 45 stopni w lewo
- Kąt 0 stopni



6



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



ułatwiającej usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała; kompatybilnej z dwoma rodzajami ostrzy, wyposażonej w ładowarkę kontaktową, spełniającej pozostałe zapisy SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 47

Zadanie 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższym opisie:

„Kaniula dożylna bezpieczna z ochroną przypadkowym zakłuciem. Przezroczysta komora, kolorowe oznakowanie wielkości, z portem bocznym. Membrana hydrofobowa dla odpowietrzenia kaniuli. Wszystkie rozmiary kaniul od jednego producenta. Na opakowaniu oznaczenie przepływu, informacja o rozmiarze kaniuli, materiału z jakiego wykonano. Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oraz na kaniuli. Koreczek z zewnętrznym trzpieniem, który wchodzi do światła kaniuli cofnięty poniżej krawędzi koreczka. Dodatkowy port umiejscowiony bezpośrednio nad środkiem skrzydełek kaniuli. Blokada koreczka portu przed przypadkowym otwarciem poprzez obrót koreczka o 180 st. Port górny w całości umiejscowiony nad skrzydełkami kaniuli”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 48

Zadanie 7, pozycja 6-8 – Czy Zamawiający dopuści igły wykonane ze stali nierdzewnej z ultracienką ścianką zapewniającą maksymalny przepływ. Ostrze igły szlifowane w dwóch płaszczyznach, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru, sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 49

Zadanie 5, pozycja 15-16 – Czy Zamawiający w jednej z tych pozycji ma na myśli strzykawkę 2ml? Prosimy o doprecyzowanie w której.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli strzykawkę 2ml w pozycji nr.16 .

Pytanie nr 50

Zadanie 39, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 50cm dla rozmiarów CH10-CH24?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 51

Zadanie 42, pozycja 6 – Czy Zamawiający zgodzi się za wycenę opakowania 80szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 52

Zadanie 42, pozycja 7 – Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę opakowania 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 53

Zadanie 42, pozycja 9 – Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę opakowania 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 54

Zadanie 42, pozycja 13 - Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę opakowania 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 55

Zadanie 42, pozycja 14 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek wolnych od szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie masek wolnych od ftalanów.

Pytanie nr 56

Zadanie 42, pozycja 15 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek wolnych od szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie masek wolnych od ftalanów.

Pytanie nr 57

Zadanie 42, pozycja 20 - Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę opakowania 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 58

Zadanie 42, pozycja 21 - Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę opakowania 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 59

Zadanie 42, pozycja 22 - Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę opakowania 144szt z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 60

Zadanie 42, pozycja 23 – Wskazany przez Zamawiającego opis „średnica górna: 85-27mm, średnica dolna: 75-27mm” jest opisem pojemników o pojemności 0,2l. Prosimy o doprecyzowanie, jakie pojemniki Zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli pojemniki o pojemności 0,7 litra i wysokości 120 mm.

Pytanie nr 61

Zadanie 42, pozycja 32 – Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 150ml?





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 62

Zadanie 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości 50cm w części przezroczystej, dren długości 150cm, wolne od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren. Nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 63

Zadanie 43, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z drenem o długości 150cm, wolny od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu. Przyrząd uniwersalny – przeznaczony do przetoczeń metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzyw i miękkich worków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 64

Zadanie 5, pozycja 12-17 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki wykonane w całości z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 65

Pakiet nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh występowała w rozmiarach 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 66

Pakiet nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby wszystkie rozmiary łyżek pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 67

Pakiet nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby Mocowanie światłowodu było zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 68

Pakiet nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby światłowód łyżki był nieosłonięty (doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła). Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 69

Pakiet nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby zakończenie łyżki od strony pacjenta było atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 70

Pakiet nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby mocowanie w rękojeści było zatraskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 71

Pakiet nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby stopka mocująca do rękojeści była wykonana ze stopu metalu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 72

Pakiet nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby łyżka zawierała wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 73

Pakiet nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym była zawarta data ważności łyżki do min. 5 lat od daty produkcji - wymagane potwierdzenie od producenta w formie załącznika do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 74

Pakiet nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta w formie załącznika do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 75

Pakiet nr 10 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby opakowanie było z podwójnej folii, na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, nazwa produktu w języku polskim, rozmiar, LOT, nazwa producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 76

Pakiet nr 16 - Pozycja 1

Czy zamawiający wymaga, aby dreny były gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów? Podwójne opakowanie folia - folia/papier.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 77

Pakiet nr 16 - Pozycja 2

Czy zamawiający wymaga, aby zamknięty system do odsysania był zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 78

Pakiet nr 16 - Pozycja 2

Czy zamawiający wymaga, aby produkt nie zawierał lateksu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 79

Pakiet nr 16 - Pozycja 4

Czy zamawiający wymaga, aby sterylny adapter do zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, umożliwił prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączenia układu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 80

Pakiet nr 16 - Pozycja 4

Czy zamawiający wymaga, aby adapter posiadał obrotowy łącznik do podłączenia do rurek intubacyjnych/tracheostomijnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 81

Pakiet nr 16 - Pozycja 4

Czy zamawiający wymaga, aby adapter posiadał port do wprowadzania bronchofibroskopu posiadający wewnętrzną, silikonową, samo-uszczelniającą się zastawkę dwupłatkową oraz silikonowy kapturek zamykający port z zawieszką?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 82

Pakiet nr 16 - Pozycja 4

Czy zamawiający wymaga, aby adapter posiadał złącza 15M-15F?





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 83

Pakiet nr 16 - Pozycja 4

Czy zamawiający wymaga, aby adapter możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzona dokumentem od producenta? Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie adaptera przez min. 72h, oraz wymaga produktu bez zawartości lateksu i DEHP.

Pytanie nr 84

Pakiet nr 20 - Pozycja 6-10

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Maski krtaniowe w następujących rozmiarach: 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30kg); 3,0 30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg). Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 85

Pakiet nr 20 - Pozycja 18

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H₂O, worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 (Objętość martwej przestrzeni: 149 ml (+/- 1 ml) i 5 (Objętość martwej przestrzeni: 188 ml (+/- 1 ml), rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuuar tlenowy o pojemności 2 500 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 86

Pakiet nr 23 - Pozycja 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Obwód oddechowy do respiratora i aparatu do znieczuleń, karbowany dla dorosłych, o długości 150cm, łącznik Y, port kapno. Możliwość użycia obwodu oddechowego przez min. 7 dni – potwierdzona dokumentem od producenta. Opakowanie folia z etykietą z nr serii oraz terminem ważności.


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 87

Pakiet nr 23 - Pozycja 2





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, rozciągliwy dla dorosłych o długości 50-180cm z dodatkową trzecią rurą o długości 150 cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, łącznik Y, port kapno - pakowany pojedynczo. Czas stosowania do 7 dni (do 168 godzin).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.


Pytanie nr 88

Pakiet nr 37 - Pozycja 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej.

W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Kontrolowane odsysanie (regulacja siły odsysania) z możliwością samodzielnego regulowania odsysania za pomocą przesuwnej wskaźnika, znajdującego się na rękojeści. Elementy mocowane poprzez trwałe połączenie z rękojeścią. Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu. Produkt bez lateksu.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 89

Pakiet nr 37 - Pozycja 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Czepek do mycia głowy typu ECO nie wymagający dodatkowego namaczania głowy. Zapewniający ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów.

Cechy:

- wolny od: alkoholu, lateksu, lanoliny, perfum i parabenów
- zawiera wodę, (pH 5,5)



6



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej
- zawiera szampon i odżywkę w jednym
- materiał: włókno wiskozowe i poliestrowe z powłoką polietylenową
- pakowany pojedynczo



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 90

Pakiet nr 37 - Pozycja 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równowagi ofert o poniższych parametrach technicznych:

Antybakteryjny czepek do mycia głowy nie wymagający dodatkowego namaczania głowy typu ECO. Zapewniający ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów oraz dezynfekcję. Czepek ma działanie antybakteryjne wobec bakterii Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus, (MRSA), Klebsiella pneumoniae (ESBL), Enterococcus faecium (VRE) und Candida albicans.

Cechy:

- wolny od alkoholu, lateksu i lanoliny, (pH 5,5)
- zawiera wodę, zawierają witaminę E, pro witaminę B5, wyciągi ziołowe
- zawiera środek antybakteryjny: chlorek didecyldimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksydyny
- spełniają wymagania norm DIN EN13624 i DIN EN 13727
- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej
- materiał: włókno poliestrowe, wiskozowe i polipropylenowe
- pakowany po 20 sztuk



H



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 91

Zadanie 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższym opisie:

„Kaniula dożylna bezpieczna z ochroną przypadkowym zakłuciem. Przezroczysta komora, kolorowe oznakowanie wielkości, z portem bocznym. Membrana hydrofobowa dla odpowietrzenia kaniuli. Wszystkie rozmiary kaniul od jednego producenta. Na opakowaniu oznaczenie przepływu, informacja o rozmiarze kaniuli, materiału z jakiego wykonano. Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oraz na kaniuli. Koreczek z zewnętrznym trzpieniem, który wchodzi do światła kaniuli cofnięty poniżej krawędzi koreczka. Dodatkowy port umiejscowiony bezpośrednio nad środkiem skrzydełek kaniuli. Blokada koreczka portu przed przypadkowym otwarciem poprzez obrót koreczka o 180 st. Port górny w całości umiejscowiony nad skrzydełkami kaniuli”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 92

Zadanie 7, pozycja 6-8 – Czy Zamawiający dopuści igły wykonane ze stali nierdzewnej z ultracienką ścianką zapewniającą maksymalny przepływ. Ostrze igły szlifowane w dwóch płaszczyznach, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru, sterylizowane tlenkiem etylenu, standardowe bez zabezpieczenia igły ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 93

Zadanie 5, pozycja 15-16 – Czy Zamawiający w jednej z tych pozycji ma na myśli strzykawkę 2ml? Prosimy o doprecyzowanie w której.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli strzykawkę 2ml w pozycji nr 16.

Pytanie nr 94

Zadanie 39, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 50cm dla rozmiarów CH10-CH24?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 95





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zadanie 42, pozycja 6 – Czy Zamawiający zgodzi się za wycenę opakowania 80szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe..

Pytanie nr 96

Zadanie 42, pozycja 7 – Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę opakowania 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe..

Pytanie nr 97

Zadanie 42, pozycja 9 – Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę opakowania 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe..

Pytanie nr 98

Zadanie 42, pozycja 13 - Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę opakowania 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe..

Pytanie nr 99

Zadanie 42, pozycja 14 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek wolnych od szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe..

Pytanie nr 100

Zadanie 42, pozycja 15 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek wolnych od szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 101

Zadanie 42, pozycja 20 - Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę opakowania 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe..

Pytanie nr 102

Zadanie 42, pozycja 21 - Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę opakowania 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe..

Pytanie nr 103

Zadanie 42, pozycja 22 - Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę opakowania 144szt z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę?



W



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 104

Zadanie 42, pozycja 23 – Wskazany przez Zamawiającego opis „średnica górna: 85-27mm, średnica dolna: 75-27mm” jest opisem pojemników o pojemności 0,2l. Prosimy o doprecyzowanie, jakie pojemniki Zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli pojemniki o pojemności 0,7 litra i wysokości 120 mm.

Pytanie nr 105

Zadanie 42, pozycja 32 – Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 150ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 106

Zadanie 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kropłową o długości 50cm w części przezroczystej, dren długości 150cm, wolne od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren. Nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 107

Zadanie 43, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z drenem o długości 150cm, wolny od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu. Przyrząd uniwersalny – przeznaczony do przetoczeń metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzyw i miękkich worków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 108

Zadanie 5, pozycja 12-17 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki wykonane w całości z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 109

Pytania do SWZ

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu, prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeżenie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź:



h



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zgodnie z określonymi przez producentów warunkami magazynowania i transportu wyrobów medycznych obowiązki dotrzymania tych warunków spoczywają na Wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy, który nie będzie spełniał wymagań jakościowych oraz żądać wymiany na asortyment nie uszkodzony i odpowiedniej jakości.

Pytanie nr 110

Pytania do SWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 111

Pytania do SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wyżej wymienionego wykazu.

Pytanie nr 112

Pytania do SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź:

Zgodnie z odp. na pytanie nr. 109.

Pytanie nr 113

Zad.7

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na składanie ofert częściowych na każdą pozycję oddzielnie w zakresie pakietu nr 7 lub czy Zamawiający zgodzi się na podzielenie pakietu nr 7 na dwie części:

Część 7A – pozycje 1-3

Część 7B- pozycje 4-8

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 114

Zad.7

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 7 poz. 1: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrząskowym typu "klik" domykany standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły bez systemu kapilar, z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia zamiast zastawki, jednostopniowa identyfikacja wkłucia w komorze kontrolnej bez otworu przy ostrzu igły, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, kaniule posiadają jedynie badania laboratoryjne na biokompatybilność poliuretanu, rozmiary od 14 do 24G?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 115

Zad.7

Czy Zamawiając w pakiecie nr 7 poz. 2-3 dopuści: Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył, dla noworodków i dzieci, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, bez portu. Kaniule bez wyjmowanego uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wkłucie, cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu z 3 wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Zaopatrzona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, jednostopniowa identyfikacja wkłucia w komorze kontrolnej bez otworu przy ostrzu igły, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, kaniule posiadają jedynie badania laboratoryjne na biokompatybilność poliuretanu, rozmiary:

Poz. 2 - 26G (fioletowa), 0,6 x 19 mm, przepływ 19 ml/min

Poz. 3 - 24G (żółta), 0,7 x 19 mm, przepływ 29 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 116

Czy Zamawiający w Zadaniu 32, pozycja 13 dopuszcza zestaw grawitacyjny, do worków, służący do żywienia dojelitowego z końcówką EnFit, służący do połączenia worków/butelek OpTri z dietą i ze zgłębnikiem? Zestaw ten posiada łącznik ENPlus pasujący do worków i butelek OpTri.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 117

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o wysokości przeznaczonych środków finansowych dla całej sprawy i/lub poszczególnych zadań (D-28/2022).

Odpowiedź:


Wartość środków przeznaczonych na przedmiot zamówienia zostanie podana w dniu otwarcia ofert.


Pytanie nr 118

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 23, poz. 2

Obwód oddechowy do aparatów do znieczulania, rozciągliwy wykonany z polipropylenu, najczęściej stosowany materiał w produkcji obwodów rozciągliwych, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź:





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 118a

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 20, poz. 4 Dren do nebulizatora z szeroką końcówką 2,1m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 20, odpowiednio ?

6	Maska krtaniowa od 10 - 20 kg oraz 5-10kg
7	Maska krtaniowa od 20 - 30 kg
8	Maska krtaniowa od 30- 50 kg
9	Maska krtaniowa od 50 - 70kg
10	Maska krtaniowa od 70kg

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 119a

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 20, poz. 18 ?

Resuscytator przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta, dla dorosłych, wykonany z SEBS (kopolimer trybłokowy styren/etylen-butylem/styren).

- Przeznaczony do wentylacji pacjentów dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg
- Zawór bezpieczeństwa: 60 cm H₂O (typowy dla dorosłych)
- Objętość worka: 1650 ml
- Maksymalna objętość oddechowca: 1100 ml
- Objętość rezerwuaru tlenu: 2000 ml
- Maski twarzowe dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 2,10 m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 120

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 15 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 121

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 1 dopuści wycenę strzykawki do pomp firmy Margomed, powszechnie stosowanych w szpitalach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 122





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 4-7 dopuści wycenę strzykawek z przezroczystym cylindrem, mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 123

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 4-11 oraz 13-17 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 124

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 4 dopuści wycenę strzykawki ze skalą przedłużoną do 22ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 125

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 13-17 dopuści wycenę strzykawek w całości z polipropylenu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Podane zadanie dotyczy kaniul, jeżeli Wykonawca miał na myśli zadanie nr 5 – patrz odp. 64.

Pytanie nr 126

Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp bez kołnierza na łączniku luer lock oraz bez wcięcia na tłoku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 127

Zadanie 5, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z cylindrem w mlecznym kolorze wyraźnie kontrastującym z tłokiem, posiadająca skalę przedłużoną o 10% objętości, pojedynczą kryzę w zupełności zabezpieczającą przed wypadaniem? Reszta parametrów zgodnie z swz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 128

Zadanie 5, pozycja 12-17

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę posiadającą tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości PCV? Reszta parametrów zgodnie z swz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 129

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45x13?

Odpowiedź:



5



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 130

Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 131

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków jak na zdjęciu:



?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 132

Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okrągłą elektrodę o średnicy 55mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 133

Zadanie 15, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zamiennik papieru zapewniający wysoką jakość i trwałość wydruku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 133a

Zadanie 15, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 80x70x315?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 134

Zadanie 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nebulizatorem o pojemności 15ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 135

Zadanie 39, pozycja 3





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania cewnika wyłącznie w rozmiarze 6 czy w rozmiarach od 6 do 28?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje cewnika w rozmiarze od 6 do 28.

Pytanie nr 136

Zadanie 39, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników w rozmiarze 6 do 26?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 137

Zadanie 39, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 2100mm zakończony lejek-lejek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 138

Zadanie 39, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 2100mm zakończony lejek-lejek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 139

Zadanie 39, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi naprzemianległymi dostępny w rozmiarach 6 do 22?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 140

Zadanie 40, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany ze 100% silikonu, występujący w rozmiarze 18-20 z balonem 50-80 cc/ml oraz 22-24 z balonem 80-100 cc/ml spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 141

Zadanie 42, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 142

Zadanie 42, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków wyłącznie w kolorze czerwonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 143





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zadanie 42, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 144

Zadanie 42, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 145

Zadanie 42, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści łącznik podwójnie obrotowy z pojedynczym portem o uniwersalnym połączeniu 22M/15F od strony pacjenta oraz 22F od strony maszyny i objętości wypełnienia 42ml ± 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 146

Zadanie 42, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści nerkę o długości 245mm, spełniająca pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 147

Zadanie 42, pozycja 18

Czy Zamawiający oczekuje opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną skoro opaska ma być na kark?

Odpowiedź:

Zadanie 42, pozycja 18 dotyczy rurki intubacyjnej.

Pytanie nr 148

Zadanie 42, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści opaskę stabilizującą rurkę tracheostomijną składającą się z dwóch części, wykonaną z delikatnej hydrofobowej włókniny w kolorze cielistym

- na każdej części występują paski mocującego z jednostronnie naniesionym rzepem umożliwiające zamocowanie jej do skrzydełek mocujących rurki tracheostomijnej
- krótsza część opaski stabilizującej dodatkowo wyposażona jest w drugi rzep zamocowany na elastycznej białej gumce co umożliwi dopasowanie i określenie całkowitej długości opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 149

Zadanie 42, pozycja 23



H



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7l o wysokości 97mm, średnicy górnej 109mm, średnicy dolnej 93mm, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 150

Zadanie 42, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7l o średnicy górnej/dolnej – 100mm/95mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 151

Zadanie 42, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1,0l o wysokości 140mm, średnicy górnej 109mm, średnicy dolnej 92,5mm, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 152

Zadanie 42, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 2,0l o wysokości 246mm, średnicy górnej 109mm, średnicy dolnej 95mm, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 153

Zadanie 42, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 130mm z otworem wrzutowym 90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 154

Zadanie 42, pozycja 28-32

Czy Zamawiający dopuści pojemnik bez miejsca do opisu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 155


Zadanie 42, pozycja 28-32

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z dodatkową etykietą do opisu, zamiast wyznaczonego pola?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 156



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS

0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zadanie 42, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści worki z dokładną skalą pomiarową (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml), spełniający pozostałe wymagania swz?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 157

Zadanie 42, pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści sterylne zaciskacze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 158

Zadanie 42, pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści niesterylny, produkowany w odpowiednich warunkach, będący wyrobem medycznym worek do lewatywy z drenem o długości 115cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 159

Zadanie 42, pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do lewatywy z drenem o długości 150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 160

Zadanie 44, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny przyrząd do infuzji bez dodatkowego zacisku na drenie – precyzyjny zacisk rolkowy w zupełności wystarcza do zatrzymania infuzji. Długość drenu 180cm wraz z komorą 6cm, dające długość zestawu 186cm. Dren o standardowej średnicy wewnętrznej 3,0mm i objętości wypełnienia ~13ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 161

Zadanie 44, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny przyrząd z igłą ściętą standardowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 162

Zadanie 46, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści port posiadający właściwości:

- Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu
- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
- Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję, nie wywinięta w postaci kołnierza
- Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania



hr



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- Okres ważności: 3 lata
- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier-folia
- Ilość w opakowaniu : 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 163

Dotyczy Zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego PCV o zwiększonym poślizgu, bez silikonu, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 164

Dotyczy Zadania nr 8

Czy Zamawiający prowadnice do rurek intubacyjnych dostępne w rozmiarach: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 165

Dotyczy Zadania nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren do nebulizatora z szeroką końcówką o długości 2,0 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 166

Dotyczy Zadania nr 20 poz. 6-10

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach: 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 167

Dotyczy Zadania nr 20 poz. 11-17

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe kodowane kolorystycznie na pierścieniu mocującym (odpowiednio dla każdego rozmiaru), zamiast wymogu kodowanej kolorystycznie etykiety ułatwiającej szybkie rozpoznanie rozmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 168

Dotyczy Zadania nr 20 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych o masie ciała powyżej 40kg, objętości resuscytatora 1650 ml, objętości rezerwuaru tlenu 2000 ml, zastawka bezpieczeństwa 60 cm H₂O. Resuscytator wykonany z medycznego PCV/EVA/PP i silikonu, bez zawartości lateksu, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka. W zestawie z jednorazową maską twarzową z mankietem dla dorosłych, dren tlenowy? Zamawiający korzysta obecnie z takiego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 169

Dotyczy Zadania nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej) o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 38 g, dla objętości oddechowej 200-1500ml, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 170

Dotyczy Zadania nr 45 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antibakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej) o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H₂O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 171

Dotyczy Zadania nr 45 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o właściwościach filtracji mechanicznej z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o metodzie filtracji intermolekularnej, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, , przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne- z potwierdzonym certyfikatem procesu walidacji sterylizacji, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 172

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 16 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w



ho



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 173

dot. zadania 23 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie układu z Ykiem bez portu oraz bez kolanka z portem luer lock spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego

Pytanie nr 174

dot. zadania 23 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie układu z Ykiem bez portu rozciągliwego do 2 m z dodatkowym ramieniem rozciągliwym do 150 cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego

Pytanie nr 175

dot. zadania 28

Prosimy o dopuszczenie zestawów wyposażonych w nebulizatory o pojemności 10 ml, dren 2,1 m i ustnik.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 176

dot. §3 ust. 2, §4 ust. 3, §7 ust. 1 pkt 2, §9 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 5

Zwracamy się z prośbą o poprawienie oczywistych omyłek poprzez zastąpienie zapisów dotyczących Rękawic odpowiednimi zapisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawki oczywistej omyłki pisarskiej

Jest: rękawic

Winno być: sprzętem jednorazowego użytku

Pytanie nr 177

Załącznik nr 5 Umowa

§2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 178

Załącznik nr 5 Umowa

§7 ust. 1 pkt 2)

Upriejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,2% ?

Odpowiedź:





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 179

zadanie 5, poz. 1-3,

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 179a

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 180

Zadanie 20, poz. 1-5

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 181

Zadanie 20, poz. 4

czy zamawiający dopuści dren o dł. ok. 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 182

Zadanie 42, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 183

Zadanie 42, poz. 7,9,13,41,46,37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 184

Zadanie 42, poz. 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 185

Zadanie 42, poz. 6,7,9,13,20-22,35,37,40-43,46

Czy zamawiający wydzieli poz.6,7,9,13,20-22,35,37,40-43,46 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 186

zadanie 42, poz. 43

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 187

Zadanie 43, poz. 1

czy zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych , posiadający igłę biorczą 2 – kanałowa, bez pierścienia lub skrzydełek, przeciwbakteryjny filtr powietrza, komora kropłowa o długości min. 55 mm w części przezroczystej, 20 kropli = 1ml ± 0,1ml, wielkość oczek filtra do płynów 15µm, długość drenu min. 150cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik luer = lock, opakowanie jednostkowe typu folia-papier, całość wolna od plastyfikatorów ftalanowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 187 a

Zadanie 43, poz. 1





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na opakowaniu jednostkowym o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty produkcji.

Pytanie nr 187 b

Zadanie 43, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 187 c

Zadanie 43, poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 188

Zadanie 43, poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójplaszczynowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier – folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 188 a

Zadanie 43, poz. 2


Czy zamawiający dopuści przyrząd bez skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 188 b

Zadanie 43, poz. 2





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 188 c

Zadanie 43, poz. 2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 188 d

Zadanie 43, poz. 2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na opakowaniu jednostkowym o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty produkcji.

Pytanie nr 189

Zadanie nr 8, pozycja nr 1 (Rurki intubacyjne z mankietem)

Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne z mankietem, przezroczyste?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 190

Zadanie nr 8, pozycja nr 1 (Rurki intubacyjne z mankietem)

Czy zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe zachowujące kształt rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 191

Zadanie nr 8, pozycja nr 2 (Rurki intubacyjne bez mankieta)

Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne bez mankieta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 192

Zadanie nr 8, pozycja nr 2 (Rurki intubacyjne bez mankieta)

Czy zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe zachowujące kształt rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 193





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zadanie nr 8, pozycja nr 5 (Rurki tracheostomijne)
Czy zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z pojedynczym mankietem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 194

Zadanie nr 8, pozycja nr 5 (Rurki tracheostomijne)

Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki tracheostomijne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 195

Zadanie nr 8, pozycja nr 7 (Prowadnica do ukształtowania poz. 2)

Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze 3,3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 196

Zadanie nr 8, pozycja nr 9 (Prowadnica do ukształtowania poz. 4)

Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze 4,7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 197

Zadanie nr 16, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CHh24-Ch25?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 198

Zadanie nr 16, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- zamykany port do podawania leków z końcówką Luer
- przezroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódcie łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 199

Zadanie nr 16, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 200

Zadanie nr 20, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 201

Zadanie nr 20, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe od 10 – 20kg?





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 202

Zadanie nr 20, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe od 20 – 30kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 203

Zadanie nr 20, pozycja nr 8

Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe od 30 – 50kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 204

Zadanie nr 20, pozycja nr 9

Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe od 50 – 70kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 205

Zadanie nr 20, pozycja nr 10

Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe od 70 – 100kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 206

Zadanie nr 20, pozycja nr 11-17

Czy zamawiający dopuści maski bez kodowanej kolorem etykiety?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 207

Zadanie nr 20, pozycja nr 11-17

Czy zamawiający dopuści maski z nadrukowanym rozmiarem na etykiecie (cyfrowo)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 208

Zadanie nr 20, pozycja nr 18

Czy zamawiający dopuści resuscytator z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 209

Zadanie nr 20, pozycja nr 18

Czy zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych o masie ciała powyżej 40kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 210

Zadanie nr 20, pozycja nr 18



Handwritten signature or mark.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Czy zamawiający dopuści resuscytator z zaworem bezpieczeństwa 60 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 211

Zadanie nr 20, pozycja nr 18

Czy zamawiający dopuści resuscytator z workiem o objętości 1600ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 212

Zadanie nr 20, pozycja nr 18

Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem o objętości 2000ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 213

Zadanie nr 20, pozycja nr 18

Czy zamawiający dopuści resuscytator z drenem o długości 2,1m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 214

Zadanie nr 23, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 2m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 215

Zadanie nr 23, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rurą o długości 120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 216

Zadanie nr 23, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 217

Zadanie nr 27, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści materiał AS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 218


Zadanie nr 27, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści przyrząd bez filtra?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.





Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS

0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 219

Zadanie nr 36, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną, suchą, sterylną, bez detergentów, sterylizowana tlenkiem etylenu, wymiary: 9 x 4,5 x 3,5 cm, miękka i elastyczna, ale na tyle twarda by dobrze spełnić swoje zadanie, gąbka umożliwi namydlenie i czyszczenie obszarów między palcowych i delikatnych powierzchni, przedramienia i wyczyszczenie paznokci, szczotka zapobiega uszkodzeniom naskórka i umożliwia optymalne mycie, w części środkowej są one niższe i twardsze umożliwiając dokładne umycie paznokci?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 220

Zadanie nr 36, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści myjki nasączone środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 aktywowanym pod wpływem wody, o wymiarach: 24,5 x 17 cm, zaokrąglony ergonomiczny kształt i zwężenie w nadgarstku - zapobiegają zsuwaniu się, zgrzewana ultradźwiękowo, a nie zszywana – dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta, wykonana z obu stron z poliestru o gramaturze 100g/m² (część przednia) + 70g/m² (część tylna), nie zawiera lateksu, pakowane w opakowanie foliowe po 20 sztuk, wyrób oferowany na 23% VAT, tak jak dotychczas stosowane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 221

Zadanie nr 36, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści myjki nasączone środkiem myjącym oraz nawilżającym o neutralnym pH 5,5 aktywowanym pod wpływem wody, o wymiarach: 24,5 x 17 cm, zaokrąglony ergonomiczny kształt i zwężenie w nadgarstku - zapobiegają zsuwaniu się, zgrzewana ultradźwiękowo, a nie zszywana – dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta, wykonana z obu stron z poliestru o gramaturze 100g/m² (część przednia) + 70g/m² (część tylna), nie zawiera lateksu, pakowane w opakowanie foliowe po 20 sztuk, wyrób oferowany na 23% VAT, tak jak dotychczas stosowane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 222

Zadanie nr 36, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści golarki typu GALLANT jednorazowego użytku, niesterylna, nie zawiera lateksu, wykonana z tworzywa HIPS (polistyren wysokiej udarności), posiada pojedyncze ostrze ze stali nierdzewnej, które pokryte jest warstwą PTFE (teflon, platinum, diamond), dodatkowo w prosty sposób ostrze można odłamać od rączki poprzez lekki pionowy nacisk, golarka wyposażona jest w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu się ostrza, długość całkowita 6 cm, szerokość ostrza ok. 4 cm, głębokość 0,01 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 223

Zadanie nr 37, pozycja nr 1





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Czy zamawiający dopuści równoważny Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi i ukośną zastawką do regulacji siły ssania oraz gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce, 1 gąbkę-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml żelu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i aloesem.

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami literaturowymi skuteczności w redukcji VAP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 224

Zadanie nr 37, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi i ukośną zastawką do regulacji siły ssania oraz gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu z 0,1% roztworem nadtlenu wodoru w saszetce, 1 gąbkę-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml żelu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i aloesem.

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami literaturowymi skuteczności w redukcji VAP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 225

Zadanie nr 37, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej przez 20 sekund przy mocy 700W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 226

Zadanie nr 37, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści produkt na stawce VAT 23%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 227

Zadanie nr 42, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści wagę ok. 60g (bez opakowania)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 228

Zadanie nr 42, pozycja nr 11

Czy zamawiający dopuści pojemność 250ml?



60



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 229

Zadanie nr 42, pozycja nr 18

Czy zamawiający dopuści opaski w kolorze beżowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 230

Zadanie nr 42, pozycja nr 19

Czy zamawiający dopuści opaski w kolorze beżowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 231

Zadanie nr 42, pozycja nr 19

Czy zamawiający dopuści opaski niejałowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 232

Zadanie nr 42, pozycja nr 23

Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 125mm, średnicy górnej 140mm oraz średnicy dolnej 102mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 233

Zadanie nr 42, pozycja nr 23

Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 120mm i wymiarach 100mm x 55mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 234

Zadanie nr 42, pozycja nr 24

Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 125mm, średnicy górnej 140mm oraz średnicy dolnej 102mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 235

Zadanie nr 42, pozycja nr 25

Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 160mm, średnicy górnej 165mm oraz średnicy dolnej 120mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 236

Zadanie nr 42, pozycja nr 26

Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5-4l, o wysokości 155mm?



h



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 237

Zadanie nr 42, pozycja nr 27

Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5-4l, o wysokości 155mm, średnicy górnej 240mm oraz średnicy dolnej 200mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 238

Zadanie nr 42, pozycja nr 36

Czy zamawiający dopuści pojemność 550ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 239

Zadanie nr 42, pozycja nr 43

Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 240

Zadanie nr 42, pozycja nr 44

Czy zamawiający dopuści czarne worki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 241

Zadanie nr 42, pozycja nr 47

Czy zamawiający dopuści zaciskacz do pępownicy o parametrach:

- Jednorazowego użytku
- Wykonany z polipropylenu
- Długość: ok. 55mm
- Pakowany pojedynczo, w opakowaniu papier-folia
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie zbiorcze 100szt.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 242



6



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zadanie nr 42, pozycja nr 48

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 115cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 243

Zadanie nr 45, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 244

Zadanie nr 45, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 245

Zadanie nr 45, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna



Handwritten signature or mark.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 246

Zadanie nr 45, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 247

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 1.2 wskazał: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

2) za zwłokę w realizacji dostaw na podstawie zamówień Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości Rękawic niedostarczonych w terminie, za każdy dzień zwłoki.

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 1.2 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,25% wartości .

Odpowiedź:





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający dokonuje zmiany w § 7 ust. 1.2 wzoru umowy obniżając karę umowną do 0,2%.

Pytanie nr 248

Zadanie 10 poz. 1

Czy zamawiający dopuści łyżki wykonane z tworzywa sztucznego wysokiej jakości odpornego na odkształcanie i uszkodzenia, spełniające wszystkie pozostałe wymogi SWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 249

Zadanie 20 poz. 4

Czy zamawiający dopuści dren do nebulizatora o długości 2m ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 250

Zadanie 20 poz. 18

Czy zamawiający dopuści resuscytator o całkowitej pojemności worka 1547ml i maksymalnej objętości oddechowej 1000 ml przy uciskaniu oburącz, spełniający wszystkie pozostałe wymogi SWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 251

Zadanie 20 poz. 18

Czy zamawiający oczekuje resuscytatora z paskiem na dłoń trwale połączonym z workiem samorozprężalnym i podwójnie obrotowym zaworem pacjenta ? Rozwiązanie takie zapewnia znacznie większą swobodę ruchów osoby prowadzącej resuscytację co zmniejsza zmęczenie i przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 252

Zadanie 28 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw z drenem długości 2m, spełniający wszystkie pozostałe wymogi SWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 253

Zadanie 45 poz. 1

Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999 % , p/wirusowej: >99,999 %, mniejszej przestrzeni martwej 55 ml, oporach przepływu: 2,14 cm H2O przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o lepszym nawilżaniu 37 mg H2O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, większy zakres objętości oddechowej Vt 150-1500 ml, waga 35,6 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, okrągły.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 254





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zadanie 45 poz. 2

Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999 % , p/wirusowej: >99,999 %, przestrzeni martwej 55 ml, znacznie mniejszych oporach przepływu: 0,82 cm H₂O przy 30 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 37 mg H₂O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, większy zakres objętości oddechowej V_t 150-1500 ml, waga 35,6 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, okrągły.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 255

Pakiet 23 Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o następujących cechach:

Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 255 a

Pakiet 23:

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o następujących cechach:

Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 256

Pakiet 42:

Prosimy o sprecyzowanie czy łącznik martwa przestrzeń ma być pozbawiony DEHP i BPA?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łącznik martwa przestrzeń nie zawierał DEHP i BPA.

Pytanie nr 256 a

Pakiet 42:

Prosimy o sprecyzowanie czy łącznik martwa przestrzeń ma posiadać piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny, co ułatwia jego stosowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.


Pytanie nr 257

Pakiet 43

Poz.1



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kropłową o długości min. 60 mm w części przezroczystej
Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje powyższego.

Pytanie nr 258

Pakiet 43

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kropłową wolną od PCV

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 259

Pakiet 43

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ma nie zawierać ftalanów (w tym DEHP) i lateksu (informacja o braku zawartości ftalanów i lateksu fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)

Odpowiedź:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ma nie zawierać ftalanów (w tym DEHP) i lateksu (informacja o braku zawartości ftalanów i lateksu fabrycznie nadrukowana na opakowaniu).

Pytanie nr 260

Pakiet 43

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kropłową bez zawartości bez PCV ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kropłową bez zawartości bez PCV.

Pytanie nr 261

Pakiet 43

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania krwi ma nie zawierać ftalanów (w tym DEHP) i lateksu (informacja o braku zawartości ftalanów i lateksu fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)

Odpowiedź:

Tak , przyrząd do przetaczania krwi ma nie zawierać ftalanów (w tym DEHP) i lateksu (informacja o braku zawartości ftalanów i lateksu fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym).

Pytanie nr 262

Pakiet 46



Handwritten signature



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego portu do wielokrotnego wkłucia o poniższych parametrach:

Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa .0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście do naczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylno- sterylizacja radiacyjna . jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty Badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 263

Pakiet 46

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór ma nie wywoływać refluksu krwi do światła cewnika, czyli ma posiadać neutralne ciśnienie przy odłączeniu od zaworu końcówki luer?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 264

Zadanie 1 poz. 11-14

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 265

Zadanie 5 poz. 1-17

Prosimy o dopuszczenie strzykawek z nazwą lub logiem na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 266

Zadanie 5 poz. 1, 3

Prosimy o dopuszczenie strzykawki z logiem i typem strzykawki na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 267

Zadanie 5 poz. 1, 3



5



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Prosimy o dopuszczenie strzykawkki typu omnifix z 4 stronnym podcięciem tłoczyska

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 268

Zadanie 5 poz. 4 - 7

Prosimy o dopuszczenie strzykawk 2-częściowych z kontrastującym tłokiem w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 269

Zadanie 5 poz. 4 - 7

Prosimy o dopuszczenie strzykawk pakowanych w opakowanie po 100szt(2ml, 5ml, 10ml) , 80szt(20ml) z możliwością przeliczenia ilości w formularzu cenowym.


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 270

Zadanie 5 poz. 12 - 15

Czy Zamawiający w wyżej wymienionych pozycjach ma na myśli strzykawkki 3 częściowe luer lock czy luer?

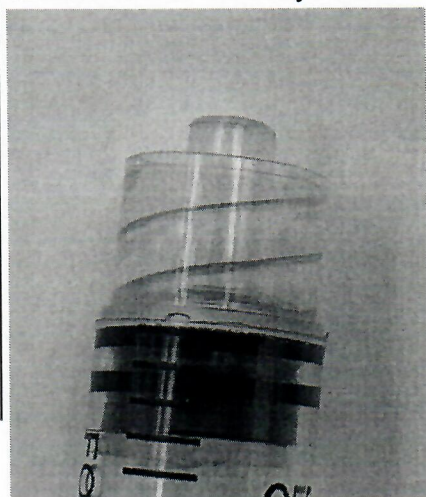

Po lewej Luer lock



Po prawej Luer

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli strzykawkki luer lock.

Pytanie nr 271

Zadanie 5 poz. 12 - 15

Prosimy o dopuszczenie strzykawk 3-częściowych luer o podanych parametrach

- Przezroczysty cylinder pozwala na doskonałą wizualizację zawartości
- Dokładność i bezpieczeństwo
- Czarne oznaczenie skali: dokładność stopniowania objętości



Handwritten signature



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



- Tłok zbudowany według zasad ergonomii pozwala na jednoręczne stosowanie strzykawki
- Jałowa niepirogenna
- Cylinder: polipropylen
- Tłok: polietylen
- Indywidualnie pakowane: papier / folia
- Skala rozszerzona tj. 3ml; 10-12ml; 20-22 ml; 50-60ml

Opis	Zakończenie	Skala	Opakowanie
3 ml Luer	Centryczne	0, 1 ml	100 szt.
10 ml Luer	Ecentryczne	0, 2 ml	100 szt.
20 ml Luer	Ecentryczne	1 ml	50 szt.
50 ml Luer	Ecentryczne	1 ml	50 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 272

Zadanie 5 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie strzykawek 3-częściowych luer lock 5ml z rozszerzoną skalą pomiarową do 6 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 273

Zadanie 6 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do TBC z igłą o wymiarach 0,45 x 13 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 274

Zadanie 6 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do TBC z typem strzykawki na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 275

Zadanie 7 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o podanych parametrach:

- Wykonana z najlepszej jakości biokompatybilnego medycznego PUR
- Wyposażona w sześć pasków radiocieniujących – widoczna w RTG i USG
- Wyposażona w metalowy automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, w postaci zatrzasku na końcu igły
- Posiada filtr hydrofobowy, który zapobiega przeciekaniu krwi podczas kaniulacji



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS

0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



- Silikonowa zastawka w porcie iniekcyjnym zapobiega cofaniu się krwi
- Transparentna komora wpływu wstecznego zapewnia natychmiastową kontrolę poprawności wkłucia.
- Skrzydełka oraz korek portu bocznego (iniekcyjnego) kodowany kolorystycznie
- Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi, prążkowany
- Gładka miękka, elastyczna powierzchnia
- Stożkowe zakończenie cewnika jest ustawione osiowo ze skosem igły aby zapewnić łagodne przejście z igły do cewnika
- Elastyczne skrzydełka w pozycji złożonej z dziurkami umożliwiają zamocowanie kaniuli plasterm lub jej przyszycie co przekłada się na lepszą stabilizację kaniuli w żyłę,
- Silikonizowana igła wykonana ze stali nierdzewnej, tylny szlif zapewnia ostrość igły co ułatwia wkłucie i poprawia komfort pacjenta podczas kaniulacji
- Nasadka chroni igłę i cewnik przed zanieczyszczeniem
- Minimalny opór podczas zabiegu iniekcyjnego spowodowany niskim współczynnikiem tarcia
- Cienkie ścianki cewnika pozwalają na maksymalny przepływ płynów
- Jednorazowego użytku, sterylne, nietoksyczne, niepirogenna
- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem
- Na opakowaniu jednostkowym zawarta m.in. informacja o średnicy, długości kaniuli, przepływach; dacie ważności, nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula
- Nie zawiera plastyfikowanego PVC, lateksu, DEHP

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 276

Zadanie 7 poz. 2-3

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o podanych parametrach:

Cewnik wykonany z PTFE

- Wolna od PVC i lateksu.
- Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi
- Widoczna w USG posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG
- Posiada port iniekcyjny zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem
- Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekaniem krwi
- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



- Igła silikonizowana, ostrze igły typu back-cut, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
- Stożkowa końcówka kaniuli, umożliwiająca łatwe wprowadzenie do żyły
- Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem.



Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Żółta	24 G	0,7 x 19	18 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	10 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 277

Zadanie 7 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu bezigłowego o podanych parametrach:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje minimalizację przestrzeni martwej pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu
- Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ grawitacyjny na poziomie min. 320 ml/min
- Przepływ uzyskany w mankiecie ciśnieniowym wynosi 645 ml/min
- Ciśnienie płynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI, ciśnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSI
- Wytrzymałość zaworu na ciśnienie 24 Ba, objętość wypełnienia 0,085 ml/
- Kompatybilny z MRI, brak metalowych części
- Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami
- Zgodny min. z normą PN-EN ISO 10555-5
- Możliwość podawania krwi, tłuszczów, chemioterapeutyków, stosowania do hemodializy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



h



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 278

Zadanie 7 poz. 5-8

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 279

Zadanie 7 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie motylka z igłą o dł. 25 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 280

Zadanie 7 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie motylka z igłą o dł. 28 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 281

PAKIET 5

Pakiet 5, pozycja 1,3,12

Pakiet 5, pozycja 1,3,12 , w związku z wymogiem kompatybilności strzykawk z pompami. Prosimy o podanie listy pomp będących w posiadaniu Szpitala , do których sa dedykowane strzykawki 3 częściowe?

Odpowiedź:

BD, MEDIMA, FRESENIUS, ASCOR, KWAPISZ, AGILA

Pytanie nr 282

Pakiet 5, pozycja 1,3,12 czy pod pojęciem „wkalibrowane” zamawiający rozumie strzykawki wymienione w oryginalnej instrukcji użycia pomp infuzyjnych , oraz wymienione fabrycznie w menu pompy .

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 283

Pakiet 5, pozycja 1,3,12 Prosimy o dopuszczalne strzykawki 50/60 ml bez skali tłocznej co 1 ml oraz prostopadłego wycięcia na tłoku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 284

Czy zamawiający oczekuje w Pakiet 5, pozycja 1,3,12 strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej , trzyczęściowej, koncentrycznej , pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Wykonanej w całości z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, skala co 1ml do 60 ml , skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określającej pojemność nominalną), tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinań się tłoka. Podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 285

Pakiet 5, pozycja 1,3,12 prosimy o doprecyzowanie , czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty pisma potwierdzającego kompatybilność oferowanych strzykawek z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków,)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 286

Pakiet 5, pozycja 1,3,12 prosimy o doprecyzowanie , czy Zamawiający oczekuje aby strzykawki posiadały Typ strzykawki i logo producenta na cylindrze dla łatwego wyszukania strzykawki w menu pompy . Opakowanie 60 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 287

Pakiet 5, pozycja 3 prosimy o doprecyzowanie , czy Zamawiający oczekuje strzykawki bursztynowej, do leków światłoczułych , choniącej przed światłem o długości fali od 290 do 450 nm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 288

Prosimy o dopuszczenie w Pakiet 5, pozycje 4,5,6,7 strzykawki 2 częściowej bez rozszerzonej skali, z mlecznym tłokiem, z logo producenta na cylindrze ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 289

Czy zamawiający oczekuje w Pakiet 5, pozycje 4,5,6,7, strzykawek. na opakowaniu jednostkowy z oznakowanie Luer Tip (6%), potwierdzającym spełnienie Normy EN-20594 lub normy PN-EN ISO 80369-7:2017-08 w zakresie rozmiaru stożka Luer, co zapewnia bezwzględna szczelność strzykawki .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 290

Pakiet 5, pozycja 9


Czy w pakiecie 5 pozycja 9 Zamawiający oczekuje precyzyjnej strzykawki 3 częściowej o pojemności 1 ml, skala 0,01 ml , do tuberculin o minimalnej przestrzeni martwej na poziomie : minimum 0,021ml , maximum 0,035ml , w całości z polipropylenu, cylinder silikonowany dla płynnego przesuwu tłoka. ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 291

Pakiet 5, pozycja 11



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do insuliny z wtopioną igłą o rozmiarze 0,33 x 12,7 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 292

Pakiet 5, pozycje od 13 do 17 Prosimy o dopuszczenie strzykawek w całości (Tłok i cylinder) wykonanych z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, bisfenol A kompatybilnych z lekami cytostatycznymi

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 293

Pakiet 5, pozycje 13- 17 czy Zamawiający oczekuje pisma potwierdzającego kompatybilność z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków,)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kompatybilności strzykawek z lekami cytostatycznymi.

Pytanie nr 294

Pakiet 5, pozycje 16 czy nie zaszła omyłka pisarską i Zamawiający oczekuje strzykawki 30 ml a nie 3 ml ponieważ te znajdują się już w pozycji 15?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w Pakiet 5, pozycje 16 ze strzykawki 3 ml na strzykawkę 30 ml.

Pytanie nr 295

Pakiet 5, pozycje 1, 3, 12 do 17 czy zamawiający oczekuje aby wszystkie strzykawki trzyczęściowe z zakończeniem luer lock w pochodziły od jednego producenta dla zagwarantowania jakości wszystkich oferowanych produktów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje powyższego.

Pytanie nr 296

PAKIET 7

Pakiet 7, pozycja 1 , prosimy o wyłącznie kaniul w rozmiarze 24 z pozycji 1 ponieważ kaniula w rozmiarze 24 G znajdują się jako osobna pozycja nr 3 w tym samym pakiecie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje wyłączenia pozycji 1 z pakietu 7.

Pytanie nr 297

Pakiet 7, pozycja 1 , Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje Kaniul w pozycji 1 pakiet 7 wyposażonych w dodatkowy otwór na ostrzu igły, umożliwiający natychmiastowe, wzrokowe potwierdzenie wejścia naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi) tylko w rozmiarach 22 G – 18 G?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 298

Pakiet 7, pozycja 4 Czy zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycja 4, alternatywnego





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



zamkniętego systemu dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim w kolorze różnym niż zawór, pakowany pojedynczo, rozmiar ok 0,20 mm; waga 1g. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymanie zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml. Informacja o objętości wypełnienia na opakowaniu jednostkowy. Ilość aktywacji 100. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Ten sam producent co kaniule lub rekomendowany i sprzedawany przez producenta kaniul, umieszczony w katalogu producenta kaniul pod nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania szczelności dla kaniul obwodowych, koreczków i portów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 299

Pakiet 7, pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zaworu bezigłowego pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 7 dni lub 200 użyć, obudowa przezroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, dostępny także w wersji tętnicznej z czerwoną obudową wg potrzeb zamawiającego, nie zawierający metalu oraz lateksu. Membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie 326 PSI wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi, przepływ do 600 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, zawór wyposażony w zdejmowalny uchwyt umożliwiający bezpieczne wyjęcie z opakowania i podłączenie do wkłucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podłączenia.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 300

Czy zamawiający oczekuje aby wszystkie kaniule i zawory bezigłowe w pakiecie 7, w pozycjach 1,2,3,4,5 pochodziły od jednego producenta, tak aby zapewnić pełną kompatybilność sprzętów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje powyższego.

Pytanie nr 301

Pakiet 7, pozycja 4 Czy oczekuje kaniuli dotętnicznej wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE?



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 302

Pakiet 7, pozycja 4 Czy oczekuje kaniuli dotętnicznej aby kaniula dotętnicza posiadała potwierdzony czas stosowania do 30 dni w instrukcji użycia załączonej do każdego opakowania zbiorczego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 303

Czy Zamawiający oczekuje aby oferenci dołączyli do składanych ofert, w zakresie zadania 7, możliwość dla Zamawiającego do skorzystania z platform e-learningowych, zawierających materiały szkoleniowe, jako dokształcanie personelu, dające możliwość:

- administrowania sesjami użytkowników (dodawania i usuwania użytkowników) przez przedstawiciela szpitala
- monitorowania postępów poszczególnych uczestników szkoleń on-line przez administratora ze strony szpitala
- każdy moduł szkoleniowy zakończony obiektywnym testem sprawdzającym
- automatycznego wygenerowania certyfikatu uczestnictwa ukończenia szkolenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 304

Czy w załączniku nr 2, Pakiet 7 opis przedmiotu do pozycji 6, 7 i 8, nie wystąpił błąd pisarski. Mowa jest o igłach motylkowych w rozmiarach 23G, 25G, 27G a w pozycjach są inne, podane przez Zamawiającego, parametry techniczne produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej w opisie igieł typu Motylek który znajduje się nad pozycją 7, prawidłowy opis dotyczący rozmiarów znajduje się w pozycji 7,8,9 (G23,G22,G21).

Pytanie nr 305

Pakiet 7 pozycje 6 i 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igieł motylkowych z wężykiem o długości 305 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 306

Pakiet 7 pozycja 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły motylkowej o wymiarach 25G 0,5 mm, długość igły 19mm, o długości wężyka 305 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 307

Pakiet 7 pozycja 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły motylkowej o wymiarach 25G 0,5 mm, długość igły 19mm, o długości wężyka 305 mm bez końcówki typu luer lub o długości wężyka 178 mm z końcówką typu Luer. Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego?

Odpowiedź:





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 308

PAKIET 43

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 43 pozycja 1 alternatywnego aparatu do infuzji grawitacyjnej. Zestaw do infuzji grawitacyjnej - komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej. Spike ABS, igła czterokanalowa/ stożek. Kompatybilny z lipidami, zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu - bez kieszeni na kolec, bez PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A. Długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony. Objętość wypełnienia drenu 11 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO. Złącze luer lock stale. Komora kroplowa o długości 57mm, na opakowaniu jednostkowym, oznakowanie kolorystyczne inne niż dla aparatów do krwi, oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod. Opakowanie 200 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 309

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 43 pozycja 2 alternatywnego zestawu do transfuzji (przetaczania) krwi, bez odpowietrzenia, komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 200 µm, długość min. 90mm, spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet. Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, kompatybilny z lipidami, długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony całość zestaw - 192cm. Objętość wypełnienia drenu 14 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO. Złącze luer lock stale. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 310

Pakiet 46, pozycja 1

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oferowany zawór na obudowie konektora ma osiadać naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymanie zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 311

Prosimy aby Zamawiający odstąpił od wymogu aby pełnomocnictwo wskazywało postępowanie, którego dotyczy, prośbę swą motywujemy faktem, iż Wykonawca przystępując do wielu postępowań przetargowych nie jest w stanie do każdego przetargu wystawiać oddzielnego pełnomocnictwa, natomiast dysponuje ogólnym pełnomocnictwem, które upoważnia ogólnie do reprezentowania w postępowaniach przetargowych.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu aby pełnomocnictwo wskazywało postępowanie którego dotyczy.



KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz