

Oleśnica, 17 grudnia 2024 r.

**Znak sprawy: PZS/TP/26/2024**

**Dotyczy postępowania :**

**„Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku II dla Powiatowego Zespołu Szpitali”**

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 15** w pozycji 1 (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę luer-lock 30 ml; zestaw spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umownego zawartego w § 6 ust. 1 w następujący sposób:

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę 10% niezrealizowanej części umowy, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego na wykonanie zobowiązania w należyty sposób. Termin ten nie może być krótszy, niż 30 dni.

c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawnionych przez Zamawiającego 10% niezrealizowanej części umowy, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego na wykonanie zobowiązania w należyty sposób. Termin ten nie może być krótszy, niż 30 dni.

**Odpowiedź:**


Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu umownego w § 6 ust. 1.

**Pytanie 3:**


Zadanie nr 8 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy obwód pacjenta do wentylacji nieinwazyjne, jednorurowy z portem przeciekowym, z zabezpieczeniem wydychanego powietrza filtrem antybakteryjnym/antywirusowym. Obwód wyposażony w filtr na wejściu do układu (co filtruje powietrze wydechowe pacjenta). Złącze do wylotu respiratora: 22mm stożkowe, kompatybilny z maskami Philips Respironics ,opakowanie zb.

50 szt.?



Sposób podłączenia przedstawia poniższy schemat.

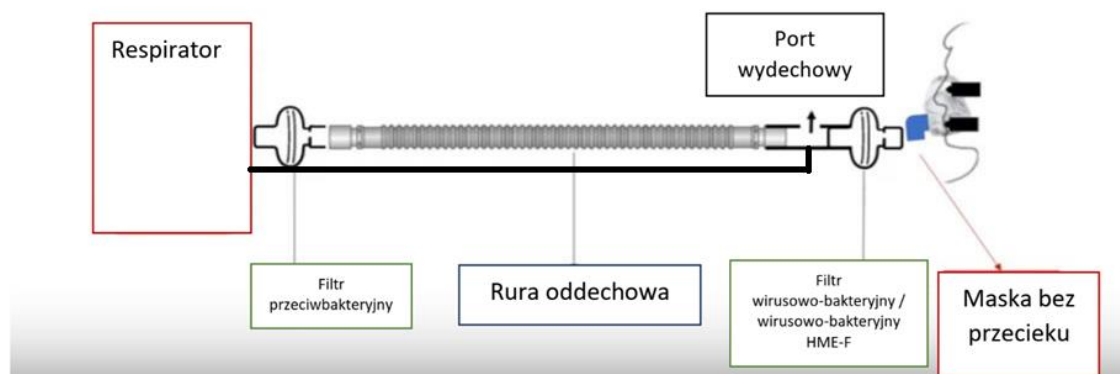

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4:**

**Zadanie 22 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą odpowiednio do rozmiarów: 0-25ml, 1-47ml, 2-83ml, 3-125ml, 4-195ml, 5-242ml, 6-330ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5:**

**Zadanie 22 poz. 2-4**

Czy Zamawiający dopuści maski sterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6:**

**Zadanie 22 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wyposażoną w 6 zwężek Venturiego (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 7:**

**Zadanie 22 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści złącze standardowe z obu stron?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 8:**

**Zadanie 22 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy
- port do odsysania zamykany manualnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 9:**

**Zadanie 22 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści długość 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10:**

**Zadanie 22 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści rurę do worka o długości 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 11:**

**Zadanie 22 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych wyrównujący siłę uciśnięć poj.1650ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 2000 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 5
- Zawór ciśnieniowy 60cmH2O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 12:**

**Zadanie 22 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z jedną maską w zestawie w rozm. 5 (niebieska), natomiast drugą w rozm. 4 (czerwona) dołączoną osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Pytanie 13:**

**Zadanie 22 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci wyrównujący siłę uciśnięć poj. 550 ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 1600 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 2
- Zawór ciśnieniowy 40 cm H<sub>2</sub>O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14:**

**Zadanie 22 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z jedną maską rozm. 2 (żółta) w zestawie, natomiast drugą maskę rozm. 3 (zielona) dołączoną osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 15:**

**Zadanie 22 poz. 16-17**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianległe oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)

- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16:**

**Zadanie 22 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści ślinociąg bez łącznika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 17:**

**Zadanie 22 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści ślinociąg z łącznikiem w innym kolorze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18:**

**Zadanie 22 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 1650 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 19:**

**Zadanie 22 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści średnicę drenów CH24-25?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 20:**

**Zadanie 22 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści osłonę oka gotową do użycia, całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą pożądaną wilgotność rogówki. Idealna w przypadku operacji opadania lub zwiótczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, zdjęcie poglądowe poniżej?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21:**

**Zadanie 23**

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość cięcia ostrza 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blisterów/ pudełko.

Zaproponowane ostrza są kompatybilne z trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 22:**

Zadanie 26

Ze względu na zróżnicowanie asortymentu prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 10, 11 do oddzielnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Pytanie 23:**

Zadanie 26

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie rozmiarów: 25-35cm i 34-47cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 24:**

Zadanie 26

poz. 10 Prosimy o dopuszczenie długości kabla 0,9m lub 3m.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 25:**

Zadanie 26

poz.11 prosimy o dopuszczenie mankietu przeznaczonych dla obwodu 25-35cm, długość mankietu 50cm, szerokość 14,5cm. Dla poprawnego dobrania konektora prosimy o wskazanie rodzaju urządzenia, z którym ma być kompatybilny makiet, lub rodzaju konektora.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 26:**

Zadanie 18

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 85,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8

mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany z ładunkiem. Stapler umożliwiający poprawienie tkanki w staplerze przed wystrzałem. Zamawiający będzie każdorazowo określał rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?  
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 20 sztuk staplerów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 27:**

Zadanie 18

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 85,1 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Bez ogranicznika tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Ładunki pakowane po 6 szt. w opakowania zbiorcze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 28:**

Zadanie 18

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 45 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający poprawienie tkanki w staplerze przed wystrzałem. Jedna dźwignia zamykająco-spustowa. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 29:**

Zadanie 18

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 45 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Ładunki pakowane po 3 szt. w opakowania zbiorcze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 30:**

Zadanie 18

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60 i 90 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

umożliwiający poprawienie tkanki w staplerze przed wystrzałem. Jedna dźwignia zamykająco-spustowa. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 31:**

Zadanie 18

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 60 i 90 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Ładunki pakowane po 3 szt. w opakowania zbiorcze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 32:**

Zadanie 18

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 30 i 45 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający poprawienie tkanki w staplerze przed wystrzałem. Jedna dźwignia zamykająco-spustowa. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Lub

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler zamykający, z prostą główką, o długości linii cięcia 40 mm, posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową, z możliwością ponownego otwarcia szczęk staplera po zamknięciu i poprawienia tkanki, umożliwiający 8 wstrzeleń ładunku podczas jednego zabiegu, załadowany ładunkiem o wysokości zszywek 4,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 33:**

**Zadanie 10 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji osłony o wymiarach 104x230cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 34:**

**Zadanie 10 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w w/w pozycji od wymogu posiadania 4 etykiet samoprzylepnych w związku z posiadanym elektronicznym systemem dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu.

**Pytanie 35:**

Dotyczy pakietu nr 23: Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści Ostrza do strzygarki z nieruchomym ostrzem jednorazowe uniwersalne. Ostrza ogólnego zastosowania do owłosienia ciała, Wydajność golenia - 12 000 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,21 mm , szerokość cięcia 31,5 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie



skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarką którą chcemy przekazać bezpłatnie w ilości 2szt. Ostrze znajduje się na górze strzygarki, nie mając bezpośredniego kontaktu ze skórą pacjenta, a konstrukcja pozwala na bezpieczne golenie, które eliminuje ryzyko uszkodzenia naskórka.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 36:**

Czy Zamawiający potwierdza, że termin dostaw dotyczy dni roboczych (od poniedziałku do piątku)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 37:**

Dotyczy wzoru umowy par. 2 ust. 7 Prosimy o odstąpienie w zakresie pakietów 16 i 23 od wymogu dostarczenia szczegółowej dokumentacji dot. warunków transportu na rzecz załączenia do oferty oświadczenia potwierdzającego, że do momentu dostawy oferowane wyroby są przechowywane i transportowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych oraz uchylenia dyrektywy 93/42/WE, mówi, że: „Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu były zgodne z warunkami określonymi przez producenta.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dostawa odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami. To na Wykonawcy ciąży zapewnienie odpowiednich warunków.

**Pytanie 38:**

Dotyczy wzoru umowy par. 4 ust. 7 Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy” W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §4 ust. 7 niniejszej umowy dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę do wzoru umowy. Wykonawca w przypadku zaistnienia przedmiotowej sytuacji, to znaczy braku płatności w terminie, może wykorzystać narzędzia uregulowane w ogólnieobowiązujących przepisach. Zamawiający pragnie przypomnieć, że na szpitalu będącym jednostką ochrony zdrowia ciąży obowiązek zachowania ciągłości opieki nad pacjentami i zapewnienie dostaw leków jest istotnym elementem tego zobowiązania.

**Pytanie 39:**

Dotyczy wzoru umowy §4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formacie pdf na wskazany adres e-mail?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formacie pdf na adres [sekretariat@pzsolesnica.pl](mailto:sekretariat@pzsolesnica.pl) , Zamawiający udostępnia **zał. nr 3 Wzór Umowy PO ZMIANIE**

**Pytanie 40:**

Wzoru umowy Dotyczy §6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 20% niewykorzystanej części umowy brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę do wzoru umowy.

**Pytanie 41:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Przepisy w sposób szczegółowy określają, jakie dane powinna zawierać faktura (art. 106e ust. 1 ustawy o VAT). Jednym z elementów faktury jest cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji ceny. Znajduje się ona w ustawie z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, natomiast cena jednostkowa towaru (usługi) to cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o informowaniu o cenach).

Tak zdefiniowaną cenę jednostkową należy wykazać na fakturze VAT. Ustawa o VAT w art. 106e ust 11 ustawy o VAT wyraźnie wskazuje, że kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

Regulacja ta ma zastosowanie do wszelkich kwot wykazywanych w fakturze VAT, tj. do wartości netto, kwoty podatku oraz wartości brutto. Celem zaokrąglenia kwot w fakturze jest wykazywanie kwot w pełnych groszach, a nie w ułamkach grosza. Dlatego też należy uznać, że cena jednostkowa będąca niezbędnym elementem faktury VAT podlega również obowiązkowi zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

**PODSTAWA PRAWNA:**

- art. 106e ust. 1 i 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221
- art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług - j.t. Dz.U. z

**Pytanie 42:**

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany towar dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Asortyment będzie zamawiany sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

**Pytanie 43:**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uregulował poruszaną kwestię w poniższych ustępach umowy, opierając się na szczegółowych analizach swoich potrzeb i możliwości. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

Par. 2 ust. 2: Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego całości asortymentu objętego umową. Zamawiający zrealizuje przedmiot umowy w ilości asortymentu nie mniejszego niż 60% wartości całego przedmiotu zamówienia. Wskazane w tym punkcie zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu do umowy.

Par 4 ust. 3; Podane w Załączniku nr 2 do umowy (Formularz asortymentowo – cenowy) ilości poszczególnych pozycji mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Korekty ilościowe nie mogą przekroczyć  $\pm 50\%$  uzgodnionej ilości lub spowodować zwiększenia określonej w § 4 ust. 1 a) wartości brutto umowy.

**Pytanie 44:**

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę do wzoru umowy. Kary umowne nalicza się zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. Powyższą kwestię zamawiający, przygotowując istotne postanowienia umowne, uregulował w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

**Pytanie 45:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawiają wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę do wzoru umowy. Kara na poziomie 25% nie jest karą wygórowaną i jest zgodna z wytycznymi projektu ustawy PZP.

**Pytanie 46:**

Pak. 15 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 1 dopuści Bezpieczny Zestaw Do Punkcji Opłucnej - Torakocentezy , sterylny. Skład Zestawu: Igła Veresa, strzykawka Luer-Lock 60ml, kaniula z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o poj. minimum 2000ml. Worek, kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Igła wprowadzająca igła Veresa wyposażona w zawór jednokierunkowy wentylowy lub zawór samozamykający zapobiegający przedostaniu się powietrza do jamy ciała oraz kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa. Dodatkowy zawór automatyczny lub samozamykający się na cewniku zamykający światło cewnika po wysunięciu igły. Zestaw z cewnikiem o długości w zakresie 12 - 12,5cm umieszczonym na igle, rozmiar 8Fr/CH ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 47:**

**Zadanie 4, pozycja 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu o parametrach:

- Materiał: polipropylen monofilamentowy,
- Taśma przeznaczona do obu metod (TVT,TOT),
- Długość - 60 cm lub 45 cm,
- Szerokość 1,1cm +/- 0,2cm,
- Grubość nitki – 0,16 mm
- Gramatura około 65-75 g/m<sup>2</sup>,
- Masa liniowa: 0,050 – 0,090 g/dm,
- Porowatość – 65%,

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 48:****Zadanie 4, pozycja 1:**

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dołączenia do taśm narzędzia wielokrotnego użytku, jeśli tak to w jakiej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie oczekuje dołączenia do taśm narzędzia wielokrotnego użytku.

**Pytanie 49:****Dot. umowy:**

Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg opisany w § 2., pkt 7 nie dotyczy asortymentu z pakietu 4?

Przepisy prawa stawiają wymagania dotyczące temperatury w transporcie produktów leczniczych; nie stawiają jednak takich wymagań w transporcie wyrobów medycznych.

To na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia towaru w odpowiednich warunkach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby dostawa odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający potwierdza, że na Wykonawcy ciąży zapewnienie odpowiednich warunków.

**Pytanie 50:**

Zadanie 16 Proszek Hemostatyczny.

Czy Zamawiający wymaga, aby proszek hemostatyczny posiadał aplikator o dł. 38 cm z otworem bocznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga.

**Pytanie 51:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy punktowanego za 0 pkt do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 52:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności faktur z 60 do 30 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Pytanie 53:**

Czy Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy dodając do paragrafu 2 ustęp 7 zapis "jeżeli dotyczy". Zapis wskazujący na pomiary temperatury przechowywania i przewozu niektórych produktów nie będzie miał zastosowania dla produktów opisanych w zadaniu 20.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z postanowieniami umowy § 2 ust. 7

**Pytanie 54:**

Pytanie dot. SWZ:

Rozdział 23 ppkt 4 lit a)

Czy Zamawiający dopuści wykaz dostaw o wartości (umowy) brutto minimum w kwocie oferowanego pakietu, w czasie trwania umowy (2 lata)?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SWZ pkt.23 ppkt.4 lit. a)

**Pytanie 55:**

Pakiet 10 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na ramię C 220x100 cm. Pozostałe zgodnie z SWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 56:**

Dotyczy zadania 26, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści odpowiednio mankiety o wymiarach? a. 25-35 cm  
b. 33-47cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 57:**

Dotyczy zadania 26, pozycja 5 Czy Zamawiający poda nr referencyjny obecnie używanego produktu?

**Odpowiedź:**

4026 oraz 4028

**UWAGA : W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z DOPUSZCZENIEM ZAMAWIAJĄCY PROSI, ABY WYKONAWCA ZAMIEŚCIŁ INFORMACJĘ W OFEROWANYM FORMULARZU ASORTYMENTOWO-CENOWYM, ŻE PROPONOWANY PRODUKT ZOSTAŁ DOPUSZCZONY LUB ZAMAWIAJĄCY WYRAZIŁ NA NIEGO ZGODĘ.**

**Zamawiający wprowadza zmiany:**

1 - Załącznik nr 3 Wzór Umowy PO ZMIANIE

Zatwierdziła  
Dyrektor  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
Agnieszka Cholewińska