



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
ul. Szpitalna 10, 64 - 400 Międzychód*

NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249 KRS: 0000005301
Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11 Centrala: tel. 95 748 20 11
e-mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl e-mail: 3000310@zoz.org.pl
www.spzoz-miedzychod.com.pl

AG/ZP-02/2022

Międzychód 06.04.2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na:
sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego użytku

SPZOZ Międzychód informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniami do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 28 w pozycjach 1 i 2 (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta) dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę luer lock 30 ml; zestaw spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 28 w pozycjach 7-9 dopuści rurkę tracheostomijną marki Portex (bez regulacji położenia kołnierza) z termoplastycznego PCW, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankieta; elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; rurka sterylna; rozmiary - zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 28 w pozycjach 7-9 dopuści rurkę tracheostomijną (zbrojoną, z regulowanym położeniem kołnierza), wykonaną z 100% silikonu, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą centymetrowe znaczniki głębokości, oznaczenie na kołnierzu średnicy wewn. i zewn., długości, rodzaju i średnicy mankieta, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; łącznik 15 mm, w zestawie z opaską do mocowania; rurka sterylna; rozmiary - zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 28 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7-9 do odrębnego pakietu; decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostałe pozycje w pakiecie 28.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 44, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową polipropylenową w rozmiarze 8x15 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 6

Pakiet 44, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową polipropylenową w rozmiarze 15x30 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 7

Pakiet 44, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową polipropylenową w rozmiarze 6x11 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 8

Pakiet 58 Czy Zamawiający dopuści ubrania z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m kw.?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 38 poz.2 i poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.2 z pakietu nr 38 i utworzenie nowego, odrębnego pakietu 38a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 38 poz.2 i poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.3 z pakietu nr 38 i utworzenie nowego, odrębnego pakietu 38b, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 38 poz.2 i poz.3

Czy Zamawiający dopuści w poz.3 przetworniki o długości linii 180+30cm z połączeniem z kablem bezpinowym, wodoszczelnym?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12


Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora w poz.2 i poz.3?



Odpowiedź: Drugi rysunek - Edward

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.2 i poz.3 czujników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:

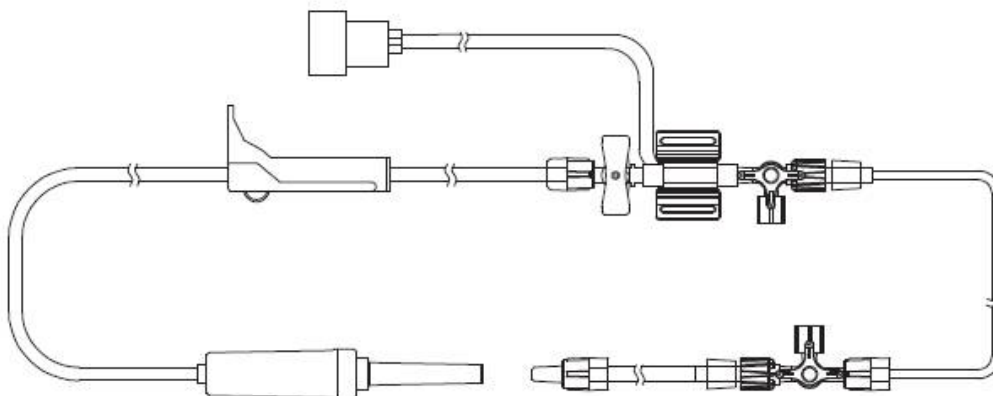

Odpowiedź: Tak, ale z zachowaniem parametrów między innymi długości zgodne z SWZ.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 62, poz. 1: taśmę do operacyjnego leczenia powysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, z plastikową osłonką, jednorodną, niewchłaniającą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84%, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach, wykonaną w technologii quadriaial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych zapobiega deformacji w kierunku skośnym, który jest kierunkiem decydującym jeśli chodzi o deformację, podwójna nić wzmacniająca zapewniająca odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 62, poz. 2: zestaw do operacyjnego leczenia statyki dna miednicy mniejszej, jednorodny, niewchłaniający, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 6 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 4,5 cm, podstawa dolna 6 cm, wykonany w technologii quadriaial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne zielone pętelki,

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o długości 26,5 cm (w tym igła 16,5 cm), do implantacji w/w zestawu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy Pakietu nr 57, pozycja 1-10: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające informację o kolorze wskaźnika po sterylizacji. Informacja o kolorze wskaźnika przed procesem sterylizacji jest nieistotna dla użytkownika oceniającego czy rękaw poddany był działaniu czynnika sterylizującego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 17

Dotyczy Pakietu nr 57, pozycja 1: Czy w miejsce rękawa o szerokości 50mm Zamawiający dopuści rękaw 55mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 18

Dotyczy Pakietu nr 57, pozycja 9: Czy w miejsce rękawa o szerokości 380mm Zamawiający dopuści rękaw 400mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 19

Dotyczy Pakietu nr 57, pozycja 15: Czy Zamawiający dopuści taśmę w rolkach po 50mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakietu nr 57, pozycja 16: Czy Zamawiający dopuści zaferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu nr 57, pozycja 16: Czy Zamawiający dopuści zaferowanie testu w opakowaniu 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu nr 57, pozycja 18: Czy Zamawiający dopuści zaferowanie pakietów testowych Bowie&Dick składających się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru bez pianki?

Odpowiedź: **Tak, dopuszczamy.**

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakietu nr 57, pozycja 18: Czy Zamawiający dopuści testy Bowie Dick z arkuszem przebarwiającym się z koloru niebieskiego na czarny?

Odpowiedź: **Tak, dopuszczamy.**

Pytanie nr 24

Dotyczy Pakietu nr 57, pozycja 19: Czy Zamawiający dopuści etykiet w jednym kolorze – białe z pomarańczowym paskiem?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 25

Dotyczy Pakietu nr 57, pozycja 21: Czy Zamawiający dopuści etykiety w opakowaniu po 1000 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 26

Dotyczy Pakietu nr 57, pozycja 21: Czy Zamawiający dopuści etykiety o wymiarze 67mm x 39,5mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy Pakietu nr 57, pozycja 25: Czy Zamawiający dopuści włókninę w jednym kolorze tj zielonym lub niebieskim?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 28

PAKIET 48 Pozycja 1-Prosimy od dopuszczenie akumulatoroerj strzygarki medycznej innej niż CareFusion.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 29

PAKIET 48 Pozycja 2- Prosimy o dopuszczenie ostrzy kompatybilnych z zaproponowaną strzygarką w pozycji 1 pakietu 48.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 30

PAKIET 48 Pozycja 3- Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu, Chcielibyśmy nadmienić, iż zamawiający ma możliwość wydzielenia pozycji do osobnego Pakietu, gdyż nie jest to postępowanie powyżej progu unijnego oraz nie spełnia przesłanek do zastosowania art 25 ustę 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz 2019).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet 32 Czy Zamawiający dopuści w pak. 32 w poz.3 lusterko krtaniowe sterylne o średnicy 19 mm, długości rączki 180mm ?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 32

Pakiet 44 Czy Zamawiający dopuści w pak. 44 w poz.1- 3 siatki chirurgiczne o rozmiarach:

Poz. 1 - 7,5x15 cm

Poz. 2 – 15x20 cm

Poz. 3 – 6x11 cm?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 33

Pakiet 59. Czy Zamawiający dopuści pułapki 5-komorowe? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 34

Pakiet 61. Czy Zamawiający dopuści igły o długości 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 35

Pakiet 2 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści zestaw grawitacyjny do żywienia dojelitowego do połączenia opakowania diety ze zgłębnikiem - Flocare do worków ze złączem ENFit? W związku z wprowadzeniem przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną standardu dla złączy do podaży żywienia dojelitowego ISO (80369-3), obecnie do żywienia enteralnego stosuje się złącza o nazwie ENFit, mające zapobiegać niewłaściwej podaży płynów. Ponadto w związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane adaptory przejściowe (stożkowate łączniki). Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z adapterami przejściowymi nie są już produkowane.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 36

Pakiet 2 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści zestaw grawitacyjny do żywienia dojelitowego do połączenia opakowania diety ze zgłębnikiem - Flocare do butelek ze złączem ENFit? W związku z wprowadzeniem przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną standardu dla złączy do podaży żywienia dojelitowego ISO (80369-3), obecnie do żywienia enteralnego stosuje się złącza o nazwie ENFit, mające zapobiegać niewłaściwej podaży płynów. Ponadto w związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane adaptory przejściowe (stożkowate łączniki). Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z adapterami przejściowymi nie są już produkowane.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 37

Pakiet nr 6 poz. 1, 2, 3:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważne w cewniki do podawania tlenu przez nos z drenem o długości 200cm, produkt czysty mikrobiologicznie, wykonane z medycznego PVC ? Pozostałe parametry zgodnie z Swz.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 38

Pakiet nr 25 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę z nebulizatorem o następujących parametrach :

- anatomicznie ukształtowania maska,
- materiał pvc,
- dren tlenowy (gwiazdkowy) o dł. 200cm z standardowymi złączami,
- taśma mocująca na głowie,
- pojemność nebulizatora 12ml (skalowane co 2ml),
- Dysza Venturiego,
- blaszka dopasowująca do nosa,
- nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP, PHT) i BPA (bisfenolu A)
- czysty mikrobiologicznie.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 39

Pakiet nr 25 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę z rezerwuarem o następujących parametrach:

- zestaw do wysokiej koncentracji tlenu,
- anatomicznie ukształtowana maska,
- elastyczny medyczny PVC,
- z zaworem zwrotnym,
- dren tlenowy (gwiazdkowy) o dł. 200cm z standardowymi złączami,
- taśma mocująca na głowie,
- blaszka dopasowująca do nosa,
- rezerwuar tlenowy(worek) o poj. 1000ml,
- koncentracja tlenu O₂ do 100%,
- nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP, PHT) i BPA (bisfenolu A)
- czysty mikrobiologicznie.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 40

Pakiet nr 25 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę z drenem o następujących parametrach:

- anatomicznie ukształtowana maska
- delikatny medyczny PVC
- nie zawiera lateksu, ftalanów i BPA (bisfenolu A)
- dren tlenowy (gwiazdkowy) 2 m ze standardowym złączem
- elastyczna taśma mocująca na głowie
- blaszka dopasowująca do nosa
- otwory boczne ułatwiające wydech
- dobrze przylegająca do twarzy
- czysta mikrobiologicznie

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 41

Pakiet nr 31 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy o następujących parametrach :

- średnica rur 22mm,
- rury rozciągliwe w zakresie 50 do 180cm, dodatkowa rura rozciągliwa do 90cm,
- dwa porty w trójniku Y z koreczkami (przymocowanymi),
- zatyczka do szczelności układu i zachowania czystości,
- worek oddechowy 2 litrowy,
- łącznik prosty 22mmM-22mmM,
- czysty mikrobiologicznie, pakowany folia/folia.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Dot. Wzoru umowy:**Pytanie nr 42**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 1a wskazał: Obciążające Wykonawcę:

A) W przypadku opóźnienia terminu dostawy częściowej Przedmiotu Zamówienia z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy – Wykonawcy mogą zostać naliczone kary – za każdy dzień zwłoki od przekazanego zamówienia po 5% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy.

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1a wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 2% wartości.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 43

Pakiet 53 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²), z polipropylenowymi łatami chłonnymi w serwecie anestetycznej i serwecie dolnej, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 44

Pakiet 53 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²), z polipropylenowymi łatami chłonnymi, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²), z serwetą na stolik instrumentariuszki o gramaturze 80 g/m² i serwetą na stolik Mayo z folii o gramaturze 55 g/m², ze wzmocnieniem włókninowym, o całkowitej gramaturze 85 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 45

Pakiet 53 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 48 g/m², wytrzymałość na sucho/ mokro 94/114 kPa? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 46

Pakiet 53 poz. 4, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 47

Pakiet 53 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²), z polipropylenowymi łatami chłonnymi w serwecie anestetycznej i serwecie dolnej, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 48

Pakiet 53 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą do podłożenia pod pacjenta z zakładką do sterylnej aplikacji w rozmiarze 75 x 120 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 49

Pakiet 55 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS ze wzmocnieniami z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), dostępnych w rozmiarze M-L, XL XXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 50

Pakiet 58 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów wykonanych z włókniny SMS? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Dotyczy zapisów SWZ:**Pytanie nr 51**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy Parametry Techniczne:**Pytanie nr 52**

Pakiet 57 ; poz. 1-10 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie normy 868-4. Część 4 dotyczy torebek, co w przypadku zapytania o rękawy nie ma zastosowania.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 53

Pakiet 57 ; poz. 1-10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych z przezroczystego laminatu 8 – warstwowego? Zgodnie z informacją od producenta ilość warstw nie stanowi o stopniu jakości?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 54

Pakiet 57 ; poz. 1-10 Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 55

Pakiet 57 ; poz. 1-10 Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 56

Pakiet 57 ; poz. 18 Czy Zamawiający wymaga, aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 57

Pakiet 57; poz. 25 Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina gwarantowała sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta, a nie dystrybutora? Barrierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową opakowania, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 58

Pakiet nr 5, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59

Pakiet nr 5, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 60

Pakiet nr 5, pozycja nr 10-20 – Czy zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 61

Pakiet nr 6, pozycja nr 1-3 – Czy zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos o długości 2m?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 62

Pakiet nr 10, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści fartuch o długości 116cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63

Pakiet nr 10, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 25-30ml?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 64

Pakiet nr 10, pozycja nr 18 – Czy zamawiający dopuści koc ratunkowy o wymiarach 160 cm x 210 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 65

Pakiet nr 11, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści golarkę z pojedynczym ostrzem o szerokości ok. 4 cm, pakowaną indywidualnie w opakowanie foliowe perforowane, ułatwiające otwieranie?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 66

Pakiet nr 11, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę rękawicę dla dorosłych w rozmiarze 17 x 24,5 cm i grubości ok. 2mm od razu po wyjęciu z opakowania (po czasie / w trakcie użytkowania myjka zwiększa swoją grubość do ok. 0,5cm), zaokrąglony kształt na górze (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku co zapobiega zsuwaniu się, zgrzewana ultradźwiękowo, wykonana z podkładów poliestrowych o gramaturze 100 g/m² (część przednia pokryta mydłem) + 70 g/m² (część tylna bez mydła), nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 aktywowanym pod wpływem wody?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 67

Pakiet nr 15, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści wodę sterylną o pojemności 550ml?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 68

Pakiet nr 15, pozycja nr 3, 4 – Czy zamawiający dopuści produkt niesterylny?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 69

Pakiet nr 16, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści torbę na wymiociny o pojemności 1500ml?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 70

Pakiet nr 16, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści kateter do odsysania pola operacyjnego 7 x 10 x 3000 mm, z końcówką typu Yankauer ok. 21G?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 71

Pakiet nr 16, pozycja nr 7, 9 – Czy zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 210cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 72

Pakiet nr 25, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z nebulizatorem o pojemności 6ml, z maską wykonaną z medycznego PCV, wyposażoną w pojedynczy podbródek oraz metalową blaszkę na nos zapewnia wygodne dopasowanie oraz przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym o długości 2,1m?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 73

Pakiet nr 25, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści maskę tlenową z workiem; maska wykonana z medycznego PCV, wyposażona w pojedynczy podbródek oraz metalową blaszkę na nos zapewnia wygodne dopasowanie oraz przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym o długości 2,1m?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 74

Pakiet nr 25, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści maskę tlenową wykonaną z medycznego PCV, wyposażoną w pojedynczy podbródek oraz metalową blaszkę na nos zapewnia wygodne dopasowanie oraz przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym o długości 2,1m?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 75

Pakiet nr 27, pozycja nr 2 – 5 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu „makiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 76

Pakiet nr 31, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami karbowanymi o maksymalnej długości 1,8m oraz dodatkową gałęzią o maksymalnej długości 1,2m, pakowany w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 77

Pakiet nr 31, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z rurami karbowanymi o długości 2m, pakowany w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 78

Pakiet nr 37, pozycja nr 1-4 – Czy zamawiający dopuści martwą przestrzeń dołączoną osobno?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 79

Pakiet nr 37, pozycja nr 1, 2 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 80

Pakiet nr 37, pozycja nr 3, 4 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81

Pakiet nr 37, pozycja nr 1, 2 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 82

Pakiet nr 37, pozycja nr 3, 4 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 83

Pakiet nr 24, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 20ml?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 84

Pakiet nr 24, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 25ml?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 85

Pakiet nr 47, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści równoważne łyżki do laryngoskopu wykonane w całości ze stopu metalu, światłowód z tworzywa sztucznego o średnicy 5 mm zapewnia jasne i maksymalne oświetlenie, zatrask kulkowy w podstawie koloru zielonego, z światłowodem osłoniętym, kompatybilne ze wszystkimi uchwytami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3, oznakowanie łyżek: nr serii, na grzbiecie łyżki, rodzaj, rozmiar, znak CE, oraz symbol „nie do powtórnego użycia”, (przekreślona cyfra 2) nad stopką od strony wyprowadzenia światłowodu, jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, opakowanie foliowe oznakowane typem, rozmiarem łyżki, znakiem CE, numerem LOT, REF, terminem ważności, nazwą handlową oraz nazwą producenta, dostępne rozmiary MacIntosh: 0, 1, 2, 3, 4, 5; Miller: 00, 0, 1, 2, 3, 4?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 86

Pakiet nr 47, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści równoważny jednorazowy, kompletny laryngoskop gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu łyżki z uchwytem, z załadowanymi bateriami oraz źródłem światła, rękojeść wykonana ze stopu metalu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie; łyżki wykonane ze stopu metalu o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej; z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny, oznakowanie łyżek: nr serii, na grzbiecie łyżki, rodzaj, rozmiar, znak CE, oraz symbol „nie do powtórnego użycia”, (przekreślona cyfra 2) nad stopką od strony wyprowadzenia światłowodu, na opakowaniu jednostkowym widoczne: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, całość pozbawiona lateksu, opakowanie jednorazowe foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia, dostępny w rozmiarach Miller 00, 0, 1, 2, 3, 4, Macintosh 2, 3, 4?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 87

Pakiet nr 49, pozycja nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 88

Pakiet nr 49, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste, pakowane po 10 sztuk, kompatybilne z systemem z pozycji 1?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 89

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 45 – Okularki do fototerapii dla niemowląt. Czy Zamawiający dopuści okularki w następujących rozmiarach: Micro - poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 90

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 45 – Okularki do fototerapii dla niemowląt. Czy Zamawiający wymaga aby okularki posiadały badania dotyczące nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %?. Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okularki należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji, dlatego tak ważne jest aby okularki do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

Pytanie nr 91

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 45 – Okularki do fototerapii dla niemowląt. Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okularki posiadały wkłknięcia od strony oczodołów, co umożliwi fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 92

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 45 – Okularki do fototerapii dla niemowląt. Czy Zamawiający dopuszcza aby okularki składały się z dwóch niezależnych części oraz posiadały dwa rzepy o długości około 24 mm, do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 93

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 39 – układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji . Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości linii wdychowej 150 cm

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 94

Pakiet 51 poz. 6,7 Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min.60g?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 95

Pakiet 51 poz.8 Czy Zamawiający dopuści ręczniki sterylne do osuszania rąk z wzmocnionej, wysokochłonnej, niepylącej, włókniny celulozowej o Gramaturze 70 g/m² w rozmiarze 30x40?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 96

Pakiet 51 poz.9 Czy Zamawiający wymaga serwety sterylnej?

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

Pytanie nr 97

Pakiet 52 poz.1 Czy Zamawiający dopuści Koszula dla położnic - zakładana przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 110cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm Wykonana z miękkiej, miłej w dotyku chłonnej włókniny typu Spunlace (wiskozowo poliestrowej), kolor biały, 55g. Opakowanie a'20szt

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 98

Pakiet 52 poz.1 Czy Zamawiający dopuści Koszula typ V- Koszula dla pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g. Opakowanie a'20szt

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 99

Pakiet 52 poz.3 Czy Zamawiający dopuści Spodenki do kolonoskopii z owalnym wycięciem z tyłu, umożliwiającym wykonanie badania, typu szorty, z gumka w pasie. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: obwód pasie 120cm, Wykonane z włókniny PP 25g kolor zielony.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 100

Pakiet 52 poz.4 Czy Zamawiający dopuści czepek męski typu furażerka wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną o gramaturze 20g/m² w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej, przeciwpotny, zapewniający komfort w trakcie noszenia, jednorazowego użytku, zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń, lekki i dobrze przepuszczający powietrze?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 101

Pakiet 52 poz.7 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m²?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 102

Pakiet 52 poz.7 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 160x210cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 103

Pakiet 52 poz.8 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 104

Pakiet 52 poz.10,11 Czy Zamawiający dopuści pokrowce z włókniny poliestrowo-wiskozowej Spunlace o gramaturze min.45g/m²?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 105

Projekt umowy §6 ust.1 pktA

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do poziomu 1% wartości netto niedostarczonych w terminie towarów, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 106

Pakiet nr 16. poz.1,2,4,5,11.

Zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy system równoważny w skutecznym odsysaniu a zarazem bezpieczny ze względu na właściwości antybakteryjne(badania do wglądu zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych - prosimy o dopuszczenie.

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz zatyczkę do zabezpieczenia portu pacjenta. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych) samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, wymiana wkładu polega na odłączeniu drenu z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości, z szerokim portem do pobierania próbek lub zadawania środka żelującego. Na każdym wkładzie nadrukowana fabrycznie data ważności.

Wkłady oraz kanistry o pojemności 1000ml i 2000ml. Kanistry(okrągłe) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone tylko w zaczep do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnego systemu, ze względu na cechy użytkowe(szczelność, prostotę użytkowania) oraz na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 – do wglądu dla zamawiającego). Brak dopuszczenia innego systemu stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP(zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Zamawiający ma narzędzia np. w postaci zażądania próbek, aby przekonać się, że oferujemy system gwarantujący wzajemną kompatybilność oferowanych wkładów i pojemników oraz skuteczne i bezpieczne odsysanie.

W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 107

Pakiet nr.16.poz.7. Prosimy o dopuszczenie drenu odł.210cm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 108

PAKIET 11, pozycja 2 Czy nie zaszła omyłka pisarska w gramaturze myjki i Zamawiający wymaga myjki o gramaturze 100 g/m² z każdej strony?

Odpowiedź: Tak, wymagamy 100 g/m²;

Pytanie nr 109

PAKIET 11, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o pojemności użytkowej 300 ml i maksymalnej pojemności 600 ml?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 110

PAKIET 11, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści basen płaski o pojemności użytkowej 1,2 - 1,5 l i maksymalnej pojemności 2 l?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 111

PAKIET 11, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści kaczki o pojemności 875 ml?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 112

Pakiet 1, poz. 8-9 Proszę o dopuszczenie strzykawki z pojedyncza skala pomiarową

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 113

Pakiet 1, poz. 10 Proszę o dopuszczenie igły o wymiarze 0,45 x 13

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 114

Pakiet 1, poz. 13 Proszę o dopuszczenie igły o wymiarze 0,7 x 38

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 115

Pakiet 1, poz. 14 Proszę o dopuszczenie igły o wymiarze 0,7 x 32

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 116

Pakiet 1, poz. 10-18 Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Ze względu na możliwość połączeń między urządzeniami i sprzętem jednorazowego użytku.

Pytanie nr 117

Pakiet 1, poz. 19 Proszę o dopuszczenie igły o wymiarze 0.80 x 38 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 118

Pakiet 1, poz. 19 Proszę o dopuszczenie igły o wymiarze 0,80 x 50

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 119

Pakiet 1, poz. 19 Proszę o dopuszczenie igły pakowanej po 100 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 120

Pakiet 1, poz. 28-29 Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach 18 G –1,2 x 30 mm , 18 G – 1,2 x 40 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 121

Pakiet 1, poz. 28-29 Proszę o dopuszczenie igieł bez filtra

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 122

Czy Zamawiający w pakiecie 37, poz. 1 i 2 dopuści – standardową długość cewnika - 54cm, cewnik zaopatrzony w otwór centralny i 2 boczne, stosowane u większości producentów?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 123

Czy Zamawiający w pakiecie 37, poz. 3 i 4 dopuści – standardową długość cewnika – 30,5cm, cewnik o podwójnej sztywności zaopatrzony w otwór centralny i 4 boczne, stosowane u większości producentów?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 124

Czy Zamawiający w pakiecie 24, poz. 1-9 dopuści maski wykonane z vinylu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 125

Pytanie do pakietu 27 poz. 2,3,4,5

Prosimy Zamawiający o dopuszczenie masek krtańowych o następujących parametrach: jednorazowa maska krtańowa wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV z mankietem bez badań na temat obniżonej przenikalności na podtlenek azotu, z luźny niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej dren do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, , posiadająca balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankieta (płaski przed wypełnieniem), z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankieta, nazwą producenta, rozmiarem maski, sterylna, Rozmiar: 2 w poz. 2; rozmiar 3 w poz. 3; rozmiar 4 w. poz.4; rozmiar 5 w poz. 5 w pakiecie 27.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 126

Czy Zamawiający w zad. 29, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z pełną mechaniczną regulacją podciśnienia. Nie wymaga do pracy napełnienia wodą. Wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10 do 40cm H₂O, bezgłośny, o pojemności 2000ml, wyskalowany co 2ml do pojemności 200ml, posiadający wskaźnik umożliwiający wizualizację prawidłowego działania

podciśnienia, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do bezigłowego pobierania próbek drenowanego płynu z króćcem typu Luer-Lock. Wysokość 26 cm i konstrukcja pozwalająca zarówno na zawieszenie, jak i postawienie na integralnym rozkładanym stojaku, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie, z możliwością pracy w każdej w pozycji (pionie i w poziomie), zapakowany sterylnie w folię i-wewnątrz folii- w serwetę. Z pojedynczym drenem łączącym, bezłateksowym, zabezpieczonym przed zagięciem za pomocą zewnętrznego dodatkowego zbrojenia rurą karbowaną. Wyposażony w szybkozłączkę umożliwiającą wymianę napełnionego zestawu bez konieczności rozłączania дренаżu po stronie pacjenta. Z niezależnie pracującym, wyskalowanym cyfrowo wskaźnikiem przecieku doopłucnowego, dającym dobrą wizualizację dzięki zabarwionemu płynowi. Z załączoną strzykawką wypełnioną płynem w odpowiedniej ilości, nie wymagającym dodatkowych przygotowań i zabezpieczania płynu przez obsługującą osobę. Z wbudowanym zaworem na obudowie, umożliwiającym ręczną kontrolę podciśnienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 127

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010, zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku, ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia, podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej, czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi, Zamawiający w zad. 30 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowie, tętnice ramiennie-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Odpowiedź: Nie, wymagamy.

Pytanie nr 128

Zwracamy się z prośbą w zad. 30, o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynek), która zawiera wszystkie wymagane ustawowo informacje (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 129

Czy Zamawiający w zad. 35, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu. Worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 100 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”; dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm (dostępna także wersja z drenem 150cm) dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu na drenie; klema zaciskowa typu przesuwnego; dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu; samouszczelniający się port do pobierania próbek; trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na trzy zintegrowane komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 3 ml do 55 ml (w komorze wstępnej), co 5 ml od 60 do 110 ml (w komorze drugiej) i co 10 do 500 ml (w komorze trzeciej), komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne; w systemie obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe; zmrożona, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu; pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujących do okrągłych i kwadratowych ram łóżka sterylny. Dedykowane do 7 dniowej zbiórki moczu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 130

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zad. 43 poz. 2? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej jakościowo oraz cenowo oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 131

Czy Zamawiający w zad. 35, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Stapler skórny jednorazowego użytku, załadowany 35 zszywkami ze stali chirurgicznej, zszywka szeroka (wys.7.2 mm; szer. 4.9mm, szer.b. 0,6 mm)?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 132

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 133

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt A:

1. Obciążające Wykonawcę:

A) W przypadku opóźnienia terminu dostawy częściowej Przedmiotu Zamówienia z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy – Wykonawcy mogą zostać naliczone kary – za każdy dzień zwłoki od przekazanego zamówienia po **0,5%** wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy.**

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 134

Pytanie 1 – Pakiet 55 poz.1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z włókniny SMMMS, posiadającego dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z laminatu 2-warstwowego folia polietylenowa oraz włóknina polipropylenowa po wewnętrznej stronie fartucha i w $\frac{3}{4}$ rękawów. Szwy rękawów na wzmocnieniu wykonane w technologii ultradźwiękowej. Oprócz opakowania zewnętrznego fartuch owinięty w serwetę włókninową z dwoma sztukami ręczników włókninowych?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytania do wzoru umowy

Pytanie nr 135

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 2 projektu umowy poprzez zmianę terminu realizacji reklamacji na 5 dni roboczych.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 136

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do poziomu:

- a. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. A);
- b. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. D).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 137

Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 138

pakiet 1, poz. 7-9 Czy zamawiający wydzieli poz.7-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 139

pakiet 2, poz. 3-4 Czy zamawiający wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 140

pakiet 2, poz. 3-4 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 141

pakiet 2, poz. 3-4 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Pytanie nr 142

pakiet 9, poz. 1 Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu 2 litry z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 143

pakiet 9, poz. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 144

pakiet 9, poz. 4-5 Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylizowany, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 145

pakiet 9, poz. 4-5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 146

pakiet 9, poz. 4-5 czy zamawiający dopuści woreczki bez daty sterylizacji n opakowaniu, posiadają natomiast datę ważności bezpośrednio na opakowaniu indywidualnym?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 147

pakiet 12, poz. 1-6 czy zamawiający wymaga opakowania papier folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 148

pakiet 12, poz. 1-6 Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 149

pakiet 12, poz. 1-6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 150

pakiet 25, poz. 1-3 czy zamawiający dopuści długość drenu 200 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 151

pakiet 32, poz. 3 Czy zamawiający dopuści lusterka medyczne sterylne, lusterko służące do diagnostyki jamy ustnej pacjenta, posiada gładkie brzegi, które nie powodują uszkodzeń wewnętrznej części jamy ustnej, rączka lusterka posiada 4 mm chropowatą powierzchnię, która ułatwia trzymanie narzędzia i nie pozwala na wyslizgnięcie z dłoni lekarza, średnica lusterka 22mm, średnica powierzchni lustrzanej 19 mm, wykonane z ABS, nie zawiera latexu, długość rączki 165 mm, pakowane w papier-folia?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 152

pakiet 52, po. 1 czy zamawiający dopuści koszulę z wycięciem półokrągłych pod szyją?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 153

pakiet 52, poz. 4 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 154

pakiet 52, poz. 8 czy zamawiający dopuści rękawy zakończone elastycznym mankietem ze ściągaczem? czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Dot. asortymentu:**Pytanie nr 155**

Pakiet 44 poz.1-3: Czy Zamawiający wymaga: nieresorbowalna lekka siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej jednowłókienkowej o średnicy 0,16mm, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności i niskiej masie powierzchniowej: 60-85 g/m² i grubości siatki 0,45 +/- 0,05 mm, oraz niestrzępiących się brzegach i wysokiej wytrzymałości na wyrwanie szwu, optymalna sztywność, wytrzymałość – w kierunku wzdłużnym i poprzecznym >250 N; porowatość siatki – min. 60%(+/-5); siatka wykonana techniką dzianą z możliwością przycinania jej brzegów?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 156

Pakiet 46: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 15x250 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 157

Pakiet 51 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane podwójnie (a'2) z przeliczeniem liczby zamawianych opakowań?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 158

Pakiet 54: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na ramię C o rozmiarze 183x104cm z dwoma trokami z przylepcami na końcu (przylepce z fingerliflami)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 159

Pakiet 55: Czy Zamawiający dopuści fartuch, w którym wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów wykonane są z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego folia polietylenowa oraz włóknina polipropylenowa, pakowany z ręczniczkami z włókniny kompresowej (2 szt.)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 160

Pakiet 56 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x15 cm ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 161

Pakiet 56 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x28 cm ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 162

Pakiet 57 poz. 1-14: Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-14 z pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 163

Pakiet 57 poz. 1-10: Czy Zamawiający dopuści rękawy z oznaczenie norm „ISO 11607-1,2 EN 868-5” na linii zgrzewu fabrycznego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 164

Pakiet 58 poz. 1- 5: Czy Zamawiający dopuści komplety z włókniny SMS, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 165

Pakiet 62 poz.1: Czy Zamawiający dopuści: taśma do wysiłkowego nietrzymania moczu, lekka, sterylna, do metod implantacyjnych TOT, TVT, TVT-O, monofilament polipropylenowy niewchłaniający, transparentny i niebieski, gramatura 64-73 g/m², szerokość taśmy 0,9-1,3cm, porowatość 67%, długość taśmy bez uchwytów 45 cm, bez osłonki, niebieskie uchwyty do zamocowania taśmy na aplikatorze, zabezpieczone termokurczliwą rurką w miejscu łączenia uchwytu z taśmą, pakowana pojedynczo, 4 etykiety identyfikujące wyrób?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 166

Pakiet 62 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sześcioramiennej lekkiej siatki ginekologicznej, przeznaczonej do chirurgicznego leczenia obniżenia narządu rodowego u kobiet, wytwarzanej techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej w kolorze transparentnym i niebieskim; gramatura 40(+/-5)g/m², szerokość 600(+/-2)mm, wysokość 300(+/-2)mm, bez przewodnic?

Odpowiedź: Nie.

Dot. projektu umowy:**Pytanie nr 167**

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w § 3 ust. 9 w sformułowaniu „z zastrzeżeniem zapisów §3 ust. 9”? Obecnie §3 ust. 9 odwołuje się sam do siebie.

Odpowiedź: Tak, doszło do omyłki

Pytanie nr 168

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 12 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 169

Czy Zamawiający zgadza się aby numer zamówienia był naniesiony na dokument WZ? Numer zamówienia nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania numeru zamówienia na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru zamówienia bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia numeru zamówienia na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dla Zamawiającego specjalnej obsługi, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które wpłyną na kalkulację i wysokość ceny oferowanej w przetargu. Brak modyfikacji § 4 ust. 2 wzoru umowy może zatem doprowadzić do zaoferowania w przetargu wyższych cen.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 170

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 6 ust. 1 pkt A wzoru umowy?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 171

Czy Zamawiający wykreśli punkt B w §6 punkt 1?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 172

Pakiet 1 pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 173

Pakiet 1 pozycja 5-6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 174

Pakiet 1 pozycja 8-9 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 175

Pakiet 1 pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści igłę 0,8x50mm lub 0,8x40mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 176

Pakiet 1 pozycja 28-29 Czy Zamawiający dopuści igłę z otworem bocznym bez filtra o rozmiarze

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 177

Pakiet 4, pozycja 1-10 Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe zgodnie z poniższymi rozmiarami: Nr 000-40mm, nr 00-50mm, nr 0-60mm, nr 1-70mm, nr 2-80mm, nr 3-90mm, nr 4-100mm, nr 5-110mm, nr6-120mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 178

Pakiet 5, pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozm. CH6-CH10 o długości 40cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 179

Pakiet 5, pozycja 10-20 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie nr 180

Pakiet 5, pozycja 10-20 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pakowany podwójnie wew. folia, zew. papier-folia?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie nr 181

Pakiet 5, pozycja 26-31 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki Tiemana miały satynową powierzchnię?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie nr 182

Pakiet 5, pozycja 41-42 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o dł. 400mm?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie nr 183

Pakiet 6, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200cm?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie nr 184

Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści końcówkę w rozmiarze 3,9mm/7,0mm (wew/zew)?

Odpowiedź: **Nie.**

Pytanie nr 185

Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści końcówkę w rozmiarze 4,45/6,67mm (wew/zew)?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie nr 186

Pakiet 7, pozycja 7-10 Czy Zamawiający dopuści dreny silikonowe do jamy otrzewnowej?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający wymaga drenów lateksowych.**

Pytanie nr 187

Pakiet 7, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH27?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie nr 188

Pakiet 7, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH33?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie nr 189

Pakiet 7, pozycja 11-15 Czy Zamawiający dopuści dren o długości ramion 45 x 18cm, wykonany z najwyższej jakości silikonu?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie nr 190

Pakiet 7, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści dren o długości ramion 45 x 18cm?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie nr 191

Pakiet 7, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści dren o długości ramion 45 x 18cm w rozmiarze CH10?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie nr 192

Pakiet 7, pozycja 18-21 Czy Zamawiający dopuści dreny Pezzera pakowane podwójnie wew./folia zew/papier-folia?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie nr 193

Pakiet 8, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena w rozmiarze CH20?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie nr 194

Pakiet nr 8, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy worek do lewatywy z drenem o długości 150 cm, zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 195

Pakiet nr 8, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy worek do lewatywy w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 196

Pakiet 9, pozycja 4-5 Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania moczu o pojemności 100ml?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 197

Pakiet 10, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści pęsetę sterylną?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 198

Pakiet 10, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pobierania moczu sterylny o pojemności 30ml?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 199

Pakiet 10, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90szt o pojemności 30ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 200

Pakiet 10, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści pojnik z dziubkiem wyposażony w 1 przykrywkę?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 201

Pakiet 10 pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści koc ratunkowy w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 202

Pakiet 10 pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x140cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 203

Pakiet 10 pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylnej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 204

Pakiet 11 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy, nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny, obie warstwy myjki nie podfoliowane, w rozmiarze 14 cm x 20 cm, gramaturze 90g/m², produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 205

Pakiet 11 pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 206

Pakiet 11 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy, nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w 100% z włókien poliestrowych, obie warstwy myjki nie podfoliowane, w rozmiarze 15cm x 22cm, gramaturze 60g/m², produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 207

Pakiet 11 pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 208

Pakiet 11 pozycja 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości stosowania myjek dla niemowląt potwierdzonego oświadczeniem producenta? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 209

Pakiet 11 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała noworodków nasączoną środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 z dodatkiem aloesu, wykonaną w całości z poliestru o gramaturze 400g/m², w rozmiarze 12cm x 10cm, produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, w opakowaniu a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 210

Pakiet 11 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała noworodków nasączoną środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 z dodatkiem aloesu, wykonaną w całości z poliestru o gramaturze 400g/m², w rozmiarze 12cm x 10cm, produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, w opakowaniu a'40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 211

Pakiet 12, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści wzornik w rozmiarze XXS?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 212

Pakiet 13, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści papier do EKG do AT2 Schiller w rozmiarze 210x280x215?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 213

Pakiet 13, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści papier do EKG do AT1 Schiller 90x90x400 z nadrukiem czerwonym?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 214

Pakiet 13, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści do KTG w rozmiarze 112x90x160?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 215

Pakiet 13, pozycja 7,9 Czy Zamawiający wymaga oryginalnego papieru firmy Sony zapewniającego wysoką jakość wydruku?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 216

Pakiet 13, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści papier do Life Pack11/12 w rozmiarze 103x25?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 217

Pakiet 13, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora w rozmiarze 75x26?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 218

Pakiet 22, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści szkiełka z rozmiarze 76x26x1mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 219

Pakiet 24, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści lejce naczyniowe rozmiar 2,5 x 1,0, długość 2x40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 220

Pakiet 35, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu zgodnie z poniższymi parametrami:

- Komora pomiarowa 500 ml, umożliwiająca bardzo dokładny pomiar diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml)
- Wyposażona w obrotowy zawór przelewowy, filtr hydrofobowy oraz podwójny system podwieszania
- Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml skalowany co 100 ml
- Wyposażony w zastawkę bezzwrotną, filtr hydrofobowy, kranik spustowy typu „T”
- Dwuświatłowy dren o długości 120 cm, wzmocniony spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory
- Wyposażony w klamrę zatraskową, bezpieczny łącznik do cewnika z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu oraz zastawkę jednokierunkową zabezpieczającą przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 221

Pakiet 43, pozycja 1,2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów załadowanych 35 zszywkami w rozmiarze 7,2 x 4,9mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 222

Pakiet 49, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 223

Pakiet 49, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 224

Pakiet 46 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 200 x 16 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 225

Pakiet 51 pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 226

Pakiet 51 pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 227

Pakiet 51 pozycja 6, 7, 9 Czy Zamawiający dopuści serwety z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 228

Pakiet 51 pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 80 x 75 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 229

Pakiet 51 pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 230

Pakiet 51 pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o wymiarach 6 x 8 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 231

Pakiet 52 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 232

Pakiet 52 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 233

Pakiet 52 pozycja 4, 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 234

Pakiet 52 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furazerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², w części górnej wykonany z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², ze wstawką antypotną 38g/m²; wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 235

Pakiet 52 pozycja 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 236

Pakiet 52 pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści maskę związaną na troki o długości 40cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 237

Pakiet 52 pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m²?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 238

Pakiet 52 pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 40 g/m²?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 239

Pakiet 52 pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 240

Pakiet 54, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści sterylny, trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 241

Pakiet 55 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z owinięciem w serwetę włókninową, zamiast w papier krepowy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 242

Pakiet 55, pozycja 1 Czy Zamawiający, w celu lepszej identyfikacji, oczekuje fartuchów z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 243

Pakiet 55, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga etykiet na wyrobie w języku polskim, ułatwiających identyfikację fartucha?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 244

Pakiet 56, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarach 28 x 15 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 245

Pakiet 58, pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 246

Pakiet 31: Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 247

Pakiet 35: Prosimy o doprecyzowanie czy płaski port bezigłowy ma być wyposażony w przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź: Opis szczegółowy znajduje się w SWZ.

Pytanie nr 248

Pakiet 35: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw ma posiadać dren wyposażony w technologię umożliwiającą swobodne spływanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku, a co za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru godzinowej zbiórki moczu?

Odpowiedź: Opis szczegółowy znajduje się w SWZ.

Pytanie nr 249

Pakiet 48: Poz.1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenia Strzyżarki BeCare+ładowarka, wg. Naszej wiedzy zamawiający pracuje obecnie n takiej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 250

Pakiet 48: Poz.2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ostrzy kompatybilnych ze strzygarką z pozycji 1, pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem SWZ, wg. Naszej wiedzy zamawiający pracuje na takich ostrzach, bez zastrzeżeń.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 251

Dotyczy pak. 30 Czy Zamawiający w zadaniu 30 ma na myśli 4 opakowania klipsów polimerowych zawierających 20 magazynków.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 252

Dotyczy pak. 30 Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania klipsów polimerowych II generacji o stabilności poprzecznej klipsa na naczyniu na poziomie 15N

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy wzoru umowy**Pytanie nr 253**

Paragraf 6 pkt. 1a wzoru umowy zawiera informacje że w przypadku opóźnienia terminu dostawy częściowej przedmiotu zamówienia z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy –Wykonawcy mogą zostać naliczone kary – za każdy dzień zwłoki od przekazanego zamówienia po 5% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy. Taki zapis w umowie sprawia, że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 1%.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 254

Pakiet nr 50 Pozycja nr 3 Prosimy o dopuszczenie Podkładów podfoliowanych szerokość 29-33cm dł. rolki 50 metrów.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 255

Pakiet nr 50 Pozycja nr 4 Prosimy o dopuszczenie Czyściwa suchego celulozowego w rolce do wycierania pacjenta dł. 200 mb, rozmiar ok. 26-30 cm.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Pytanie nr 256**

dotyczy pakietu 4 poz. 1-10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie rurek Guedela w rozmiarach ISO: roz.000 – 35mm, roz.00 -50mm, roz.0-55mm, roz.1-65mm, roz.2-80mm, roz.3-90mm, roz.4-100mm, roz.5 -120mm?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 257

dotyczy pakietu 6 poz. 2, 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie w pakiecie 6 poz. 2 i 3 cewnika do podawania tlenu przez nos dla dzieci oraz dla noworodków z zgiętymi końcówkami, czystego mikrobiologicznie, spełniającego pozostałe wymogi SWZ?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 258

dotyczy pakietu 27 poz. 2, 3, 4, 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, z koniuszkiem mankieta nie podwijającym się podczas zakładania, w siedmiu rozmiarach, z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankieta, maksymalnej objętości wypełnienia mankieta na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 259

dotyczy pakietu 31 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego anestetycznego dla dorosłych z rur rozciągalnych o średnicy 22m i długości od 40 do 200cm z dodatkową rurą do worka o długości 40-150cm, z łącznikiem Y z kolankiem i portem luer wraz z kapturkiem zabezpieczającym w kolorze czerwonym, z workiem oddechowym bezlateksowym o poj. 2L oraz łącznikiem prostym 22M-22M, pakowany pojedynczo, folia-folia?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 260

dotyczy pakietu 31 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego do respiratora dla dorosłych z rur karbowanych zewnątrz i o gładkim świetle wewnątrz o średnicy 22 mm i długości 160cm z łącznikiem Y oraz kapturkiem zabezpieczającym w kolorze czerwonym, pakowany folia-folia, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 261

dotyczy pakietu 31 poz. 2 Czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego wykonanego z rur o gładkim świetle wewnątrz?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 262

dotyczy pakietu 37 poz. 1, 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamkniętego systemu do odsysania 72h, do rurek intubacyjnych o długości 54cm w rozmiarze Fr 14, 16, w którym cewnik składa się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiający precyzyjną kontrolę siły ssania wraz z pewnym zatraskowym systemem blokowania, z mocnym transparentnym rękawem, z markerami długości ułatwiającymi prawidłowe umieszczenie cewnika, z linią do płukania zakończoną kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegającym utraty kapturka, z obrotową zastawką separującą izolującą cewnik do płukania, z zamknięciem 45 stopni zapobiegającym przesuwaniu cewnika? W zestawie widełki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na każdym zestawie nadruk nr serii i daty ważności, nazwa i opis w języku polskim?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 263

dotyczy pakietu 37 poz. 3, 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamkniętego systemu do odsysania 72h, do rurek tracheotomijnych o długości 30,5 cm w rozmiarze Fr 14, 16, w którym cewnik składa się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiający precyzyjną kontrolę siły ssania wraz z pewnym zatraskowym systemem blokowania, z mocnym transparentnym rękawem, z markerami długości ułatwiającymi prawidłowe umieszczenie cewnika, z linią do płukania zakończoną kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegającym utraty kapturka, z obrotową zastawką separującą izolującą cewnik do płukania, z zamknięciem 45 stopni zapobiegającym przesuwaniu cewnika? W zestawie widełki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na każdym zestawie nadruk nr serii i daty ważności, nazwa i opis w języku polskim?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 264

dotyczy pakietu 39 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noworodkowego układu do resuscytacji z zastawką PEEP do aparatu Neopuff, jednorazowego użytku, wykonanego z rury niepodgrzewanej karbowanej o średnicy 10mm i długości 120cm, doprowadzającej gazy do pacjenta, z łącznikiem podwójnie obrotowym 22M/15F, z kapturkiem zabezpieczającym układ oraz z trzema uniwersalnymi łącznikami?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 265

dotyczy pakietu 39 poz. 2, 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek do resuscytacji dla noworodków w kształcie owalnym, zapewniające komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka w rozmiarze 0 i średnicy zewnętrznej 52 mm oraz w rozmiarze 1 i średnicy zewnętrznej 70 mm z mocowaniem 15M, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, bez lateksu i DEHP?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 266

dotyczy pakietu 45 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga okularków do fototerapii noworodków, jednorazowego użytku, czystych mikrobiologicznie, pakowanych indywidualnie. Wykonanych z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego promienie lecznicze jednak z dodatkową ochroną oczu

na poziomie 99,9% potwierdzone niezależnymi badaniami, zapinanych na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę, Wykonane z jednego kawałka materiału. Dostępne w trzech rozmiarach:

Noworodki, rozmiar 30-38 cm, dodatkowy identyfikator rozmiaru na opakowaniu nie na okularkach jako dodatkowa prewencja ewentualnych incydentów medycznych – kolor turkusowy,

Wcześnieiki 24-33 cm, dodatkowy identyfikator rozmiaru na opakowaniu nie na okularkach jako dodatkowa prewencja ewentualnych incydentów medycznych – kolor zielony,

Mikro 20-28 cm, dodatkowy identyfikator rozmiaru na opakowaniu nie na okularkach jako dodatkowa prewencja ewentualnych incydentów medycznych – kolor granatowy.



Odpowiedź: Tak.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA 5 – WZÓR UMOWY

Pytanie nr 267

Pytanie 1 – dotyczy §6 ust. 1 pkt A)

Prosimy o modyfikację w/w ustępu w sposób następujący:

*„W przypadku opóźnienia terminu dostawy częściowej Przedmiotu Zamówienia z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy – Wykonawcy mogą zostać naliczone kary – za każdy dzień zwłoki od przekazanego zamówienia **po 1% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy.**”*

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 268

Pakiet 46 poz.1 Prosimy o dopuszczenie pokrowca na przewody w rozmiarze 244cmx18cm.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 269

Pakiet 46 poz.1 Prosimy o dopuszczenie pokrowca na przewody w rozmiarze 240cmx15cm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 270

Pakiet 58 poz.1 Prosimy o dopuszczanie możliwości zaoferowania jednorazowego kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS. Pozostałe wymogi – zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 271

Pakiet 56 poz.1 Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 15cmx28cm.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 272

Pakiet 56 poz.2 Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 40cmx42cm.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 273

Pakiet 56 poz.2 Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 45cmx28cm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 274

Pakiet 55 poz.1-3 Prosimy o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Rękawy łączone za pomocą klejenia.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 275

Pakiet 54 poz.1 Prosimy o dopuszczenie sterylnego pokrowca na ramię C w rozmiarze 104x188cm, wykonanego z przezroczystego polietylenu (PE).

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 276

Pakiet 48 poz.1 Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach:

Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 277

Pakiet 48 poz.2 Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach:

Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 278

Pakiet 48 poz.1 Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach:

Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi lekka, ergonomiczna, wyposażona w obrotową głowicę niezależnie od typu ostrza. Czas ładowania strzygarki do pełna: maksimum 60 minut. Strzygarka wyposażona diodę sygnalizującą m.in. rozładowywanie się baterii litowo-jonowej. W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych. Strzygarka powinna być wodoszczelna w celu przeprowadzenia dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7). Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy, zdejmowanymi za pomocą przycisku: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia (np. z głowy).

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 279

Pakiet 48 poz.2 Prosimy o dopuszczenie asortymentu o cechach:

Uniwersalne ostrza jednorazowe, szerokość cięcia co najmniej 36 mm, wysokość strzyżenia 0,3-0,5mm. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. Pakowane pojedynczo, biologicznie czyste. Na każdym ostrzu numer LOT. Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z zestawem w pozycji nr 1.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Dyrektor SPZOZ Międzychód
/-/ Bartosz Grobelny