



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 21.02.2023r.

EZP 65/2023



Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu M-5/2023 na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający działając na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. 1.2 wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 1.2 wskazał:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
- 2) za zwłokę w realizacji dostaw na podstawie zamówień Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości Rękawic niedostarczonych w terminie, za każdy dzień zwłoki.

Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust. 1.2 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,25% wartości

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu dot. § 7 ust. 1.2 wzoru Umowy poprzez obniżenie kary umownej do 0,25% wartości towarów niedostarczonych w terminie, za każdy dzień zwłoki.

Pytanie nr 2

Pytanie dot. pakietu VI:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą do TBC 0,4 x 12 pakowane po 100 szt bez nazwy/logo producenta na produkcie, natomiast z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 3

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający może wskazać do jakich Pomp będą stosowane wymagane strzykawki?

Odpowiedź:

Pompa KWAPISZ/ALFA GREEN – Duet 20/50, Mono, 1020

Pompa ASCOR AP14, SEP 11S

Pompa MEDIMA S300

Pompa FRESENIUS Tiva Agilia, Agilia

Pompa SMITHS GRASEBY Graseby 3200, MS26

Pompa BECTON DICKINSON Alaris CC Plus

Pytanie nr 4

Pakiet 1, poz. 4-7





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości : 2-3 ml. 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-24 ml; ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 3, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści maskę z otworami po bokach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 3, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 3, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową w rozmiarze 5 dedykowaną dla pacjentów o wadze 70kg – 100kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 8

Zadanie nr 3, pozycja nr 18 – Czy zamawiający dopuści jednorazowy resuscytator przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta, dla dorosłych, wykonany z PCV, przeznaczony do wentylacji pacjentów dorosłych o masie ciała powyżej 40 kg, wyposażony w zawór bezpieczeństwa: 60 cm H₂O, worek o antypoślizgowej powierzchni zapewniającej stabilny chwyt, bez portu do podawania leków, objętość worka: 1650 ml, objętość rezerwuaru tlenu: 2000 ml, w zestawie maska twarzowa dla dorosłych (rozmiar 5) oraz dren tlenowy o długości 2,1 m, całość zapakowana w kartonik?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 9

Zadanie 1, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną do 12ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 10

Zadanie 1, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną do 2,5ml lub 3ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11

Zadanie 1, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 0,33x12,7ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 12

Dotyczy Zadania nr 20 poz. 6-10

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach: 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź:





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 13

Dotyczy Zadania nr 3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych o masie ciała powyżej 40kg, objętości resuscytatora 1650 ml, objętości rezerwuaru tlenu 2000 ml, zastawka bezpieczeństwa 60 cm H₂O. Resuscytator wykonany z medycznego PCV/EVA/PP i silikonu, bez zawartości lateksu i bez zawartości ftalanów, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka. W zestawie z jednorazową maską twarzową z mankietem dla dorosłych, dren tlenowy? Zamawiający korzysta obecnie z takiego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 14

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki ze ściętym stożkiem pod kontem 45 stopni, z dołączonymi dwoma łącznikami luer?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

Pytanie nr 15

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki bursztynowej z białym kontrastującym tłokiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

Pytanie nr 16

Zadanie 1, pozycja 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

Pytanie nr 17

Zadanie 1, pozycja 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z nazwą lub logo producenta na cylindrze?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje strzykawki z nazwą lub logo producenta na cylindrze.

Pytanie nr 18

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności normalnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 19

Zadanie 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności normalnej tj. 5,5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 20



6



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki w komplecie z niezintegrowaną igłą 0,4x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

Pytanie nr 21

Zadanie 1, pozycja 9

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki w komplecie z niezintegrowaną igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki.

Pytanie nr 22

Zadanie 1, pozycja 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania handlowe podane w opisie przedmiotu zamówienia z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 23

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 24

Zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 25

Zadanie 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 26

Zadanie 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 27

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem wyposażonym w dren zakończony uniwersalnymi łącznikami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 28

Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z ustnikiem wyposażonym w dren zakończony uniwersalnymi łącznikami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 29

Zadanie 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem wyposażonym w dren zakończony uniwersalnymi łącznikami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 30

Zadanie 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren zakończony stożkowymi konektorami umożliwiającymi dopasowanie drenu do każdego źródła gazu (złączki) w rozmiarze 210 cm +/- 2% ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 30

Zadanie 3, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych o następujących parametrach:

- Worek samorozprężalny przeznaczony do resuscytacji oddechowej
- Stosowany w celu prowadzenia wentylacji zastępczej
- Umożliwia podawanie tlenu z zewnętrznego źródła gazu gwarantując wentylację wysokimi stężeniami

W skład zestawu wchodzi:

- resuscytator
- maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem
- rezerwuuar tlenu
- przewód tlenowy
- Worek samorozprężalny
- Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiają pewny chwyt
- Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu
- Zastawki wykonane z silikonu
- Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- Maski anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia maski do indywidualnych potrzeb pacjenta
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Rezerwuuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia
- Wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22M
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny
- Termin ważności: 3 lata
- Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik

	Noworodek / Niemowlę (Neonate / Infant)	Dziecko (Child)	Dorosły (Adult)
REF	PMR-S	PMR-M	PMR-L
Masa ciała	≤10 kg	10 kg ~ 33 kg	>33 kg
Rozmiar maski *	1	2	5
Objętość wyrzutowa	≥20 ml	≥150 ml	≥600 ml
Objętość resuscytatora	340 ± 100 ml	500 ± 200 ml	1600 ± 200 ml
Wymiary (dł. x śr.)	240 x 75 mm	245 x 95 mm	320 x 132 mm
Waga resuscytatora	350 g	410 g	600 g
Zawór ograniczający ciśnienie	40 cm H ₂ O (zgodnie z ISO 10653-4 30-45 cm H ₂ O)	40 cm H ₂ O (zgodnie z ISO 10653-4 30-45 cm H ₂ O)	60 cm H ₂ O (zgodnie z ISO 10653-4 40-60 cm H ₂ O)
Przestrzeń martwa (zawór pacjenta)	7 ml	7 ml	7 ml
Opór wdechowy	<5 cm H ₂ O (przy 50 L/min)		
Opór wydechowy	<5 cm H ₂ O (przy 50 L/min)		
Objętość worka - rezerwuuar	1600 ml	1600 ml	2000 ml
Złącze pacjenta	ISO 5356-1: Ø22/15 mm		
Rekomendowane warunki użytkowania:	-18°C ~ +50°C		
Przechowywanie:	-40°C ~ +60°C, 40% r.h - 95% r.h		

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 32





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?)

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia projekt umowy o w/w zapis.

Pytanie nr 33

Czy w celu miarkowania kar umownych Nabywca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust.1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

2) za zwłokę w realizacji dostaw na podstawie zamówień Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości Rękawic niedostarczonych w terminie, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto Rękawic niedostarczonych w terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 obniża wysokość 0,5 wartości produktów niedostarczonych w terminie na 0,25 wartości produktów niedostarczonych w terminie oraz wyraża zgodę na dodanie zapisu „jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto produktów niedostarczonych w terminie.”

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 35

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie obowiązkowych zapisów waloryzacyjnych do umowy, które są wymagane dla postępowań na dostawy, usługi, roboty budowlane, których długość przekracza 6 miesięcy zgodnie z art. 44 i 75 Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, poz. 2185.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia wzór umowy o obowiązkowe zapisy waloryzacyjne przewidziane dla umów na dostawy, których długość przekracza 6 miesięcy zgodnie z art. 44 i 75 Ustawy z dnia 7 października 2022r.

Pytanie nr 36

Zadanie 1,poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu?


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-3 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 36a

Zadanie 1,poz. 1-3

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 36b

Zadanie 1, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga strzykawek kompatybilnych z pompami Ascor?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga strzykawek kompatybilnych z pompami Ascor oraz z pompami wymienionymi w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 37

Zadanie 2, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 37a

Zadanie 2, poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 37b

Zadanie 2, poz. 1

Czy zamawiający wymaga strzykawek kompatybilnych z pompami Ascor?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga strzykawek kompatybilnych z pompami Ascor oraz z pompami wymienionymi w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 38

Zadane 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 20 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 39

Zadane 2, poz. 2-4





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494

Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Czy zamawiający wydzieli poz.2-4 do osobnego pakietu?

Odpowiedź;

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2-4 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 40

Zadanie 3, poz. 1-5

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu?

Odpowiedź;

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-5 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 41

Pakiet 1

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawki 50/60ml do pomp infuzyjnych firmy Margomed na cylindrze, nazwa producenta strzykawki w celu poprawnej identyfikacji używanej strzykawki w wyświetlanym menu pompy. Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, biała, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, opakowanie papier-folia. opakowanie 85 szt.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie pompy infuzyjne są na wyposażeniu szpitala

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Wykaz pomp został wymieniony w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 42

Pakiet 1

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w strzykawek.

Pytanie nr 43

Pakiet 1

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych po 100 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 44

Pakiet 1

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 10 ml ze skala rozszerzoną do 12 ml
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



H



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 45

Pakiet 1

Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2 ml ml ze skala rozszerzoną do 3 ml
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 46

Pakiet 1

Poz. 4,5,6,7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w strzykawek.

Pytanie nr 47

Pakiet 2

Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie pompy infuzyjne są na wyposażeniu szpitala.

Odpowiedź:

Wykaz pomp został wymieniony w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 47a

Pakiet 2

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po max 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 48

Pakiet 2

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej z ostrzem ściętym pod kątem 45 stopni z nasadką nie krótszą niż 2,3 mm, sterylizacja tlenkiem etylenu .

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 49

Pakiet 2

Poz.6

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu równoważnego, o następujących parametrach: Zestaw podłączeniowy do przygotowania cytostatyków z drenem wykonanym z poliuretanu o długości 41 cm, bez PCV. Dren o średnicy wewnętrznej 2.9mm. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji (możliwość aktywacji zaworu powyżej 100 lub 7 dni) oraz jeden zacisk zatraskowy. W dystalnej części łącznik luer lock z filtrem hydrofobowym pozwalającym na bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Odpowietrzenie przy kolcu zabezpieczone klapką- odpowiednie dla worków i butelek. Objętość wypełnienia systemu – 2,7 ml. Zestaw do worka i butelki.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494

Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 50

Pakiet 2

Poz.7

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu równoważnego, o następujących parametrach: Zestaw do przygotowania cytostatyków z bursztynowym drenem wykonanym z poliuretanu o długości 41 cm, bez PCV. Dren o średnicy wewnętrznej 2.9mm. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji (możliwość aktywacji zaworu powyżej 100 lub 7 dni), jeden zacisk zatraskowy. W dystalnej części łącznik luer lock z filtrem hydrofobowym pozwalającym na bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Objętość wypełnienia systemu – 2,8 ml. Odpowietrzenie przy kolcu zabezpieczone klapką. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 51

Pakiet 2

Poz.8

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu równoważnego, o następujących parametrach: Zestaw do przygotowania cytostatyków, z przezroczystym drenem wykonanym z poliuretanu o długości 43 cm oraz filtrem 0,2µm. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, 2 zaciski zatraskowe oraz filtr 0,2µm wykonany z polieterosulfonu. Koniec drenu zakończony zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie się krwi w kierunku od pacjenta do drenu i zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiającą bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 52

Pakiet 2

Poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym. Strzykawka zaopatrzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawka z męskim konektorem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada mechanizm obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. łącznik o objętości wypełnienia max.0,1ml i długości max.4cm, do 100 użyć lub min.72h. Strzykawka w rozmiarze 60 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.


Pytanie nr 53

Pakiet 2

Poz.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym. Strzykawka zaopatrzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku.



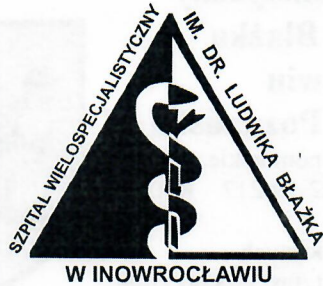

Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS

0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Strzykawką z męskim konektorem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada mechanizm obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. łącznik o objętości wypełnienia max.0,1ml i długości max.4cm, do 100 użyć lub min.72h. Strzykawką w rozmiarze 30 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 54

Pakiet 2

Poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym. Strzykawką zaopatrzoną w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawką z męskim konektorem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada mechanizm obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. łącznik o objętości wypełnienia max.0,1ml i długości max.4cm, do 100 użyć lub min.72h. Strzykawką w rozmiarze 10 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 55

Pakiet 2

Poz.12

W związku z jednoznacznym opisem przedmiotu zamówienia wskazującym tylko i wyłącznie na jednego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadą równego traktowania Wykonawców, prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu równoważnego, o następujących parametrach: Adapter na fiolkę z lekiem wyposażony w nietransparentną komorę/balonik do wyrównywania ciśnienia i zatrzymywania oparów oraz elastomerowe połączenie membrany z membraną które samouszczelnia się po odłączeniu, aby umożliwić hermetyczne i szczelne transfery. Adapter na fiolkę w rozmiarze 13mm z zabezpieczeniem na kolec bezbarwnym. Możliwość użycia systemu do 10 aktywacji lub 7 dni (168h). Produkt nie zawierający lateksu oraz BPA. Produkt pakowany pojedynczo,.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 56

Pakiet 2

Poz.13

W związku z jednoznacznym opisem przedmiotu zamówienia wskazującym tylko i wyłącznie na jednego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadą równego traktowania Wykonawców, prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu równoważnego, o następujących parametrach: Adapter na fiolkę z lekiem wyposażony w nietransparentną komorę/balonik do wyrównywania ciśnienia i zatrzymywania oparów oraz elastomerowe połączenie membrany z membraną które samouszczelnia się po odłączeniu, aby umożliwić hermetyczne i szczelne transfery. Adapter na fiolkę w rozmiarze 20mm z niebieskim oznaczeniem- nakładką zabezpieczającą kolec. Możliwość użycia systemu do 10 aktywacji lub 7 dni (168h). Produkt nie zawierający lateksu oraz BPA. Produkt pakowany pojedynczo,.

Odpowiedź:



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 57

Pakiet 2

Poz.13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do przygotowania leków cytostatycznych ma być systemem bezigłowym, całkowicie uniemożliwiającym zakłucie igłą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 58

Pakiet 2

Poz.14

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łączenie adaptera na strzykawkę z adapterem na fiolkę poprzez wciśnięcie powinno być sygnalizowane dźwiękowo poprzez wyraźne, słyszalne kliknięcie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 59

Pakiet 2

Poz.14

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik powinien być wyposażony w mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 60

Pakiet 2

Poz.15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przyrząd ma posiadać możliwość łatwej dezynfekcji membrany i umożliwiać wielokrotną podaż bolusa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 61

Pakiet 2

Poz.6,7,8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy produkty powinny posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części, zapobiegającą cofaniu się leków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 62

Pakiet 2

Pakiet 1 pozycja 4,5,6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę ze skalą rozszerzoną odpowiednia 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml 20-24 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w strzykawkę.



KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz