

COZL/DZP/AW/3411/PN-139/23

Lublin, dnia 23.11.2023r.

Do wszystkich wykonawców

„Dostawa odczynników, sond fluorescencyjnych, chłodziarko zamrażarki, miniwortelesa laboratoryjnego, obiektywu immersyjnego kompatybilnego z mikroskopem Olympusa wraz z dzierżawą sekwenatora kapilarnego na potrzeby Centrum Genetyki Klinicznej „ (znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN-139/23)

1. Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

I.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający może dopuścić w komorze zamrażania ustawianą temp. pracy w zakresie -30st.C do -9 st.C z dokładnością 0,1st.C (nieznaczna różnica od wymogu) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy pojemność komory chłodzenia może wynieść dokładnie 240 litów (nieznaczna różnica od wymogu) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Proszę o wyjaśnienie i opisanie, co oznacza dokładnie dla Zamawiającego w komorze chłodzenia "moduł do przechowywania mikroplitek PCR 96/MTP/DWP", celem go rzetelnego wycenienia ?

Odpowiedź: Zamawiający przez „moduł do przechowywania mikroplitek PCR 96/MTP/DWP” rozumie metalowy adapter do przechowywania płytek PCR, O WYMIARACH OK. 12X8,5X2CM, z 96 zagłębieniami o pojemności ok. 0,1 – 0,2ml, odpowiadającym dołkom na płytce PCR.

ZMIANA Załącznika nr 2.3- Kosztorys ofertowy - Część 3 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna - strony zamienne w załączeniu

II.

Pytanie nr 4

Dot. Część 3 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, Parametry techniczne, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach:

Szerokość: 70cm

Głębokość: 64cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Część 3 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, Parametry techniczne, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści komorę zamrażania posiadającą drzwi bez samodomykania oraz bez możliwości zmiany kierunku otwierania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ .

Pytanie nr 6

Dot. Część 3 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, Parametry techniczne, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści komorę zamrażania posiadającą pojemność komory zamrażania 99l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Część 3 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, Parametry techniczne, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści komorę zamrażania posiadającą trzy szuflady z frontem nietransparentnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. Część 3 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, Parametry techniczne, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści komorę chłodzenia posiadającą drzwi bez samodomykania oraz bez możliwości zmiany kierunku otwierania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Dot. Część 3 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, Parametry techniczne, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści komorę chłodzenia posiadającą pojemność komory zamrażarki 188 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Dot. Część 3 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, Parametry techniczne, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści komorę chłodzenia posiadającą półki ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dot. Część 3 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, Parametry techniczne, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści wagę 143 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

III.

Pytanie nr 12

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych części, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dotyczy Rozdziału VI, pkt. 2 SWZ i Załącznika nr 2.6 – Kosztorys ofertowy_ Część 6 – Sondy fluorescencyjne oraz Załącznika nr 3.1 – Projektowane postanowienia umowy §4 ust. 7:

„-Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć świadectwo jakości dla danej partii odczynników przy każdorazowej dostawie wyżej wymienionego asortymentu.

-Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę charakterystyki do każdego z wyżej wymienionych odczynników wraz z pierwszą dostawą.”

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca dostarczył Deklaracje zgodności CE IVD i karty charakterystyki dla sond, które taki dokument posiadają po podpisaniu umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy Załącznik nr 3.1 – Projektowane postanowienia umowy §1 ust. 1:

W związku z dopuszczeniem w **Rozdziale V pkt. 3 SWZ** składania przez Wykonawców ofert częściowych uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie po wyrażeniu „*dzierżawą sekwenatora kapilarnego*” zastrzeżenia „*jeśli dotyczy*”.

Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w **§4 ust. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 i 15, §5 ust. 2 oraz §6 ust. 1 lit . c)**

Wskazane zapisy nie dotyczą części nr 6.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy Załącznik nr 3.1 – Projektowane postanowienia umowy §3 ust. 1:

Uprzejmie prosimy w umowie dla części nr 6 o wykreślenie zwrotu dotyczącego wartości dzierżawy sekwenatora kapilarnego lub dodanie wyrażenia „*dotyczy części nr 1*”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy Załącznik nr 3.1 – Projektowane postanowienia umowy §3 ust. 4:

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„za wyjątkiem okoliczności gdy brak ciągłości realizacji przedmiotu Umowy wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy Załącznik nr 3.1 – Projektowane postanowienia umowy §4 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość **dosyłania faktury papierowej po dostawie towaru lub w formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf?**

Wykonawca motywuje prośbę powodami technicznymi. Dopuszczenie takiej możliwości jest również korzystne dla Zamawiającego, gdyż wystawienie i wysłanie faktury po dostawie, wydłuża w praktyce termin płatności. Jednocześnie zwiększa konkurencyjność i umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego

większej liczby ofert, nie blokując rezygnacji Wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu technicznej formy faktury.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy Załącznik nr 3.1 – Projektowane postanowienia umowy §4 ust. 1:

Prosimy o wykreślenie zwrotu „*telefonicznie*” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nieodpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej te zamówienia.

Odpowiedź: ZMIANA Załącznika nr 3.1 – Projektowane postanowienia umowy - strony zamienne w załączeniu.

Pytanie nr 20

Załącznik nr 2.6 – kosztorys ofertowy; Część 6 – Sondy do FISH; l.p. 1-2; 6-10:

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga, aby sondy z pakietu nr 6 poz. 1-2; 6-10 były zawieszane w buforze hybrydacyjnym, gotowe do użycia oraz dostarczane w opakowaniu wraz z DAPI posiadającym CE IVD?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby sondy były dostarczane w opakowaniu wraz z DAPI posiadającym CE IVD.

Pytanie nr 21

SWZ; część VI pkt 2; zał. nr 1 do SWZ, pkt 7.; Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 4, pkt 2:

Uprzejmie prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na dostarczenie dla pakietu nr 6 dokumentów w postaci pliku pdf. drogą elektroniczną.

Odpowiedź: ZMIANA - SWZ; część VI pkt 2; zał. nr 1 do SWZ, pkt 7.; Zał. nr 3.1 - Projektowane postanowienia umowy - strony zamienne w załączeniu.

Pytanie nr 22

SWZ; część VI pkt 2; zał. nr 1 do SWZ, pkt 7.; Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 4, pkt 2; Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy); pakiet nr 6; pod tabelą myślík 2:

Uprzejmie prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę dla pakietu 7 na dostawę wymienionych dokumentów kart charakterystyki w postaci wydrukowanej wysłanych z siedziby Wykonawcy. Uzasadnienie: Opakowania sond nie zawierają certyfikatów jakości oraz kart charakterystyki ze względów logistycznych oraz z uwagi na możliwe pomyłki podczas pakowania. W związku z tym prosimy o możliwość dostarczenia kart charakterystyki drogą elektroniczną lub listem pocztowym w celu możliwości rzetelnego wykonania umowy.

Odpowiedź: ZMIANA - SWZ; część VI pkt 2; zał. nr 1 do SWZ, pkt 7.; Zał. nr 3.1 - Projektowane postanowienia umowy, Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy) - strony zamienne w załączeniu.

Pytanie nr 23

SWZ; część VI pkt 2; zał. nr 1 do SWZ, pkt 7.; Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 4, pkt 2; Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy); pakiet nr 6; pod tabelą myślík 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostęp do certyfikatów jakości poprzez dostęp 24/7 na stronie Producenta sond z zadania nr 6?

Uzasadnienie: Opakowania sond nie zawierają certyfikatów jakości ze względów logistycznych oraz z uwagi na możliwe pomyłki podczas pakowania. W związku z tym Producent udostępni wszystkie certyfikaty jakości na swojej stronie ze względu także na duże zróżnicowanie numerów LOT asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 1; § 3 ust. 1; pakiet nr 6:

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach umowy z Wykonawcą w zapisie w § 1 „W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, którym jest dostawa odczynników i elementów zużywalnych, sond fluorescencyjnych wraz z dzierżawą sekwenatora kapilarnego określony w SWZ” pozostanie jedynie przedmiot umowy dedykowany do danej części a nie obecny zapis? W obecnym brzmieniu zapis ten nie wskazuje jednoznacznie na kwestię, aby przedmiotem umowy była tylko część Wykonawcy.

Odpowiedź: ZMIANA Załącznika nr 3.1 – Projektowane postanowienia umowy - strony zamienne w załączeniu.

Pytanie nr 25

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 5 ust. 1; pakiet nr 6:

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zapisu: „W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towarów na wolne od wad oraz dokona korekty faktury” poprzez dodanie „dokona korekty faktury w terminie wysłania towaru wolnego od wad z magazynu Wykonawcy do Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 4 ust. 1; pakiet nr 6:

Uprzejmie prosimy o wykreślenie możliwości składania zamówień w postaci telefonicznej i pozostawienie drogi elektronicznej w postaci wiadomości e-mail jako narzędzia formalnego, który umożliwia retrospekcję zamówień oraz poprawność ich złożenia.

Uzasadnienie: Taka forma składania zamówienia nie pozwala na weryfikację poprawności złożenia lub wykonania zamówienia zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy. Skutkuje to brakiem możliwości weryfikacji prawidłowego wykonania zamówienia, sprawdzenia ewentualnej reklamacji ilościowej lub sytuacji wskazania pomyłki w przypadku pomylenia numerów katalogowych i/lub zastosowanych fluorochromów.

Odpowiedź: ZMIANA Załącznika nr 3.1 – Projektowane postanowienia umowy - strony zamienne w załączeniu.

Pytanie nr 27

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 4 ust. 1; pakiet nr 6:

Uprzejmie prosimy o dodanie możliwości wpisania dedykowanego adresu e-mail do składania zamówień.

Odpowiedź: ZMIANA Załącznika nr 3.1 – Projektowane postanowienia umowy - strony zamienne w załączeniu.

Pytanie nr 28

SWZ; część VI pkt 2 i 3; Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 1 pakiet nr 6:

Czy Zamawiający potwierdza, że dla pakietu nr 6 wymaga deklaracji zgodności CE IVD jedynie do wskazanych pozycji w formularzu cenowym –załącznika nr 2.6 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 29

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 2 ust. 6; pakiet nr 6:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu „nie dłużej jednak niż o okres kolejnych 12 miesięcy” na zapis „nie dłużej jednak niż o okres kolejnych 4 miesięcy”. Wykonawca, aby prawidłowo skalkulować ofertę musi pod uwagę brać także okres wykonywania umowy. Zmiana obowiązywania

umowy z 12 na 24 miesiące może być wysoce restrykcyjna i nie pozwala skalkulować prawidłowo oferty. Wykonawca wnosi o skrócenie tego okresu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30

SWZ; część VI pkt 2 i 3; Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 2, pkt 1; pakiet nr 6:

Czy Zamawiający potwierdza, że dla pakietu nr 6 nie wymaga deklaracji zgodności CE IVD w stosunku do produktów RUO?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31

SWZ; część VI pkt 2 i 3; Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 2, ust. 1; pakiet nr 6:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu poprzez dodanie „jeśli dotyczy” w celu jego ujednoczenia zgodnie z zapisem w SWZ rozdz. V pkt. 11 i 12.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 4 ust. 1; pakiet nr 6:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o możliwość wysyłania faktury drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail lub drogą listowną. Wykonawca nie ma możliwości dołączania faktury do dostawy ze względów logistycznych. Dostawa realizowana jest z Magazynu Wykonawcy, natomiast faktury są wystawiane oraz wysyłane z siedziby Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 4 ust. 1; pakiet nr 6:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego, aby dla pakietu nr 6 wyraził zgodę na wydłużenie czasu dostawy dla sond do 15 dni roboczych.

Uzasadnienie: Zaproponowany w dokumencie czas dostarczenia sond w przypadku konieczności sprowadzenia ich z zagranicy jest wysoce rygorystyczny. Pragniemy podkreślić, że sam proces sprowadzenia sond z zagranicy czy ich wyprodukowania może zająć kilka dni roboczych. Dlatego czas 15 dni będzie czasem optymalnym nie mniej jednak Wykonawca postara się wykonać usługę w czasie możliwie najkrótszym.

Odpowiedź: ZMIANA Załącznika nr 3.1 – Projektowane postanowienia umowy - strony zamienne w załączeniu.

Pytanie nr 34

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 4 ust. 2; pakiet nr 6:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego, aby dla pakietu nr 6 wyraził zgodę na możliwość dostarczenia zamówienia w kilku dostawach w przypadku jeśli nastąpi opóźnienie jedynie do wybranych pozycji z zamówienia. Pozwoli to na rzetelne wykonanie umowy oraz zmniejszenie ewentualnego oczekiwania na odczynniki przeznaczonych do diagnostyki pacjentów, co może bezpośrednio przekładać się na ich leczenie oraz przyspieszy diagnostykę. Brak możliwości wysyłania zamówień w postaci cząstkowej jest bardzo krzywdzące oraz nieetyczne w stosunku do pacjentów oczekujących na diagnostykę oraz leczenie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 4 ust. 4 - 15; § 5 ust. 1; pakiet nr 6:

Czy Zamawiający potwierdza, że zapisy te nie dotyczą dostawy sond z pakietu nr 6?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 36

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 4 ust. 16; § 5 ust. 1; pakiet nr 6:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego, aby dla pakietu nr 6 wyraził zgodę, aby termin dostawy odczynników po reklamacji jakościowej i ilościowej Zamawiającego liczony był od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę?

Uzasadnienie: Wymienione sondy w zadaniu 6 są produktami produkowanymi przez Producenta poza terytorium Polski. Wszelkie reklamacja, zwłaszcza jakościowe, muszą zostać skonsultowane i wymagają sprawdzenia przez dział jakości producenta w miejscu produkcji. Pragnę podkreślić iż samo sprawdzenie nowych pozycji może zająć do 10 dni roboczych szczególnie w przypadku konieczności wyprodukowania nowego numeru LOT. W związku z powyższym uprzejmie prosimy aby termin dostawy odczynników po reklamacji ilościowej i jakościowej liczony był od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę. a Wykonawca dołoży wszelkich starań aby dostarczyć sondy w możliwie najkrótszym czasie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 4 ust. 16; pakiet nr 6:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego, aby dla pakietu 6 wyraził zgodę na wydłużenie czasu dostawy dla sond z pakietu nr 6 do 10 dni roboczych po stwierdzeniu braków ilościowych w dostawie przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie: Zasugerowany w dokumencie czas dostarczenia sond w przypadku konieczności sprowadzenia ich z magazynu Producenta z poza terytorium Polski, w tym także ich wyprodukowania w przypadku wyczerpania puli magazynowej może być trudny do spełnienia. Dodatkowy czas byłby możliwością wywiązania się Wykonawcy w terminie w przypadku zajścia sytuacji nadzwyczajnych. Dlatego czas 10 dni będzie czasem optymalnym nie mniej jednak Wykonawca postara się wykonać usługę w czasie możliwie najkrótszym

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 4 ust. 16; § 5 ust. 1; pakiet nr 6:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego, aby dla pakietu nr 6 wyraził zgodę na wydłużenie czasu dostawy sond z pakietu nr 6 do 15 dni roboczych w przypadku wystąpienia i uznania reklamacji jakościowej Zamawiającego.

Uzasadnienie: Wymienione sondy w zadaniu 6 są produktami produkowanymi przez Producenta poza terytorium Polski. Wszelkie reklamacja, zwłaszcza jakościowe, muszą zostać skonsultowane i wymagają sprawdzenia przez dział jakości producenta w miejscu produkcji. Pragnę podkreślić iż samo sprawdzenie nowych pozycji może zająć do 10 dni roboczych szczególnie w przypadku konieczności wyprodukowania nowego numeru LOT. W związku z powyższym uprzejmie prosimy aby termin dostawy odczynników po reklamacji jakościowej został wydłużony do 15 dni roboczych, a Wykonawca dołoży wszelkich starań aby dostarczyć sondy w możliwie najkrótszym czasie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 39

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 9 ust. 1; pakiet nr 6; SWZ; część VI pkt 2 i 3:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość zmiany numerów katalogowych sond FISH, podczas trwania umowy, podyktowaną wprowadzeniem sond FISH z nowym certyfikatem IVDR.

Odpowiedź: Zamawiający w § 2 ust. 5 dopuszcza wyroby równoważne.

Pytanie nr 40

SWZ; rozdział VI, pkt 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla pakietu nr 6 materiały informacyjne były dokumentami sporządzanymi przez dostawcę oferowanych sond w j. angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby dla pozycji 1-5 (RUO) materiały informacyjne były dokumentami sporządzanymi przez dostawcę oferowanych sond w j. angielskim. Dla pozycji 6-10 (CE-IVD) Zamawiający wymaga, aby materiały informacyjne były dokumentami sporządzanymi przez dostawcę oferowanych sond w j. polskim.

Pytanie nr 41

Zał. nr 3.1 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy); § 2 ust. 5; pakiet nr 6:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego, aby dla pakietu 6 wyraził zgodę na dodanie punktu z zapisem „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w powyżej wyznaczonym terminie, przy czym w sytuacjach uzasadnionych Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu na wniosek Wykonawcy wraz ze wskazaniem przyczyny przez Wykonawcę z jakich termin dostawy nie jest możliwy do dotrzymania oraz ewentualnymi dokumentami źródłowymi na potwierdzenie przyczyn niezależnych od Wykonawcy” Zapis ten pozwoli Wykonawcy na rzetelne wykonanie dostawy odczynników z pakietu nr 6 z zachowaniem możliwości wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 42

SWZ; część VI pkt 2 i 3; Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy); pakiet nr 6; poz. 6:

Czy Zamawiający w tabeli pakietu nr 6 pozycja nr 6 dopuszcza dostarczenia sondy z najnowszym certyfikatem CE-IVDR?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy); pakiet nr 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 3 - 5 jako osobnej pozycji w pakiecie nr 6 względem sondy z pozycji 2.

Uzasadnienie:

Wydzielenie tej pozycji umożliwi wykonawcy prawidłowe skalkulowanie i przygotowanie oferty wraz z możliwością podania numeru katalogowego przypisanego do tego odczynnika. Obecna forma zapisu obniża możliwości ofertowania dla większej liczby Wykonawców. Pozwoli to także na rzetelne oszacowanie tych pozycji w stosunku do planowanej ilości oznaczeń.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 44

Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy); pakiet nr 6; poz. 9:

Czy Zamawiający potwierdza, że przez „sonda przeznaczona do detekcji aberracji genetycznych” ma na myśli opakowanie zawierające jedną sondę FISH?

Uzasadnienie:

Część sond FISH, takich jak np. zestaw sond do diagnostyki kodelekcji lub zestaw sond prenatalnych do wykrywania aneuploidii jest dostarczana w opakowaniach zawierających dwie lub więcej fiolek sondy FISH co przekłada się na cenę zestawu. Wyrażenie zgody umożliwi rzetelną wycenę dla większości sond oferowanych jako pojedyncza sonda .

Odpowiedź: W pakiecie nr 6; poz. 9 Zamawiający wymaga dostarczenia: "Sonda molekularna podwójnie znakowana, delecyjna, gotowa do użycia, 10 testów (IVD) (1 op.)".

Pytanie nr 45

Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy); pakiet nr 6; poz. 7:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o uzupełnienie w kolumnie „ilość” ilości testów opakowania.

Odpowiedź: Zmiana Załącznika nr 2.6- Kosztorys ofertowy - Część 6 – Sondy fluorescencyjne – strony zamienne w załączeniu.

Pytanie nr 46

35.Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy); pakiet nr 6; poz. 7:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania zbiorczego zawierającego 10 testów dla sondy z pozycji 7

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy); pakiet nr 6; poz. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie sondy centromerowej pojedynczo znakowanej Spectrum Red (kolor czerwony)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 48

Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy); pakiet nr 6; poz. 1,2,3:

Czy Zamawiający potwierdza, że w pozycjach 1,2,3 odnośnie sond centromerowych dopuszcza sondy produkowane w postaci skoncentrowanej i dostarczane w roztworze hybrydazyjnym, dzięki czemu w razie potrzeby możliwe jest wymieszanie maksymalnie trzech skoncentrowanych sond satelitarnych w celu wykorzystania ich w jednej reakcji hybrydazyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 49

Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy); pakiet nr 6; poz. 6, 7:

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści sondę znakowanej fluorochromem zielonym oraz fluorochromem czerwonym?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 50

Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy); pakiet nr 6; poz. 7:

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuści sondę o poniższej specyfikacji:

HER2 (ERBB2), 17q12, kolor czerwony
D17Z1, 17p11.1-q11.1, kolor zielony

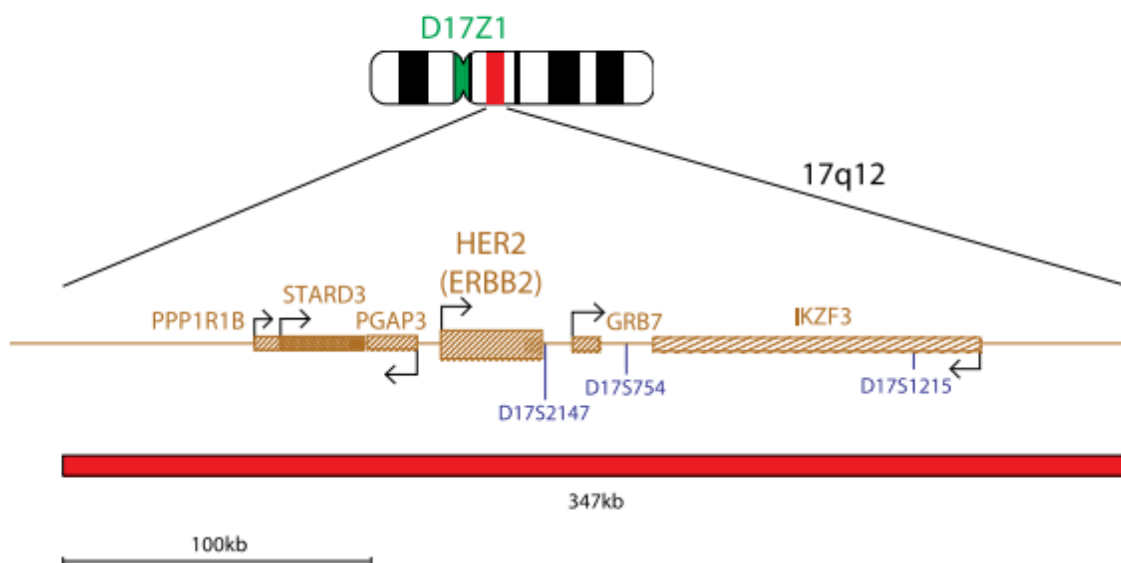

Zestaw sond służący do określenia zmian genu HER2 (ERBB2).

Sonda HER2 Amplification Probe składa się z dwóch różnie znakowanych sond: wyznakowaną czerwonym fluorochromem sondę o długości 347 kb obejmującą region genu HER2 (ERBB2) i regiony sąsiadujące, oraz sondę wyznakowaną zielonym fluorochromem komplementarną z centromerem chromosomu 17. Zestaw sond jest gotowy do użycia (fabrycznie zawieszony w buforze hybrydizacyjnym). Sonda oznakowana znakiem CE IVD.

Opakowanie 10 testów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 51

Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy); pakiet nr 6; poz. 10:

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści sondę znakowanej fluorochromem zielonym (green), fluorochromem niebieskim (aqua) oraz fluorochromem czerwonym (red)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 52

Zał. nr 2.6 do SWZ (Kosztorys ofertowy); pakiet nr 6; poz. 1, 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że dla poz. 1, 2 tabeli pakietu nr 6 wymaga sond z certyfikatem CE IVD?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

IV.

część 3

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury w komorze mroźniczej -9 °C do -30 °C, oraz w komorze chłodniczej +3 do + 16 °C ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza temperaturę w komorze mroźniczej -9 °C do -30 °C , natomiast nie dopuszcza temperatury komorze chłodzenia +3 do + 16 °C.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dopuści pojemność brutto komory chłodniczej 254 l , zaś pojemność brutto komory mroźniczej 107 l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający doprecyzuje szczegółowe dane techniczne wymaganego modułu do mikroplitek ? Nie jest to bowiem wyposażenie standardowe chłodziarko - zamrażarki laboratoryjnej ?

Odpowiedź : Zamawiający przez „moduł do przechowywania mikroplitek PCR 96/MTP/DWP” rozumie metalowy adapter do przechowywania płytek PCR, O WYMIARACH OK. 12X8,5X2CM, z 96 zagłębieniami o pojemności ok. 0,1 – 0,2ml, odpowiadającym dołkom na płytce PCR. ZMIANA Załącznika nr 2.3- Kosztorys ofertowy - Część 3 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna - strony zamienne w załączeniu

2. Działając w oparciu o zapisy art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający zmienia treść zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1.Zmiana SWZ w Części VI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Było:

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe środki dowodowe składane były wraz z ofertą.

1. Katalogi/ulotki, prospekty, foldery itp. producenta, potwierdzające jednoznacznie zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego, z zaznaczeniem której części i której pozycji dotyczą. Ich autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli dokumenty te są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski.

2. Dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do stosowania w placówkach medycznych na terenie RP – Certyfikaty CE lub równoważne, zobowiązujemy się dołączyć dokumenty do pierwszej dostawy towaru oraz na każde wezwanie Zamawiającego (dla wyrobów klasyfikowanych jako wyroby Medyczne).

3. Certyfikat (IVD) w zakresie części nr 6.

Na mocy art. 107 ust. 2 pzp, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Jest:

Zmiana SWZ w Części VI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe środki dowodowe składane były wraz z ofertą.

1. Katalogi/ulotki, prospekty, foldery itp. producenta, potwierdzające jednoznacznie zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego, z zaznaczeniem której części i której pozycji dotyczą. Ich autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli dokumenty te są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski.

2. Dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do stosowania w placówkach medycznych na terenie RP – Certyfikaty CE lub równoważne, zobowiązujemy się dołączyć drogą elektroniczną na każde wezwanie Zamawiającego (dla wyrobów klasyfikowanych jako wyroby Medyczne).

3. Certyfikat (IVD) w zakresie części nr 6.

Na mocy art. 107 ust. 2 pzp, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

2.Zmiana SWZ w Części VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Było:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

Dotyczy Części 1,2 i 6 - od daty podpisania umowy na okres 12 miesięcy

Dotyczy Części 3,4 i 5 - dostawa maksymalnie do 6 tygodni od daty obowiązywania umowy

Realizacja zamówień cząstkowych odbywać się będzie zgodnie z każdorazowym zapotrzebowaniem Zamawiającego następująco: w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Jest:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

Dotyczy Części 1,2 i 6 - od daty podpisania umowy na okres 12 miesięcy

Dotyczy Części 3,4 i 5 - dostawa maksymalnie do 6 tygodni od daty obowiązywania umowy

Realizacja zamówień cząstkowych odbywać się będzie zgodnie z każdorazowym zapotrzebowaniem Zamawiającego następująco: w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego dla Części 2 oraz w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego dla Części 6

3.Zmiana SWZ w Części XVIII. Pkt. 1 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Było:

1.Wykonawca jest związany ofertą przez **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **21.01.2024r**

Jest:

1.Wykonawca jest związany ofertą przez **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **04.03.2024r**

4.Zmiana SWZ XXII. Pkt. 1 i 2 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było:

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XXI należy złożyć w terminie **do dnia 24.11.2023 r. do godziny 09:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 09:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej**, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin

Jest:

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX należy złożyć w terminie **do dnia 06.12.2023 r. do godziny 09:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 06.12.2023 r. o godzinie 09:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej**, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin

5.Zmiana Załącznika nr 2.3- Kosztorys ofertowy - Część 3 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna.

6.Zmiana Załącznika nr 2.6- Kosztorys ofertowy - Część 6 – Sondy fluorescencyjne

6.Zmiana Załącznika nr 3.1- Projektowane postanowienia umowy

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.