

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
Nr	Nazwa pomieszczenia
A30	kuchnia
A33.1	biuro
A33.2	biuro opłat
A33.3	przeglądanie pacjenta
A33.4	kuchnia
A33.5	przebiornia
A33.6	pom. operatora RM
A33.7	Pracownia RM
A33.7	kabina higieniczna
A33.8	pom. techniczne
A33.9	pracownia TK
A33.10	pom. operatora TK
A33.11	pom. przygotowania
A34.1	WC damskie
A34.2	WC męskie
A34.3	WC mieszane
A34.3	WC mieszane nieopisanymi

OZNACZENIA

- BH1 - lampa diagnostyczna
EA1 - tablica alarmów syst. przyw
EA3 - przycisk wezwania linkowy
EA4 - kasownik sygnału wezwania


- | |
|---------------------------------|
| H1 - komputer PC |
| H2 - monitor do komputera |
| H3 - drukarka do komputera |
| HR - monitor diagnostyczny |
| HK - kserokopialka |
| HN - miszeczarka |
| KC - zawór czepialny |
| KF(x) - zlewoczuwiyak |
| KH - zlew gospodarczy |
| KI1 - dozownik z plynem dezynf. |
| KI2 - dozownik z detergientem |
| KK - miszka uslapowa |
| KN - miszka uslapowa dla nps |

- | | |
|--------|--------------------------------|
| nP | - pisuar |
| KS | - kratka ściekowa |
| KU | - umywalka |
| KUN | - umywalka dla nps |
| P11 | - stoik zabiegowy |
| P16M | - wozek transportowy |
| P33M | - wozek inwalidzi |
| PAD(x) | - szafka stojąca |
| PAK(x) | - szafa |
| PAS(x) | - szafa |
| PAW(x) | - szafka wisząca |
| PR9 | - wózka reanimacyj |
| RT | - wieszak na fartuchy ochronne |
| RG | |

- RH1 - stanowisko opisowe
 RM/R - rezonans magnetyczny
 RMS - pulpit sterowniczy RM
 RTC - tomograf komputerowy
 RTS - pulpit sterowniczy TK
 S1 - szafka pod zlewomylwak
 S3 - szafka stojąca
 SZD(x) - samozamykacz drzwiowy

- T1 - taboret
T2 - taboret obrotowy
T3 - krzesło tapicerowane
T4 - fotelik tapicerowany
T8 - stół
T11 - regał
T14 - fotel obrotowy
TAB2 - kontener biurowy
TL1 - łada recepcyjna

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1 | XB1 - biurko |
| 2 | 1A - stacyjny kłopotliwki |
| 3 | 11 - telefon |
| 4 | 14 - lustro |
| 5 | 15 - lustro nad umywalkę |
| 6 | 16 - podajnik na ręczniki |
| 7 | 17 - wieszak |
| 8 | 18 - pojemnik na odpady |
| 9 | 20 - wieszak na papier toaletowy |
| 10 | 21 - wieszak na papier toaletowy |
| 11 | 22 - szafka do wc |
| 12 | 25 - lampka na biurko |
| 13 | 30 - chodzik |
| 14 | 46-49 - pocztowy dla mps |
| 15 | 63 - czajnik elektryczny |
| 16 | 64 - kuchenka mikrofalowa |

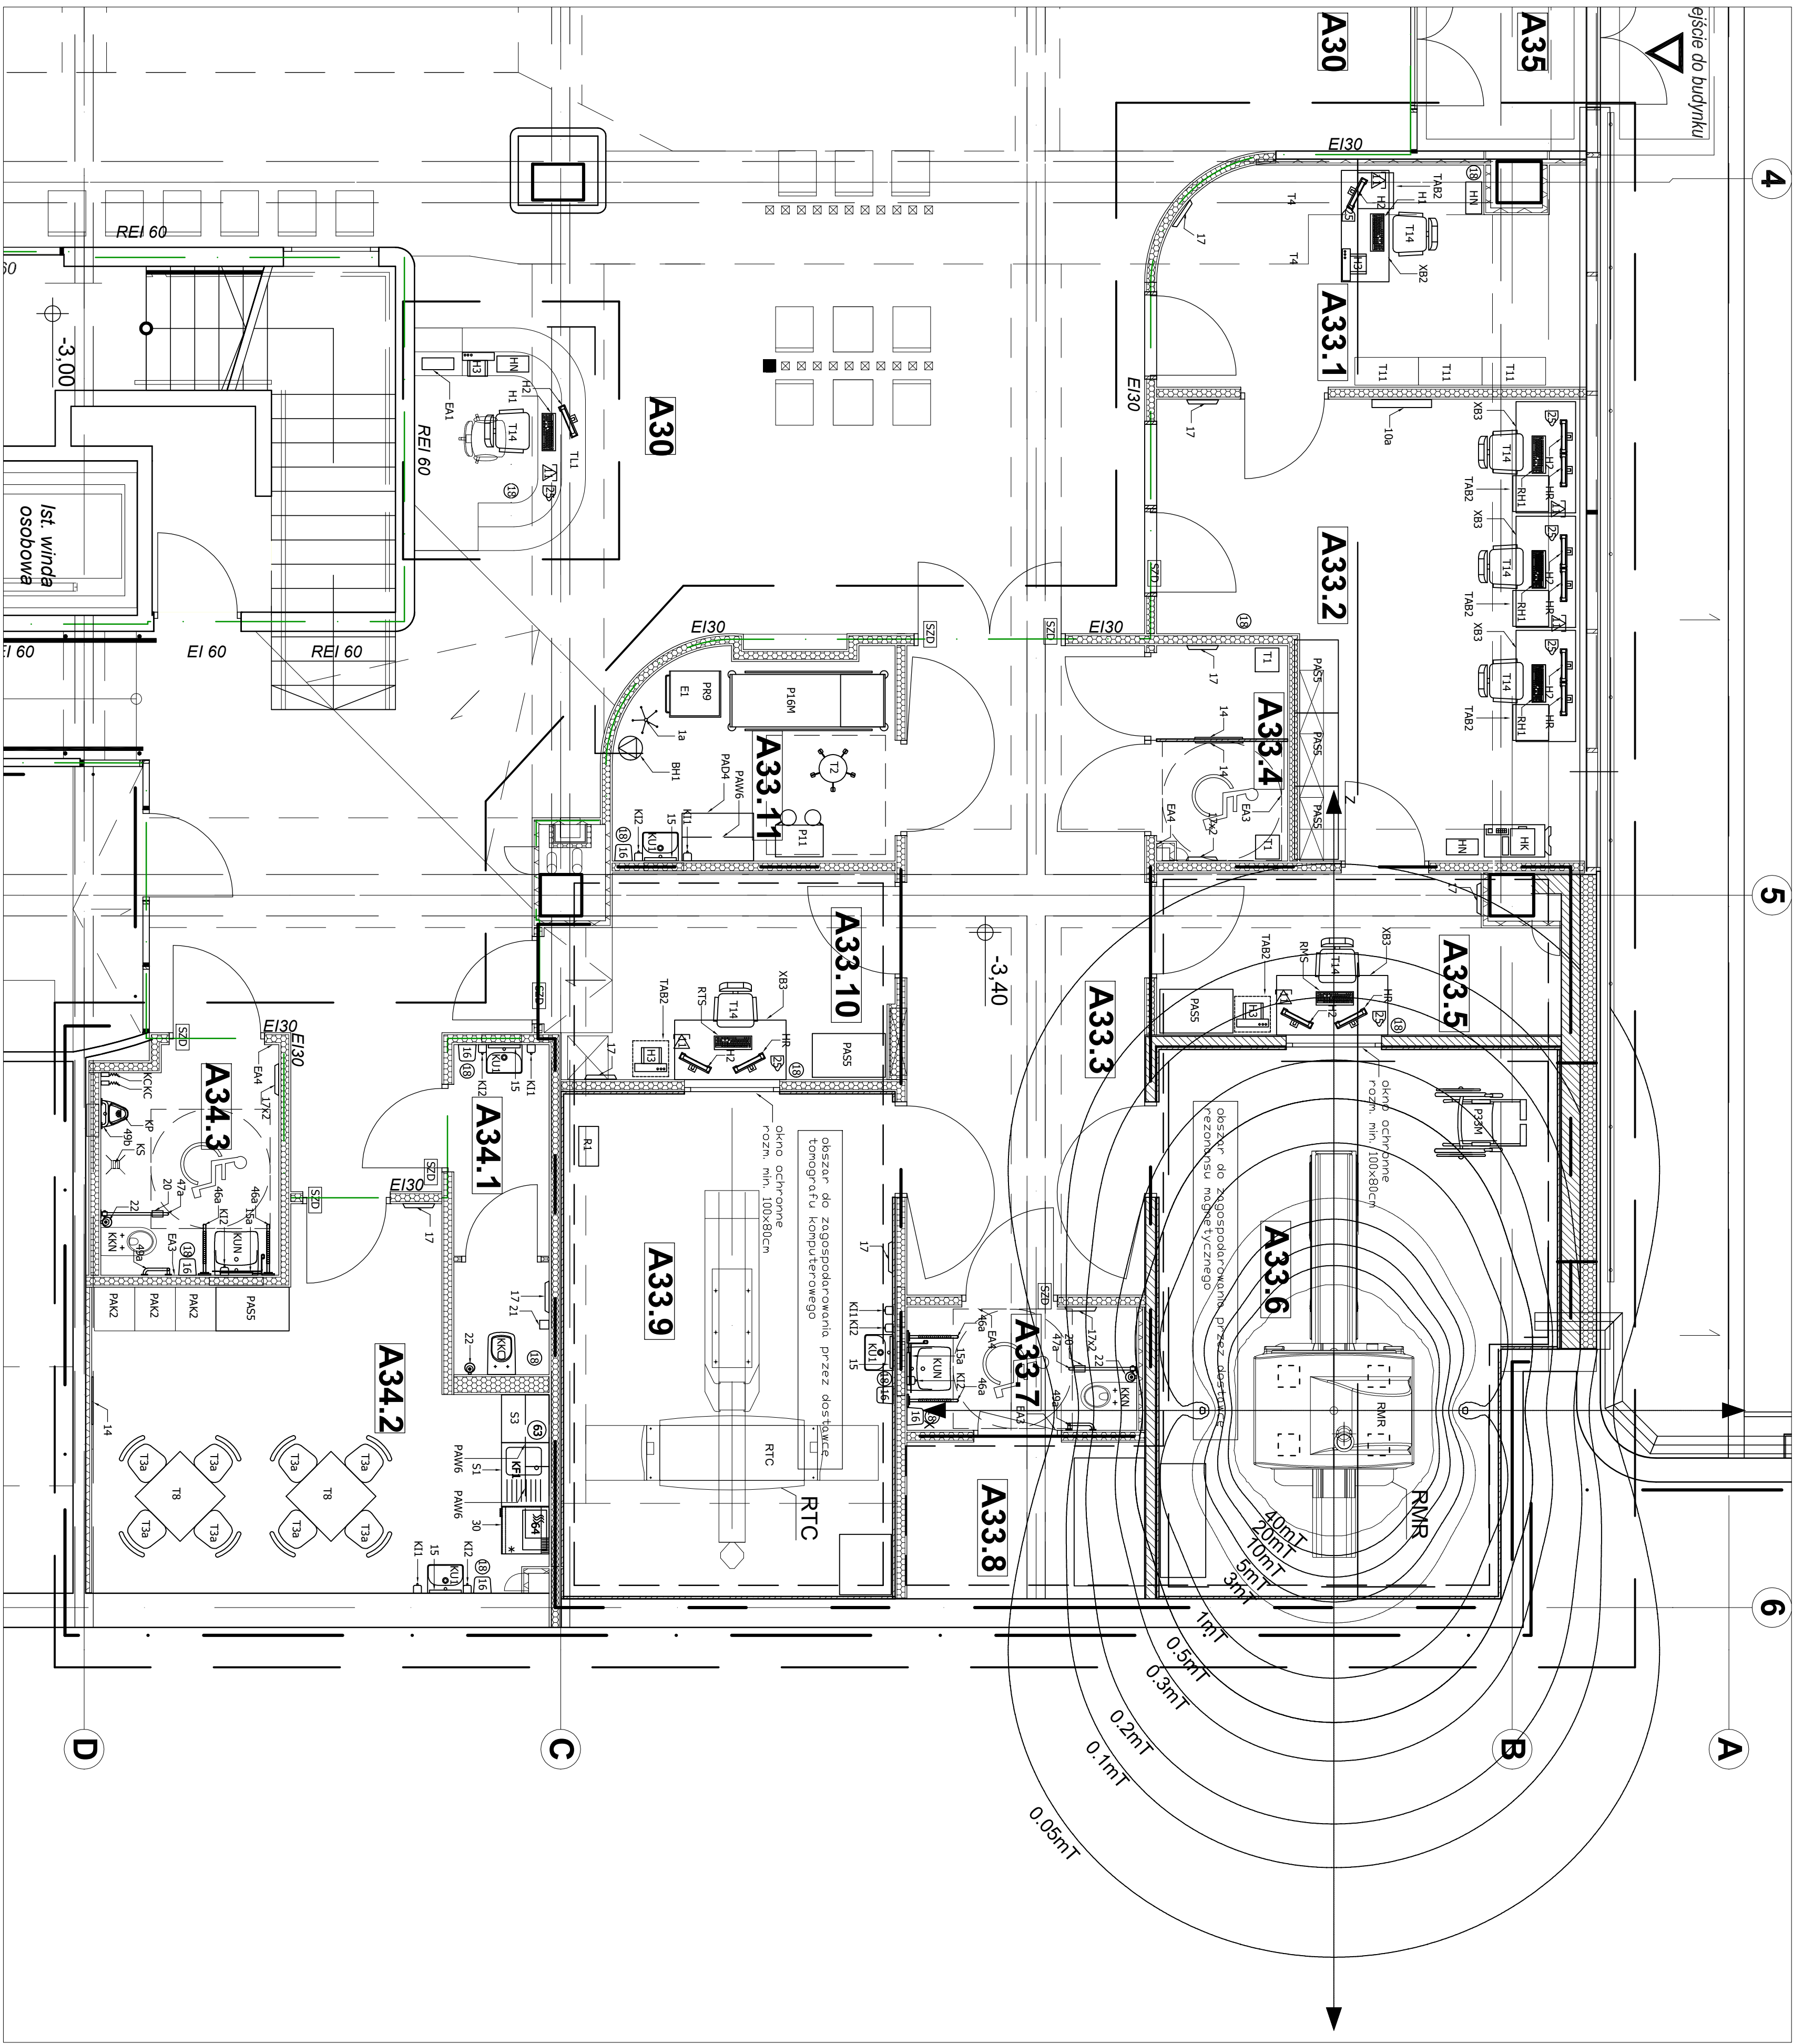

UWAGA

- wszystkie przyłączy pominy by zgodnie z DTR uzgodnione z Inwestorem
- wyposazenie meblowe zgodnie z projektem aranżacji wnętrza architektury
- instalacje zagospodarowanie, w tym projekt osób, dla pom. będąc TK, RM zrealizować zgodnie z załącznikiem dostawców urządzeń
- w pom. przy rozczuśnieniu magnetycznego nie mogą znajdować się elementy ferromagnetyczne
- obciąża dla magnetycznego podłoga dla przybliżony, rzeczywisty zależy od konkretnego aparatu
- projekt rozkładu mebli zgodnie z pozostałymi branżami
- wszelkie niemożności należy bezwzględnie wyświadczyć z projektem i projektem głównym

[illegible]