



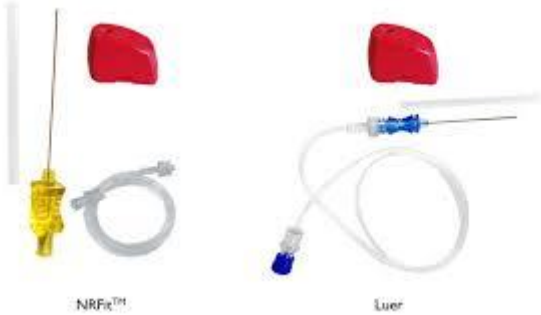
Puck, dn. 03.12.2025 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy jednorazowych wyrobów medycznych, znak ZP/16/2025

Działając na podstawie art. 284 ust 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany jej treści.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	PAKIET 1, POZ. 23 Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania osłony chroniące worki do żywienia pozajelitowego przed światłem, nie prześwitującej , o wymiarze : 30 (szerokość) x 50 (długość) cm	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
2.	PAKIET 2, POZ. 8,9 Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania przewodu do cystoskopu lub rektoskopu- podwójny; służący do podłączania przez igłę do pojemnika z płynem irygacyjnym z drenem o średnicy 5,5 x 8,0 mm. Wielkość drenu pozwala na wygodne wykorzystanie produktu podczas zabiegów .	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
3.	PAKIET 4, POZ. 1 Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ścięty min. dwupłaszczyznowo ze zmatowioną lub nie powierzchnią, komora kroplowa o wielkości min.6 cm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany zieloną zatyczką, dren zabezpieczony koreczkiem Air Pass lub Air Stop z filtrem hydrofobowym umożliwiającym wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ
4.	PAKIET 5, POZ. 9 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przewodów do ssaka 8-10x5-7x3000 mm; niejałowy z dwoma elastycznymi konektorami przyłączeniowymi. Czy zamawiający oczekuje dwóch rozmiarów do wyboru podczas realizacji czy dowolny z podanych ?	Pytanie dotyczy pozycji 8 – Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie dokonuje się zmiany opisu przewodu wymienionego w pakiecie 5 poz. 8. Treść zmiany pod tabelą.
5.	PAKIET 5, POZ. 20 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy przyrząd do wielokrotnego pobierania leku z filtrem antybakteryjnym 0,10-0,50 µm, (typu spike), ma posiadać wbudowaną zastawkę , która zabezpiecza wydostawanie się leku podczas odwróconej pozycji opakowania , a tym samym buduje system zamknięty ograniczający nadkażanie	Tak, przyrząd do wielokrotnego pobierania leku z filtrem antybakteryjnym 0,10-0,50 µm, (typu spike), ma posiadać wbudowaną zastawkę , która zabezpiecza wydostawanie się leku

	materiału znajdującego się wewnątrz opakowania przez cały okres użytkowania.	podczas odwróconej pozycji opakowania , a tym samym buduje system zamknięty ograniczający nadkażanie materiału znajdującego się wewnątrz opakowania przez cały okres użytkowania.
6.	PAKIET 14, POZ. 5 Prosimy Zmawiającego o możliwość zaoferowania podwójną poliuretanową przedłużką z kolorowymi zaciskami , przedłużki zakończone systemem bezigłowym o wytrzymałości do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
7.	PAKIET 14, POZ. 5 i 6 Czy zmawiający w ramach zaoferowanego sprzętu do pozycji 5 i 6 (przedłużeń wielodrożnych) oczekuje, aby każdy z produktów posiadał zawór zwrotny na każdej linii. Dlaczego ?: 1.Zapobiega mieszanii się leków w przedłużeniu, co zmniejsza ryzyko niezgodności i powikłań. 2. Gwarantuje stabilny przepływ – każdy lek biegnie swoją linią bez wpływu na pozostałe. 3. Zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, bo chroni przed przypadkowym podaniem zbyt dużej lub niewłaściwej dawki wskutek cofnięcia się roztworu. 4. Ułatwia pracę personelu, który może podawać różne leki równolegle bez obaw o wzajemne „wypychanie” się płynów.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
8.	PAKIET 14, POZ. 6 Prosimy Zmawiającego o możliwość zaoferowania potrójną poliuretanową przedłużką z kolorowymi zaciskami , przedłużki zakończone systemem bezigłowym o wytrzymałości do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
9.	PAKIET 14, POZ. 7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej z 6 paski RTG, pozostałe parametry zgodnie z SWZ .	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniuli dożylniej bezpiecznej z 6 paski RTG, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
10.	Zakres 24 poz.3 Czy Zamawiający dopuści: Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2,8mm z funkcją rotacji? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.

11.	Zakres 36 poz.1 Czy Zamawiający dopuści: Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, ząb szczura o rozwarciu 15mm, lub w wersji obrotowej: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy 8,3 mm obrotowych
12.	Czy Zamawiający w pakiecie 7 dla pozycji 2 dopuści : Zamiennie za rozmiar 26G/120mm rozmiar 25G/120mm lub 27G/120mm?	Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ
13.	Czy Zamawiający w pakiecie 32 dopuści dla : Pozycja 1 – Igła do blokad powięziowych widoczna w USG  Wysokie echogeniczna igła do blokad nerwów obwodowych. Igła piaskowana, pokryta PTFE dla lepszego poślizgu, ułatwiając penetrację. Kąt ścięcia 30°. Znaczniki głębokości na pierwszych 2cm co 1mm 360° wokół igły, dodatkowy podwójny znacznik na 5cm. Igła wyposażona w przezroczystą, odkręcaną przedłużkę pozwalającą podłączyć strzykawkę bezpośrednio do igły. W zestawie zabezpieczenie igły po wykonaniu procedury. 22G × 50 mm, 22G × 80 mm, 21G × 100 mm?	Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ
14.	Czy Zamawiający w pakiecie 32 dopuści dla: Pozycja 2 – Igła do blokad obwodowych z kablem do stymulatora, widoczna w USG Igła echogeniczna, widoczna końcówka pod dużym kątem, struktura 3 płaszczyzn, segmenty 2 × 10 mm, 360°, uchwyt kodowany kolorystycznie, dren iniekcyjny, kabel do stymulatora nerwowego, 22G × 80 mm, 22G × 100 mm?	Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ

W oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany treści Opisu przedmiotu zamówienia (zał. Nr 2 do SWZ) w zakresie pakietu 5 poz. 8, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Przewód do ssaka 9-10x5-7x3000 mm; **jałowy** z dwoma elastycznymi konektorami przyłączeniowymi.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 03.12.2025 r.