



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201  
e-mail: [nzoz.kss@szpital.kutno.pl](mailto:nzoz.kss@szpital.kutno.pl) [www.szpital.kutno.pl](http://www.szpital.kutno.pl)  
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 05.12.2024 r.

## **SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO.**


Nr postępowania: **ZP/31/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno – Dział Zamówień Publicznych informuje o sprostowaniu do Wyjaśnień Nr 1 z dnia 04.12.2024 r.

Zamawiający omyłkowo nie zamieścił odpowiedzi na poniższe pytania, które wpłynęły w terminie, w dniu 19.11.2024 r.

- Dotyczy zapisów SWZ** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania 1 dniowego terminu dostawy Zamawiający zobowiązuje się do wysłania zamówienia do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dostawę.  
**Zamawiający potwierdza**
- Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy o określenie terminu płatności.  
**Wykonawcy mają możliwość zaproponowania terminu płatności w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).**
- Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający wymaga:
  - Standardowe ostrza chirurgiczne z wysokiej jakości stali węglowej, ostre, nie powodujące szarpana skóry.
  - Produkt sterylny, klasy IIa
  - Sterylizacja za pomocą promieniowania gamma
  - Każde ostrze pakowane jest indywidualnie w folię metalową z rysunkiem ostrza w skali 1:1
  - Na pojedynczym ostrzu wygrawerowana nazwa producenta oraz numer ostrza
  - Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie oznakowany kształt ostrza, rozmiar, data ważności, data produkcji
  - Jednorazowego użytku**Zgodnie z zapisami SWZ.**
- Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści opakowanie bez kolorowego kodu identyfikującego rodzaj?  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
- Dotyczy Pakietu Nr 6** - Czy Zamawiający dopuści :  
**Skład**
  - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
  - 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm;
  - 1 serweta 100 x 100 cm;
  - 1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 23 cm;

- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25 cm oraz trójkątnym zbiornikiem na płyny wyposażonym w kształtkę (szywnik), separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka;
- 2 ręczniki 30 x 40 cm;

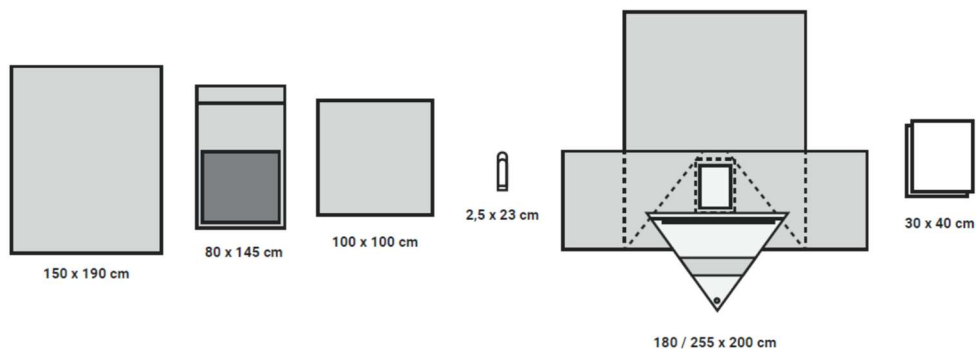


**Zgodnie z zapisami SWZ.**

#### 6. Dotyczy Pakietu Nr 7 - Czy Zamawiający dopuści ;

- Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795

#### Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta 100 x 150 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 foliowa osłona na przewody 15 x 250 cm;
- 1 serweta główna 200 x 300 cm ze zintegrowanym trójkątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtkę (szywnik), samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm i zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm

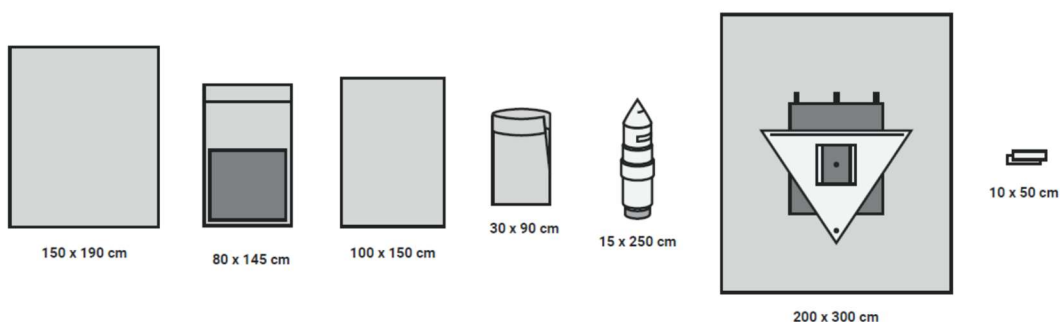

**Zgodnie z zapisami SWZ.**


#### 7. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

#### Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 przylepna kieszeń dwukomorowa 2 x 15 x 40 cm

- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/240 x 280 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, otworem przylepnym 30 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną i otoczonym padem chłonnym 50 x 55 cm oraz otworem przylepnym 12 x 15 cm otoczonym padem chłonnym z płachtą umożliwiającą zakrycie otworu. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.;

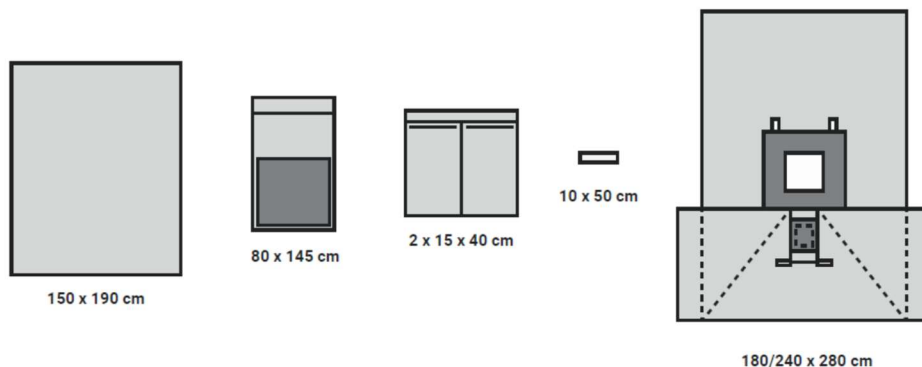


**Zamawiający dopuszcza.**

**8. Dotyczy Pakietu Nr 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw:**

- Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

**Skład**

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm czerwona ;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

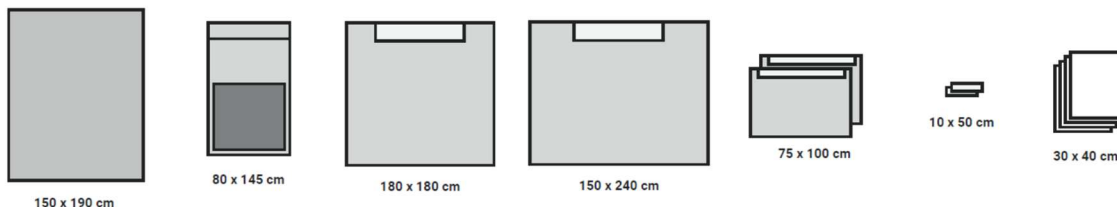

**Zamawiający dopuszcza.**

**9. Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści 3 sztuki naklejek TAG?**

**Zamawiający dopuszcza.**

**10. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści ściereczki pakowane a 2 sztuki?**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**11. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**12. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar min. 30 x 40 cm?**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**13. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową?**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**


**14. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze Serweta 230x260cm z wycięciem U- 10 x 100 cm?**

**Zamawiający dopuszcza.**

**15. Dotyczy Pakietu Nr 22 - Czy Zamawiający dopuści;**

**Skład**

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm

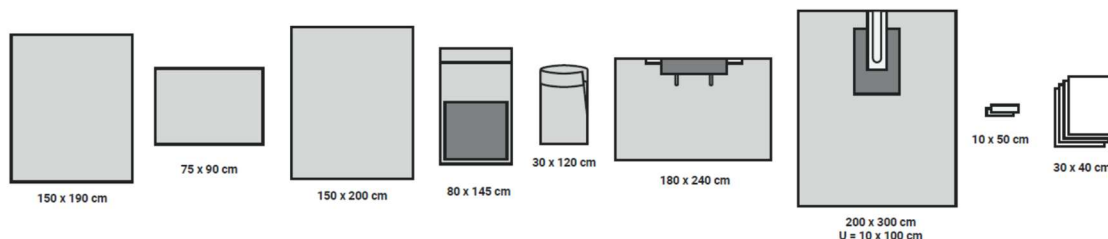

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**16. Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści rozmiary M,L,XL,XXL?**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**17. Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści oznakowanie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu i serwecie. Rozmiar widoczny przed otarciem, dodatkowo wyraźnie oznaczony na opakowaniu. ?**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**18. Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm?**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**19. Dotyczy Pakietu Nr 29, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe?**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**20. Dotyczy Pakietu Nr 29, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści Serweta 50x60cm z otworem przylepnym . 6x8cm?**

**Zamawiający dopuszcza.**

**21. Dotyczy Pakietu Nr 33 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową samoprzylepną 30 x 40 cm (podział 15cm + 15cm) wysokość: 40cm?**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

Podpisał:  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
Agnieszka Tomalak