



D.25C/250/ 294 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY URZĄDZEŃ DO ELEKTROFIZJOLOGII SERCA ORAZ INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ KRIOKONSOLI DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/14-22rj/23, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 15 przewodników diagnostycznych pokrytych teflonem, posiadających dwa rodzaje końcówek prostą i zagiętą typu "J", dostępne średnice – 0,018", 0,021", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038" oraz dostępne długości – 50, 145, 80, 145, 180, 260 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zad. 11

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zapisy dot. art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zostały zawarte w §3 ust. 7 Projektów Umów (załącznik nr 5 do SWZ).

4. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zad. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §4 ust. 1)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy dotyczące przechowywania asortymentu zostały zawarte w § 4 Projektu Umowy dla zadań: 1-12 (załącznik nr 5 do SWZ).

5. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zad. 11

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1:



1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówienia częściowego**

b) nie dochowania terminów określonych w § 5 lub § 41 ust. 5, 14, 15 lub 19* w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej dostawy;**

d) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 15 lub 16 lub § 41 ust. 4 lub 21* niniejszej umowy w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §5 ust. 3 wzoru umowy dla Zadań 13-15:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych do 3 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §6 ust. 1d) wzoru umowy dla Zadań 13-15:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 50,00 zł za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy umowy do wszystkich zadań.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy dla Zadań 13-15:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar do 20% łącznej wartości przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar maksymalnych do 50 %. Dotyczy umowy do wszystkich zadań.

9. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 koszulki o 4 krzywiznach?

Wszystkie pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

10. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu 2

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod ablacyjnych o następujących parametrach:

Pozycja 1

1. Długość 110 cm

2. Średnica cewnika 7F.

3. Elektroda dwukierunkowa.

4. 1 stopień sztywności

5. 3 krzywizny symetryczne

6. Końcówka 4mm, 8mm do wyboru przez Zamawiającego.

7. dostępne również elektrody jednokierunkowe o 5 krzywiznach

9. Współpraca z generatorem Amper.

Pozycja 2

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

11. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu 3

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów konkurencyjnych o następujących parametrach:

Pozycja 1

Elektroda 10 polowa sterowalna do zatoki wieńcowej 6 F, 7 F jednokierunkowa o długości 110 cm. W ramach zadania oferujemy również unikatową krzywiznę 3 D ułatwiającą pracę operatorowi.

Pozycja 2 – zgodnie z SIWZ

Pozycja 3

Elektroda ablacyjna przepływowa, jednokierunkowa o j 4 rodzajach krzywizn do wyboru przez Zamawiającego. Krzywizny symetryczne – do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

12. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu 4

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów udowych 5-10 F (co 1 F).

Wszystkie pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

13. Zapytanie Wykonawcy:


do pakietu 8

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod do mapowania żył płucnych PV o następujących parametrach:

Pozycja 1

- elektroda do mapowania żył płucnych
- średnica 6 i 7F,
- Średnica pętli 4 F;
- dostępna średnica pętli stała (15, 18,21, 24 mm) mm);
- odchylenie rdzenia elektrody jednokierunkowe – poniżej zdjęcia.
- Zakrzywiona do 180-270 – łatwa manewrowalność
- do wyboru elektrody 10 i 20 biegunowe
- 32 – nitkowa konstrukcja drutowa – brak deformacji podczas zabiegów
- Specjalnie zaprojektowana końcówka - atraumatyczność

Poniżej zdjęcia proponowanej elektrody:

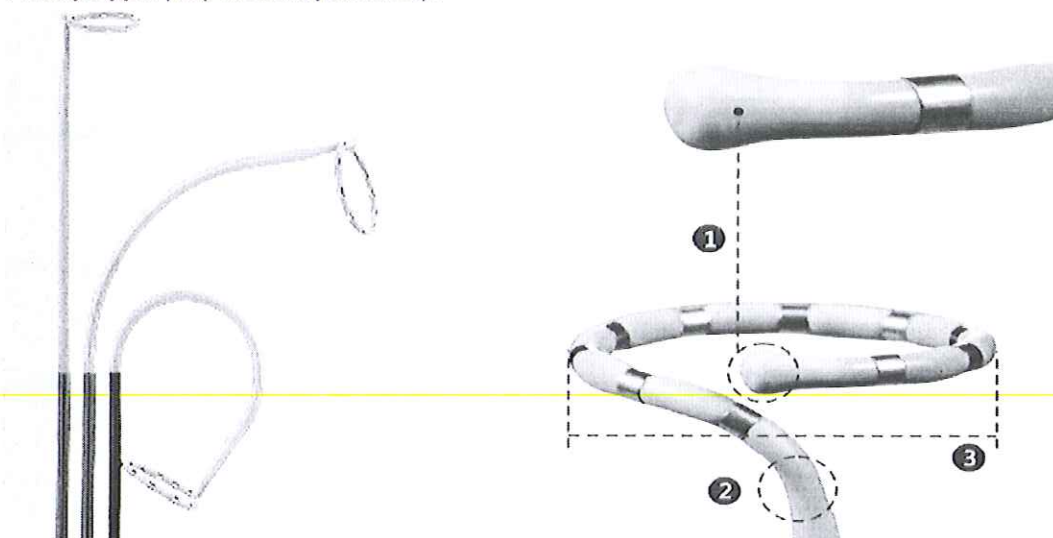

Pozycja 2 - zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

14. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu 9

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów konkurencyjnych o następujących parametrach:




Pozycja 1

- Średnica zewnętrzna igły: 18 G- 19 G
- Dostępne 3 różne długości 56, 71, 89 cm
- igła wykonana ze stali z plastikowym motylkiem
- dostępne krzywizny N0 i N1
- igła bez kranika
- dostępna wersja extra sharp


Pozycja 2

W skład zestawu wchodzi koszulka (sheath), rozszerzacz (dilator) i prowadnik (guidewire) 0,032" 150/180 cm 3 mm J

- Zestaw nadaje się do współpracy z igłą transeptalną z pozycji 4
- dostępne długości 60, 62 cm i 80 cm
- Dostępne 3 średnice: 8 F; 8,5 F i 10 F
- Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną, boczny dren do przepłukiwania (z kranikiem trójdrożnym)
- dostępne 4 krzywizny – poniżej zdjęcie proponowanych



3D curve

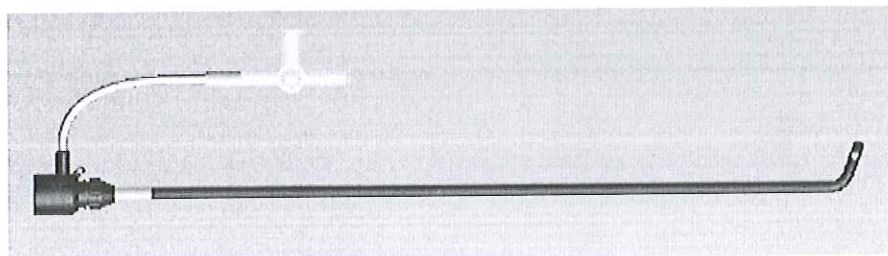

- Koszulka zbrojona, jest widoczna w obrazie skopii rentgenowskiej (radiopaque)

Pozycja 3

Koszulka transeptalna sterowalna, dwukierunkowa, symetryczna, w zestawie z introducerem z zastawką hemostatyczną, prowadnikiem i rozszerzaczem; Koszulka o średnicy 8.5F i długości 67 i 73 cm do wyboru .

Dostępne 3 krzywizny 17 mm, 22 mm, 50 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza produktów zaoferowanych do zadania 9 poz. 1 i 2, natomiast dopuszcza produkt zaoferowany do zadania 9 poz. 3.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

mgr Monika Klause



UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu pomiędzy:

..... z siedzibą w, ul
wpisaną do rejestru po numerem

reprezentowaną przez:

.....,
zwanym dalej Przechowawcą

a

....., z siedzibą w, ul

wpisaną do rejestru pod numerem

reprezentowaną przez :

1.

2.

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w na Oddziale, które znajduje się w, – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan _____

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.
2. Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.



§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

§5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.
2. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.
3. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

§7

1 Zmiana cen przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie na zasadach określonych w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust.1.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

§9

1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§10

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od



2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA



Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

