

Wejherowo, dnia 14.01.2022 r.

D.25C/250/ 28 /2021

wg rozdzielnika

I. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZECZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”** znak: D25C/251/N/33-83rj/21, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wózek do transportu pacjenta był wyposażony w zasilanie prądem zmiennym zgodnie z normą IEC 60601-1 - elektryczny sprzęt medyczny, jeżeli nie prosimy o usunięcie tej normy. Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie wymagał, aby wózek do transportu pacjenta był wyposażony w zasilanie prądem zmiennym. W związku z powyższym Zamawiający usuwa zapis dotyczący normy IEC 60601-1 dla zadania 3 „Wózek do transportu pacjenta”.

2. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 4 WÓZEK – FOTEL TRANSPORTOWY

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wózek - fotel transportowy był wyposażony w zasilanie prądem zmiennym zgodnie z normą IEC 60601-1 - elektryczny sprzęt medyczny, jeżeli nie prosimy o usunięcie tej normy. Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie wymagał, aby wózek do transportu pacjenta był wyposażony w zasilanie prądem zmiennym. W związku z powyższym Zamawiający usuwa zapis dotyczący normy IEC 60601-1 dla zadania 3 „Wózek - fotel transportowy”.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z zadania nr 2 do odrębnych pakietów do zwiększenia konkurencyjności cenowej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 1 łóżko szpitalne podstawowe, sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 51 szt

Ptk. 7. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach o szerokości 100 cm ? co różni się tylko o 3 cm od wymaganego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



5. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 1 łóżko szpitalne podstawowe, sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 51 szt

Ptk.10. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 190 cm x 90 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 1 łóżko szpitalne podstawowe, sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 51 szt

Ptk. 12. Czy Zamawiający dopuści aluminiowe barierki boczne, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 1 łóżko szpitalne podstawowe, sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 51 szt

Ptk. 17. Czy Zamawiający dopuści regulacje wysokości leża w zakresie 430-790 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 1 łóżko szpitalne podstawowe, sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 51 szt

Ptk. 20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji w segmentów pleców 8 cm, uda – bez autoregresji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 2. łóżko szpitalne intensywnej opieki, elektryczne, bez wagi i bez funkcji przechyłu bocznego, z wyposażeniem – 7 szt.

Ptk. 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko oznakowane normą 93/43/EWG zmienionej dyrektywą 2007/47/WE?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zaferowania produktu spełniającego obecnie obowiązujące normy, zarejestrowanego, dopuszczonego do obrotu i używania na terenie Unii Europejskiej oraz posiadającego wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające używanie w placówkach ochrony zdrowia.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 2. łóżko szpitalne intensywnej opieki, elektryczne, bez wagi i bez funkcji przechyłu bocznego, z wyposażeniem – 7 szt.

Ptk. 8. Czy Zamawiający dopuści leże łóżka na pantogramie, który jest bardziej stabilny oraz tańszy w eksploatacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 2. łóżko szpitalne intensywnej opieki, elektryczne, bez wagi i bez funkcji przechyłu bocznego, z wyposażeniem – 7 szt.

Ptk. 14 Czy Zamawiający dopuści wskaźnik Bez podświetlanej cieczy, a zamiast niego graficzny wskaźnik informujący o kącie pochylecia leża segmentu pleców i nóg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 2. łóżko szpitalne intensywnej opieki, elektryczne, bez wagi i bez funkcji przechyłu bocznego, z wyposażeniem – 7 szt.

Ptk. 15 Czy Zamawiający dopuści panele sterowania bez konieczności podświetlania z dobrze widocznymi piktogramami

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

Pozycja 2. Łóżko szpitalne intensywnej opieki , elektryczne, bez wagi i bez funkcji przechyłu bocznego , z wyposażeniem – 7 szt.

Ptk. 17 Czy Zamawiający dopuści panel sterowniczy bez dodatkowego przycisku

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 2. Łóżko szpitalne intensywnej opieki , elektryczne, bez wagi i bez funkcji przechyłu bocznego , z wyposażeniem – 7 szt.

Ptk. 18 Czy Zamawiający dopuści regulacje elektryczną w zakresie 40-81 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 2. Łóżko szpitalne intensywnej opieki , elektryczne, bez wagi i bez funkcji przechyłu bocznego , z wyposażeniem – 7 szt.

Ptk 29. Czy Zamawiający dopuści wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych bez sterowań nożnych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 2. Łóżko szpitalne intensywnej opieki , elektryczne, bez wagi i bez funkcji przechyłu bocznego , z wyposażeniem – 7 szt.

Ptk. 33. Czy Zamawiający dopuści przycisk bezpieczeństwa w innej formie poprzez dezaktywację aktywnej funkcji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 2. Łóżko szpitalne intensywnej opieki , elektryczne, bez wagi i bez funkcji przechyłu bocznego , z wyposażeniem – 7 szt.

Ptk. 36. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez piątego koła

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 2. Łóżko szpitalne intensywnej opieki , elektryczne, bez wagi i bez funkcji przechyłu bocznego , z wyposażeniem – 7 szt.

Ptk. 38 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez Systemu elektrycznego kolumn i siłowników wyposażonych w dźwiękowy system przeciążenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 2. Łóżko szpitalne intensywnej opieki , elektryczne, bez wagi i bez funkcji przechyłu bocznego , z wyposażeniem – 7 szt.

Ptk. 39 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez Systemu elektrycznego łóżka wyposażonego w pamięć ostatnich min 500 funkcji, przeciążeń oraz błędów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Ptk. 9 Czy Zamawiający dopuści Leże łóżka 4-sekcyjne oparte Na kolumnach prostopadłościennych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



21. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Ptk. 11 Czy Zamawiający dopuści Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą pokrętki

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Ptk. 15 Czy Zamawiający dopuści zamiast pilota bardziej ergonomiczne i funkcjonalne sterowanie w barierkach bocznych dla personelu i pacjenta z większą ilością funkcji niż na pilocie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Ptk. 16 Czy Zamawiający dopuści Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 48cm-82 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Ptk. 29 Czy Zamawiający dopuści selektywne blokowanie funkcji elektrycznych wszystkie oczekiwane przez Zamawiającego z pominięciem funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Ptk. 30 Czy Zamawiający dopuści Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji na panelu sterowniczym, sterowanie w barierkach oraz sterownikach nożnych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Ptk. 31 Czy Zamawiający dopuści Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji z pilota lub panelu po 120 sek sekundach nieużywania regulacji, co jest wartością bardziej ekonomiczną

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

27. Zapytanie Wykonawcy:


Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Ptk. 37. Czy Zamawiający dopuści Bezpieczne obciążenie robocze o innej wartości w pozycji horyzontalnej oraz bezpieczne obciążenie robocze na poziomie 260 kg, pozwalające na regulacje bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



28. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Czy Zamawiający wymaga chowanego pod leżem cylindra na umieszczenie butli z tlenem

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga chowanego pod leżem cylindra na umieszczenie butli z tlenem.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Czy Zamawiający wymaga zintegrowanego z łóżkiem materaca zasilanego bezpośrednio i sterowanego z panela w łóżku bez konieczności stosowania dodatkowych pomp

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga zintegrowanego z łóżkiem materaca zasilanego bezpośrednio i sterowanego z panela w łóżku bez konieczności stosowania dodatkowych pomp.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Czy Zamawiający wymaga materaca pomocnego w rehabilitacji pacjentów poprzez zastosowanie komory wzdłużnej rotacyjnej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga materaca pomocnego w rehabilitacji pacjentów poprzez zastosowanie komory wzdłużnej rotacyjnej.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Czy Zamawiający wymaga systemu zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta w łóżku tzw siedzisko kubelkowe (system Incentro)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga systemu zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta w łóżku tzw siedzisko kubelkowe (system Incentro).

32. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Czy Zamawiający wymaga zintegrowanej wagi

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga zintegrowanej wagi.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt.

Czy Zamawiający wymaga panelu centralnego na ergonomicznej wysokości w formie 7 calowego monitora LED , z funkcją ustawienia terapii rotacyjnej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga panelu centralnego na ergonomicznej wysokości w formie 7 calowego monitora LED , z funkcją ustawienia terapii rotacyjnej.

34. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt.

Ptk. 9 Czy Zamawiający dopuści Leże łóżka 4-sekcyjne oparte Na kolumnach prostopadłościennych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



35. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt.

Ptk. 11 Czy Zamawiający dopuści Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą pokrętła

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

36. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt.

Ptk. 15 Czy Zamawiający dopuści sterowanie elektryczne przy pomocy Panel LCD umiejscowiony w szczycie od strony nóg , a panel dla personelu wbudowany w barierki środkowe z podświetlanymi graficznymi piktogramami

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

37. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt.

Ptk. 16 Czy Zamawiający dopuści Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 48cm-82 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

38. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt.

Ptk 20. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia przy tolerancji 50 g w zakresie od 0 do 150 kg i 100g od 150 do 260kg, Wyświetlacz wagi wbudowany w panelu centralnym od strony nóg oraz w podstawę łóżka od strony nóg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie 2 poz. 4 pkt 21: Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

39. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt.

Ptk. 24 Czy Zamawiający dopuści Alarm niespokojnego pacjenta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

40. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt.

Ptk 32. Czy Zamawiający dopuści Pozycje zaprogramowane i ustawiane za pomocą jednego przycisku wszystkie wymagane przez Zamawiającego , na panelu centralnym oraz na panelu wbudowanym w barierkę środkową dla personelu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

41. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt.

Ptk. 34 Czy Zamawiający dopuści selektywne blokowanie funkcji elektrycznych wszystkie oczekiwane przez Zamawiającego z pominięciem funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

42. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt.

Ptk. 36. Czy Zamawiający dopuści Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji z pilota lub panelu po 120 sek sekundach nieużywania regulacji, co jest wartością bardziej ekonomiczną

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

43. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt.

Ptk. 37. Czy Zamawiający dopuści Bezpieczne obciążenie robocze o innej wartości w pozycji horyzontalnej oraz bezpieczne obciążenie robocze na poziomie 260 kg, pozwalające na regulacje bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

44. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt.

Ptk. 42 Czy Zamawiający dopuści Bezpieczne obciążenie robocze o innej wartości w pozycji horyzontalnej oraz bezpieczne obciążenie robocze na poziomie 260 kg, pozwalające na regulacje bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

45. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt.

Ptk 43 Czy Zamawiający odstąpi od systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

46. Zapytanie Wykonawcy:

Pozycja 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt.

Czy Zamawiający dopuści wyposażenie dodatkowe bez ładowarki USB w segmencie pleców

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

47. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . Pozycja 5. MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z POMPĄ - 26 szt.

Ptk. 4 Czy Zamawiający dopuści Materac zmiennociśnieniowy, komory napelniają się powietrzem i opróżniają na przemian 1 komora na dwa

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

48. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . Pozycja 5. MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z POMPĄ - 26 szt.

Ptk 6 Czy Zamawiający dopuści Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 12 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

49. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . Pozycja 5. MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z POMPĄ - 26 szt.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

Ptk. 7 Czy Zamawiający dopuści Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) 165 kg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

50. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . Pozycja 5. MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z POMPA - 26 szt.

Ptk. 14 Czy Zamawiający dopuści Pompę zasilaną 220-240V:

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

51. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . Pozycja 5. MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z POMPA - 26 szt.

Ptk 14. Czy Zamawiający dopuści materac , który automatycznie dobiera ciśnienie do wagi pacjenta, bez ustawienia skokowego co 5 kg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

52. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . Pozycja 5. MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z POMPA - 26 szt.

Ptk. 14 Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji tłumienia drgań

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

53. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . Pozycja 5. MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z POMPA - 26 szt.

Ptk 15. Czy Zamawiający dopuści materac z automatycznie uruchamianą blokadą po innym czasie niż wymagany

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

54. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 3 Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Ptk. 3 Czy Zamawiający dopuści Leże wózka 2-segmentowe, łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji:

- 2 - segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezwłowa,

- Wózek bez podziałki w poprzek i wzdłuż leża

- Możliwość mocowania w segmencie pleców pasów unieruchamiających pacjenta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie 3 pkt 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

55. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 3 Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Ptk. 8. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości w przedziale 56cm-89cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

56. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 3 Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Ptk 9. Czy Zamawiający dopuści leże o długości 200 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

57. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 3 Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Ptk. 10. Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość wózka o wymiarze 830 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

58. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

Zadanie 3 Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Ptk. 23. Czy Zamawiający dopuści barierki boczne Lakierowane , epoksydowane z jonami srebra

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

59. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 3 Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Ptk 28. Czy Zamawiający dopuści inną wysokość materaca powlekany innym tworzywem

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

60. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 3 Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Ptk. 29 Czy Zamawiający dopuści wieszak wykonany z innego tworzywa zdejmowany z możliwością wstawienia w każdy z rogów leża, podczas gdy nie jest używany odkładany do wyprofilowanej podstawy wózka z oby stron

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w piśmie.

61. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 3 Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Ptk 30. Czy Zamawiający dopuści uchwyty wyjmowane , nie poniżej materaca, wyjmowane powodują łatwiejszy dostęp do pacjenta i nie koliduje z podstawą wózka na której znajdują się dodatkowe akcesoria i np. rzeczy pacjenta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

62. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . 6. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 77 szt.

Ptk 2 . Czy Zamawiający dopuści Szkielet szafki z profili stalowych , Korpus szafki, szuflady, boki nośne z blachy lakierowanej proszkowo

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie 2 poz. 6 pkt 5: Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

63. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . 6. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 77 szt.

Ptk. 6 Czy Zamawiający dopuści Błat główny z płyty HPL z nakładką tworzywową Błat boczny z płyty HPL

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w piśmie.

64. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . 6. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 77 szt.

Ptk 7. Czy Zamawiający dopuści poszerzenie szafki z blatem bocznym jedynie o 11 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

65. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . 6. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 77 szt.

Ptk 8 Czy Zamawiający dopuści Możliwość przechyłu blatu 30 - 60° bez możliwości blokowania w pośrednich pozycjach

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

66. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . 6. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 77 szt.

Ptk 6 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania blat szafki wykonany z płyty HPL, pokryty osłoną z tworzywa ABS z rantem zapobiegającym zsuwaniu się przedmiotów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



67. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . 6. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 77 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat boczny szafki wykonany z płyty HPL z rantami zapobiegającymi zsuwanie się przedmiotów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

68. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . 6. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 77 szt.

Ptk. 7 Czy Zamawiający dopuści szafki, które posiadają blat boczny składany do boku szafki poszerzający całkowity gabaryt szafki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

69. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . 6. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 77 szt.

PTK. 10 Czy Zamawiający dopuści szafki z indywidualną blokadą kół bez pokrętła wbudowanego w blat szafki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

70. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . 6. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 77 szt.

Ptk 11. Czy Zamawiający dopuści szafki z indywidualną blokadą kół , który wymusza wstanie pacjenta z łóżka

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

71. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . 6. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 77 szt.

Ptk 13 Czy Zamawiający dopuści szafki, które posiadają koła z indywidualną blokadą o średnicy 50 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

72. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 . 6. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 77 szt.

Ptk 14 Czy Zamawiający dopuści dopuści szafki bez uchwytów na ręczniki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

73. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Prosimy (w pkt. 5) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego leże 2-segmentowe całkowicie przezerne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża z możliwością włożenia kasety tylko od strony wezłowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

74. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Prosimy (w pkt. 5) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

75. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Prosimy (w pkt. 5) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w pasy unieruchamiające pacjenta z możliwością ich dowolnego zastosowania (bez wskazanych miejsc mocowania).

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

76. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Prosimy (w pkt. 8) o wyrażanie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego zakres regulacji wysokości 600 – 920 mm (+/- 10 mm).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

77. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Prosimy (w pkt. 9) o wyrażanie zgody na zaoferowanie długości materaca 1900 mm, co będzie traktowane jako długość leża. W oferowanym wózku długość materaca jest kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

78. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Prosimy (w pkt. 15) o wyrażanie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną (jazda swobodna, hamulec) oraz osobną dźwignię dostępną od strony szczytu nóg do obsługi jazdy kierunkowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

79. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Prosimy (w pkt. 17) o wyrażanie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego całkowitą długość wózka 2143 mm (+/- 10 mm).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

80. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Prosimy (w pkt. 25) o wyrażanie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego barierki boczne składane poniżej poziomu materaca tak jak wymaga tego Zamawiający w pkt. 24.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

81. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Prosimy (w pkt. 29) o wyrażanie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego wieszak kroplówki z możliwością zamocowania w czterech narożnikach leża.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

82. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczące zadania 3: Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z leżem dwusegmentowym, całkowicie przeziernym dla promieni RTG umożliwiającym wykonanie zdjęć na całej długości leża poza punktami podparcia kolumn, co wydaje się oczywiste?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

83. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Pytania dotyczące zadania 3: Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z leżem przeziernym dla promieni RTG na całej swej długości i prowadnicami kasety RTG na całej długości leża, z możliwością wsuwania kasety od strony wezglowia lub nóg pacjenta, bez podziałki w poprzek i wzdłuż leża?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem..

84. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczące zadania 3: Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z zakresem regulacji wysokości w przedziale od 565 do 895 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

85. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczące zadania 3: Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

W zakresie punktów nr 14 i 15: Zamawiający wymaga zaoferowania wózka z możliwością zablokowania jednego koła kierunkowego w celu jazdy kierunkowej, ułatwiając prowadzenie i manewrowanie wózkiem, a także centralnego systemu blokowania kół obsługiwanego z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną. Czy zatem Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wózek wyposażony jest w centralną blokadę kół aktywowaną dźwignią nożną od strony głowy i nóg pacjenta z funkcjami działania:

- a) blokada pełna - hamulec centralny czterech kół głównych wózka;
- b) jazda swobodna czterech kół głównych wózka;
- c) opuszczenie pod podstawą piątego koła ułatwiającego manewrowanie i pełniącego rolę koła do jazdy kierunkowej na wprost?

W tym rozwiązaniu nie ma już potrzeby, aby któreś z kół głównych miało dodatkowo funkcję jazdy kierunkowej na wprost.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

86. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczące zadania 3: Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o całkowitej długości 2130 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

87. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczące zadania 3: Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym regulacja pozycji Trendelenburga, anty Trendelenburga oraz opuszczania leża realizowana jest płynnie za pomocą trzech dedykowanych pedałów? Pedały umieszczone są po obu stronach wózka (boki wzdłużne)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

88. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczące zadania 3: Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem 230 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

89. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczące zadania 3: Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z ze składanymi barierkami bocznymi ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21





90. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczące zadania 3: Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z barierkami bocznymi składanymi równo do poziomemu leża?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

91. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczące zadania 3: Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem jednowarstwowym, którego wkład stanowi pianka poliuretanowa, a jego powłoka wykonana jest ze skaju – trwałego, całkowicie wodoodpornego, zmywalnego, odpornego na środki dezynfekcyjne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

92. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczące zadania 3: Wózek do transportu pacjenta – 15 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z uchwytami do prowadzenia składanymi szybko i wygodnie jedynie od strony głowy (od strony nóg uchwyty stałe)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

93. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu 3. WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA – 15szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych nieposiadający podziałki wzdłuż i w poprzek leża?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem..

94. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu 3. WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA – 15szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego wysokość leża regulowana jest hydraulicznie w zakresie: od 660mm do 860mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

95. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu 3. WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA – 15szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego segment leża ma szerokość 75cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

96. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu 3. WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA – 15szt. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego długość całkowita wynosi: 2220mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

97. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu 3. WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA – 15szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego szerokość całkowita wynosi: 840mm?


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

98. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu 3. WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA – 15szt. Pkt. 19. i 20.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowane są hydraulicznie w zakresie: 0-12°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w piśmie.

99. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu 3. WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA – 15szt. Pkt. 21.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego funkcja regulacji wysokości, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowane są za pomocą trzech wyraźnie oznaczonych, dedykowanych dźwigni nożnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem iż dźwignie umieszczone będą po obu stronach wózka (boki wzdłużne).

100. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu 3. WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA – 15szt. Pkt. 29.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego zintegrowany wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej ma możliwość składania do poziomu tylko wszerz leża?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

101. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta możliwością wykonania zdjęć RTG na całej długości leża, gdzie kasetę RTG umieszczana może być tylko od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

102. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta wyposażony w podziałkę wzdłuż leżą ramę niewyprofilowaną ale wyposażoną w uchwyt ułatwiający pozycjonowanie kasety RTG?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

103. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta z leżem przystosowanym do mocowania pasów w jednym miejscu na wysokości pasa pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

104. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta z regulacją wysokości w zakresie 580 – 887 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

105. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

Dotyczy ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta o długości leża 1910 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

106. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta z centralnym systemem blokowania kół obsługiwany za pomocą trójpoziomych dźwigni umieszczonych przy każdym kole?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

107. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta o szerokości całkowitej 830 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

108. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta z regulacją pozycji Trendelenburga 0 - 12°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

109. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta z regulacją pozycji anty-Trendelenburga 0 - 12°?


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem..

110. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta z regulacją przychyłków Trendelenburga i anty Trendelenburga oraz regulacje wysokości dokonywanymi za pomocą dwóch obustronnie umieszczonych pedałów, z czego jeden trójpoziomy służy do opuszczania leża oraz regulację przechyłu Trendelenburga i anty – Trendelenburga, zaś drugi do podnoszenia leża?

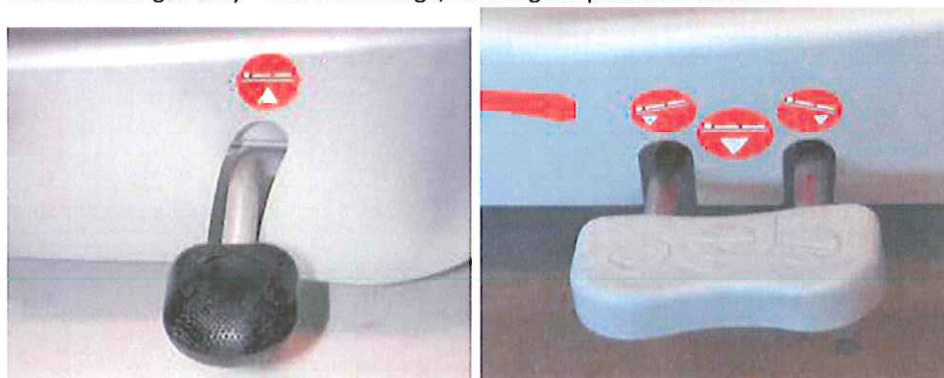

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

111. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta z materacem pianowym jednowarstwowym spełniające pozostałe wymogi SWZ?

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

112. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta wyposażony w wieszak na kroplówki z możliwością montażu na stelażu za pomocą mechanizmu samozatraskowego, spełniający pozostałe wymogi SWZ?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

113. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

114. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (51 szt.), którego konstrukcja oparta jest na pantografie, co jest rozwiązaniem niemalże tożsamym z oczekiwanym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

115. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy w związku z pkt. 4 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (51 szt.) z diodą informującą o podłączeniu do sieci lub stanie naładowania akumulatora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

116. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą łóżka (51 szt.) o wymiarach 143 x 70 cm, co zapewnia maksymalną stabilność łóżka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

117. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (51 szt.) ze szczytami bez możliwości blokady? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

118. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (51 szt.) o szerokości leża 870 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

119. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (51 szt.) bez diodowej informacji o trybie pilota?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

120. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (51 szt.) bez graficznej informacji na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR, która to informacja może myląca dla użytkownika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

121. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (51 szt.) z autoregresją w części lędźwiowej (autoregresja tylko oparcia pleców) w zakresie min. 9 cm, która nie ma wpływu na profilaktykę przeciwoleżynową? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

122. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (51 szt.) bez zaawansowanej autoregresji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

123. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) o konstrukcji opartej na pantografie, co zapewnia więcej punktów podparcia niż łóżko na trzech kolumnach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

124. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) z leżem wypełnionym płytami odejmowanymi z polipropylenu oprócz segmentem pleców wypełnionym płytą nieodejmowaną wykonaną z hpl (jeden segment to jedna płyta)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

125. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) ze szczytami poruszającymi się wraz z leżem zarówno od strony głowy, jak i nóg?

Odpowiedź Zamawiającego:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

126. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) ze szczytami blokowanymi za pośrednictwem dwóch przesuwnych suwaków każdy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

127. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) z barierkami poruszającymi się wraz z segmentem pleców oraz barierkami nie poruszającymi się wraz z segmentami nożnymi? Bariereki zabezpieczają pacjenta na całej długości łóżka to jest od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta oraz w pozycji siedzącej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

128. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy w związku z pkt. 14 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi, z wyświetlaczem LCD (zewnętrzne panele sterownicze) wskazującymi osiągnięcie przez segment oparcia pleców kąta 15°, 30°, 45°, 60° oraz przechyłów wzdłużnych 6° i 12°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

129. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy w związku z pkt. 31 i 15 Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) z przyciskiem aktywującym sterowanie umieszczonym na panelu centralnym montowanym od strony nóg, a nie na panelu wbudowanym w barierki boczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

130. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 350-910 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

131. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) z autoregresją wynoszącą 10 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

132. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) z funkcją anty-Trendelburga wynoszącą 15° i Trendelburga 14°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

133. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) bez sterowań nożnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

134. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) o informacji o konieczności wymiany akumulatora dostępnym na wyświetlaczu LCD w panelu do sterowania umieszczonym w barierce bocznej od strony zewnętrznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

135. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) bez jednego przycisku odłączającego natychmiast wszystkie funkcje elektryczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

136. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) bez systemu elektrycznego wyposażonego w pamięć ostatnich 500 funkcji, przeciążeń oraz błędów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

137. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z mechaniczną funkcją przedłużenia leża o 28 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

138. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) o szerokości całkowitej 103,8 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

139. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z leżem opartym na systemie zbliżonym do pantografu, co zapewnia większą stabilność niż łóżka kolumnowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

140. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) ze szczytami blokowanymi za pośrednictwem dwóch przesuwanych suwaków każdy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

141. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) bez alarmu niewłaściwego umieszczenia lub wysunięcia półki na kasetę RTG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

142. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z barierkami bocznymi o wysokości 40 cm ponad leże, spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź Zamawiającego:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

143. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z panelem centralnym intuicyjnym w obsłudze, przezrystym, nie posiadającym dwóch pól w różnych kolorach, co jest elementem w żaden sposób nie poprawiającym walorów użytkowych łóżka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

144. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) ze sterownikiem nożnym po jednej stronie łóżka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

145. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z pilotem bez latarki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

146. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 45-84 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

147. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy w związku z pkt. 20 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (8 szt. i 11 szt.) z barierkami bocznymi, z wyświetlaczem LCD (zewnątrzne panele sterownicze) wskazującymi osiągnięcie przez segment oparcia pleców kąta 15°, 30°, 45°, 60° oraz przechyłów wzdłużnych 6° i 12°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

148. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 18°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

149. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy w związku z pkt. 24 i 26 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z metalową osłoną sterowania nożnego, zamiast przycisku świadomego uruchomienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

150. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z przyciskiem świadomego użycia dostępnym tylko na panelu centralnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

151. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) bez jednego przycisku odłączającego wszystkie funkcje elektryczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

152. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy w związku z pkt. 31 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z parametrem 120 sekund?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

153. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) bez automatycznego podnoszenia się 5 koła?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

154. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy w związku z pkt. 37 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) o bezpiecznym obciążeniu 260 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

155. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) z wskaźnikiem konieczności wymiany akumulatora dostępnym na wyświetlaczu LCD w panelu sterowania wbudowanym w barierki boczne od strony zewnętrznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

156. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) z mechaniczną funkcją przedłużenia leża o 28 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

157. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) o szerokości całkowitej 103,8 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

158. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) z leżem opartym na systemie zbliżonym do pantografu, co zapewnia większą stabilność niż łóżka kolumnowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

159. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) z segmentem oparcia pleców wypełnionym płytą z hpl oraz pozostałymi segmentami leża wypełnionymi płytami z polipropylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

160. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) ze szczytami blokowanymi za pośrednictwem dwóch przesuwanych suwaków każdy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

161. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) z barierkami bocznymi o wysokości 40 cm ponad leże, spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

162. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) bez alarmu niewłaściwego umieszczenia lub wysunięcia półki na kasetę RTG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

163. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) ze sterownikiem nożnym po jednej stronie łóżka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

164. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) z wyświetlaczem LCD czarnobiałym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

165. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 45-84 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

166. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy w związku z pkt 21 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) z pilotem do obsługi systemu ważenia za pośrednictwem odrębnego pilota z wyświetlaczem LCD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

167. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) bez alarmu informującego o przemieszczaniu się pacjenta w stronę krawędzi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem

168. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 18°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

169. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) ze sterowaniem nożnym regulacji wysokości leża i przechyłów bocznych, bez pozycji egzaminacyjnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

170. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy w związku z pkt. 29 i 31 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) z metalową osłoną sterowania nożnego, zamiast przycisku świadomego uruchomienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

171. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) z przyciskiem świadomego użycia dostępnym tylko na panelu centralnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

172. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) bez jednego przycisku odłączającego wszystkie funkcje elektryczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

173. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy w związku z pkt. 36 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) z parametrem 120 sekund?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

174. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) bez automatycznego podnoszenia się 5 koła?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

175. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy w związku z pkt. 42 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) o bezpiecznym obciążeniu 260 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

176. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (11 szt.) bez ładowarki USB?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

177. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwdleżynowy, w którym komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga - system 1:2, ze statyczną sekcją głowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

178. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłężynowy o wysokości 11cm kładziony na spodni materac szpitalny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

179. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy w zakresie p. 9 opisu Zamawiający dopuści materac dostosowujący się kształtem do pozycji łóżka, posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

180. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłężynowy bez odcinkowego usuwania komór?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

181. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłężynowy z pompą: ze sterowaniem za pomocą przycisków membranowych oraz pokrętelem regulacji ciśnienia, z regulacją ciśnienia bezstopniową w zależności od wagi i pozycji pacjenta, z automatyczną blokadą przycisków membranowych uruchamiającą się po 30 sekundach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

182. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

183. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada blat główny oraz składany blat boczny wykonany z płyty HPL; boki i tył szafki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV, blaty oraz fronty szuflad wykonane są z płyty HPL o grubości 6mm.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

184. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę która posiada ustawienie prawo/lewo stronne z wysuwaniem tylko od frontu szafki dwóch szuflad - proponowane rozwiązanie jest lepsze od opisanego ponieważ zapobiega wypychaniu tylnych drzwiczek w sytuacji przepelnienia szafek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

185. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blokadą kółek indywidualną znajdującą się bezpośrednio przy kółkach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

186. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z kółkami o średnicy 50 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

187. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy w związku z pkt. 7 i 8 Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez możliwości pochylenia blatu na boki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

188. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości (wraz ze złożonym blatem bocznym) 555 mm?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

189. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

190. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne wózek o poniższych parametrach:

- konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych.

- szerokość całkowita: 870 mm

- długość całkowita: 2185 mm

- materac o wymiarach 2000x700mm

- wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 470 - 790 mm, regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka.

- pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 0 – 12 stopni – regulacja płynna

- pozycja anti-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0 – 12 stopni – regulacja płynna

- dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezłowia i nóg.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

- leże dwusegmentowe, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG
- pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia
- pod leżem listwy aluminiowe o długości 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka).
- wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej.
- szczyty wózka chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z możliwością blokady podczas transportu. Na szczycie wózka od strony nóg dodatkowe demontowalne chromowane uchwyty do przetaczania.
- ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° - regulacja płynna
- wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym 4 dwuosiove
- barierki boczne o długości 1490 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości 350 mm powyżej leża.
- barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listwę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52
- barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym.
- możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża
- wyposażenie wózka:
wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki,
materac składający się:
 - pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim,
 - grubość materaca 10 cm.
- wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie
- podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. - osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji.
- dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole. Koła o średnicy 150mm
- bezpieczne obciążenie robocze wózka 200 kg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie spełniające wymagania opisane w SWZ. Zamawiający nie może wprowadzić odrębnej oceny całego produktu Państwa firmy. W razie wątpliwości, Zamawiający prosi o przedstawienie sprecyzowanego pytania odnoszącego się do konkretnych parametrów.

191. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 5 - STÓŁY OPERACYJNE

dotyczy punktu 26 - STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

Prosimy o wyjaśnienie ile dokładnie segmentów nóg należy zaoferować dla stołów ogólnochirurgicznych z wyposażeniem -5 szt.

W punkcie 26 Zamawiający podał między innymi :

„- segment nożny dzielony wzdłużnie – rozchylany na boki – min. 180° - 3 pary

- segment nożny dzielony na cztery części – 1 para

umożliwiający pozycję kolankowo łokciową i odwodzenie części udowych podnóżka w zakresie co

najmniej 45° dla każdej z części. Regulacja góra/dół części goleniowych - 1 para „

Z powyższego wynika, że w sumie do 5 szt. stołów. Zamawiający wymaga tylko 4 segmentów podnóżków. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy nie należy zaoferować jak poniżej aby każdy stół był wyposażony w segment podnóżków ? :

segment nożny dzielony wzdłużnie – rozchylany na boki – min. 180° - 4 pary

- segment nożny dzielony na cztery części – 1 para

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaoferowania wyposażenia zgodnego z ilością stołów, tj.:

- segment nożny dzielony wzdłużnie - rozchylany na boki - min. 180 st - 4 pary,

- segment nożny dzielony na cztery części - 1 para

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



192. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 5 - STÓŁY OPERACYJNE

dotyczy punktu 39 - STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

W związku z tym iż Zamawiający wymaga 2 typów podnożków prosimy o doprecyzowanie punktu 39 i dopuszczenie zakresów regulacji jak poniżej :

Regulacja płyty nóg z pilota w zakresie min. : 90° do +80 °oraz regulacja płyty nóg oddzielna dla lewej i prawej kończyny w zakresie min. od -90° do 0°. Dopuszcza się za pomocą sprężyny gazowej – **Dla segmentu nożnego dzielonego wzdłużnie – rozchylanego na boki min 180° - 3 lub 4 pary**

Regulacja płyty nóg z pilota w zakresie min. : 90° do +80° umożliwiające pozycję kolankowo łokciową i odwodzenie części udowych podnożka w zakresie co najmniej 45° dla każdej z części. Regulacja góra/dół części goleniowych - **Dla segment nożny dzielony na cztery części – 1 para**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

193. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 5 - STÓŁY OPERACYJNE

dotyczy punktu 21 - 2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie: Podglówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą blokady mechanicznej, której intencjonalne zwolnienie przez użytkownika pozwala ustawić żądane pochylenie podglówka a puszczenie blokady automatycznie blokuje jakiegokolwiek ruchy. Brak konieczności stosowania dodatkowych śrub zabezpieczających czy też stosowania oddzielnych dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny.

• Zakres regulacji podglówka: +84/-60°

Opisane rozwiązanie jest najnowszym rozwiązaniem technologicznym i jest znacznie wygodniejsze i prostsze w użyciu niż opisane przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

194. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 5 - STÓŁY OPERACYJNE

dotyczy Zadanie nr 5 STÓŁY OPERACYJNE projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy wyposażenia o 30 dni ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

195. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STÓŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego, mobilnego, na podstawie jezdnej z 4 podwójnymi obrotowymi kołami umożliwiającymi jazdę w obrębie bloku operacyjnego bez dodatkowych napędów elektrycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

196. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STÓŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z możliwością doposażenia w przyszłości stołu o karbonowy blat wraz z dedykowaną przezierną nakładką do operacji kręgosłupa, nie występujący na obecnym etapie wyposażenia stołu. Dedykowana przezierna nakładka do operacji kręgosłupa o nośności 227 kg, mocowana do stołu. Jest to rozwiązanie równoważne od oferowanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



197. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z regulacją za pomocą pilota wszystkich wymienionych przez Zamawiającego ruchów stołu wraz z pozycją tzw. krzeselkową za pomocą wywołania funkcji w menu pilota i przytrzymaniu jednego przycisku. Oferowany stół posiada pilot wyposażony w dodatkowo pozycję flex i reflex sterowane dedykowanymi przyciskami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

198. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażanego w szyny sprzętowe wykonane ze stali nierdzewnej wzdłuż wszystkich elementów blatu, po obu stronach stołu wraz z podglówkiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

199. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażanego w segment nożny dzielony wzdłużnie, rozchylany na boki do 120° – 3 pary. Pozostałe segmenty zgodnie z wymogiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i doprecyzowuje informacje o ilości:

- segment nożny dzielony wzdłużnie, rozchylany na boki do 120° - 4 pary.

200. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego w którym masa pacjenta pozwalająca na użycie stołu w pozycji odwróconej blatu tzw. REVERS, umożliwiającej jednoczesne użycie funkcji przesuwu wzdłużnego w pełnym zakresie może być równa 230 kg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

201. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z pozycją re-Flex 110° co jest zakresem większym od wymaganego. Stół umożliwia uzyskanie pozycji re-Flex na poziomie 140°.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

202. Zapytanie Wykonawcy:


ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 40

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego z regulacją w zakresie: +60° / -60° za pomocą wspomaganie mechanicznego lub za pomocą sprężyny gazowej. Podglówek z tzw. podwójną

znak: D25C/251/N/23-60rj/21





artykulacją ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie pacjenta w ułożeniach bocznych oraz ułatwiający intubację.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

203. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 59

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w jeden rozmiar poszerzenia blatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

204. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 62 i 99

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w podporę pod rękę do ułożenia ręki pacjenta w pozycji bocznej wyposażona w wysięgnik z przegubem kulowym blokowanym jednym pokrętkiem – długość 540 mm - 2 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

205. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 76

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w zestaw do zabiegu TUR z sitem z odpływem w komplecie z ramką i mocowaniem do szyny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

206. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 91 i 103

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w buty uniwersalne do przystawki ortopedycznej, nie plastikowe, z pasami mocującymi umożliwiającymi adaptację dla pacjentów dorosłych i dzieci.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

207. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 98

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w nakładkę na wałek w celu jego pogrubienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

208. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 106

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w żelowy podkład pod nogi o wymiarach 300x200x15 mm – 1 para.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

209. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 107

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w podpory podudzia z butami ze wspomaganie sprężyną gazową uniwersalne pozwalające na ułożenie dzieci i dorosłych o udźwigu 159 kg. wraz z zaciskami - 1 para.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

210. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 108

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w stolik do operacji pediatrycznych długość 800 mm, szerokość 350 mm - 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

211. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 110

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w półwałek pod kolana o wym. 500x150x70 mm - 4 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

212. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 115

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w pozycjoner żelowy, półwałek pod kolano o wym. 500x150x70 mm - 2 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

213. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 120 i 135

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w wózek na akcesoria stołów z koszem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

214. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 121 i 122

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z akcesorii wymienionych w tych punktach z uwagi na fakt, iż takie rozwiązanie oferuje jedynie jeden producent stołów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu spełnienia w obydwu punktach SWZ.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

215. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

dot. pkt. 127

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w mankiet na rękę w ułożeniu na wznak, montowany stabilnie do szyny, w zamian za osłonę wykonaną z plexi lub innego tworzywa sztucznego wsuwaną pod materac – 2 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

216. Zapytanie Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 3 i 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego, mobilnego, na podstawie jezdnej z 4 podwójnymi obrotowymi kołami umożliwiającymi jazdę w obrębie bloku operacyjnego bez dodatkowych napędów elektrycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

217. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 7

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający opisał rozwiązanie proponowane przez tylko i wyłącznie jednego producenta prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego z blatem umożliwiającym zamocowania różnego wyposażenia i akcesoriów w zależności od wykonywanych zabiegów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

218. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego którego panel na kolumnie posiada wszystkie wymagane funkcje z wyjątkiem pozycji „0” którą można uzyskać poprzez kolejne użycie dostępnych przycisków sterujących.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

219. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z funkcjami regulowanymi pilotem przewodowym:

- najniższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca chirurgom na wykonywanie operacji w wygodnej pozycji siedzącej (wysokość mierzona bez materacy): 700 mm
- najwyższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca chirurgom na wykonywanie operacji w wygodnej pozycji stojącej (wysokość mierzona bez materacy): 1200 mm
- regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie +/-46°
- regulacja przechyłów bocznych w zakresie większym niż +/-36°
- regulacja płyty plecowej w zakresie: co najmniej +90°/-45°
- regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie: +80°/-100°; możliwość regulowania pozycji podnóżków łącznie lub każdego z osobna.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



- pozycja „0” uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.
- pozycja flex/reflex
- pozycja „beach-chair” za pomocą jednego przycisku wywołanego z menu
- możliwość uzyskania pozycja normalnej/odwróconej
- blokowanie i odblokowanie stołu do/od podłoża
- możliwość zapamiętania 9 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika
- regulacja przesuwu blatu w zakresie 480 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

220. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego z regulacją w zakresie: +60° / -60° za pomocą wspomaganie mechanicznego lub za pomocą sprężyny gazowej. Podgłówek z tzw. podwójną artykulacją ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie pacjenta w ułożeniach bocznych oraz ułatwiający intubację.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

221. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z poszczególnymi segmentami blatu łączonymi za pomocą systemu hakowego, bez dodatkowych manipulacji, gdzie jedno kliknięcie po osadzeniu stanowi bezpieczne połączenie elementów. Rozwiązanie proponowane jest wygodniejsze od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

222. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego w którym masa pacjenta pozwalająca na użycie stołu w pozycji odwróconej blatu tzw. REVERS, umożliwiającej jednoczesne użycie funkcji przesuwu wzdłużnego w pełnym zakresie może być równa 230 kg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

223. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 34 i 35

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z akcesorii wymienionych w tych punktach z uwagi na fakt, iż takie rozwiązanie oferuje jedynie jeden producent stołów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu spełnienia w obydwu punktach SWZ.


224. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego z przystawką ortopedyczną karbonowego składającego się z dwóch belek wyciągowych wykonane z włókna węglowego, obie belki z

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



możliwością odwodzenia na boki za pomocą przegubu zębatego z blokadą gwarantującą zablokowanie belki w dowolnej pozycji – regulacja odwodzenia na boki odbywa się z minimalnym i niezauważalnym skokiem. Belki wyciągowe mocowane pod blatem stołu – metalowe elementy mocujące belki umieszczone poza obszarem badania ramienia „C” (od dolnej części jamy brzusznej do stóp pacjenta obszar wolny od elementów metalowych czy innych nieprzeziernych)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

225. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego z przystawkę ortopedyczną umożliwiającą regulację wysokości indywidualnie obu stóp pacjenta (nie tylko jednej) przy zachowaniu stałej wysokości belek co jest bezpieczniejszy w momencie monitorowania kończyny ramieniem „C”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

226. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 43

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w przystawkę karbonowa o ładowności 135 kg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

227. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 46

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w podporę pod rękę do ułożenia ręki pacjenta w pozycji bocznej wyposażona w wysięgnik z przegubem kulowym blokowanym jednym pokrętle – długość 540 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

228. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 63

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający opisał rozwiązanie proponowane przez tylko i wyłącznie jednego producenta prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego zestaw do gwoździowania puszczeli wraz ze śrubą wyciągową oraz belką teleskopową. Belka teleskopowa wyposażona w płaski przegub umożliwiający zgięcie kończyny dolnej w kolanie. Urządzenie z możliwością instalacji w zestawie wyciągowym ortopedycznym na belkach metalowych 1 kpl.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

229. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 68

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w płytę plecową do operacji barku wykonana z tworzywa przeziernego i stali – płyta z odejmowanymi segmentami barkowymi umożliwiającymi dostęp do operowanego barku. W zestawie z płytą adapter do mocowania podgłówka specjalistycznego

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

wyposażony w przegub kulowy, podglówek specjalistyczny typu hełm, pas asymetryczny do mocowania pacjenta, zapory boczne płyty barkowej – 1 kpl.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

230. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 71 i 72

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający opisał rozwiązanie proponowane przez tylko i wyłącznie jednego producenta prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego zestaw do operacji ramienia oraz zestaw do operacji przedramienia jak rozwiązania równoważne do opisanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

231. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 73

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w wózek na akcesoria stołu z koszem i trzema szynami akcesoryjnymi do wieszania wyposażenia – 2 kpl.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

232. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 74, 75, 76 i 77

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający opisał rozwiązanie proponowane przez tylko i wyłącznie jednego producenta prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego zestaw do operacji kręgosłupa składający się z płyty karbonowej montowanej jako element blatu, nakładki na blat przeźniewiającej ręczną, bardzo precyzyjną regulację wypiętrzenia kręgosłupa, podglówek z lustrem umożliwiającą podłączenie przewodów anestetycznych oraz obserwację znieczulanego pacjenta, dodatkowo specjalistyczny materac do operacji kręgosłupa o wymiarach 520X350X110mm, wózek do przechowywania i transportu nakładki do operacji kręgosłupa – 1 kpl.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

233. Zapytanie Wykonawcy:

2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt.

dot. pkt. 86 i 87

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z akcesorii wymienionych w tych punktach z uwagi na fakt, iż takie rozwiązanie oferuje jedynie jeden producent stołów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu spełnienia w obydwu punktach SWZ.

234. Zapytanie Wykonawcy:

dot. umowy § 8 ust. 9

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu na 48 godzin .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

235. Zapytanie Wykonawcy:

dot. umowy § 8 ust. 10

Prosimy o wydłużenie czasu naprawy do 7 dni robocze, po którym Wykonawca musi dostarczyć sprzęt zastępczy .Jak napisany w punkcie ust. 8-9.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

236. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada leże dwusegmnetowe całkowicie przezerne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża i możliwością włożenia kasety RTG tylko od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

237. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który nie jest wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

238. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada możliwość mocowania pasów do unieruchamiania pacjenta tylko w segmencie oparcia pleców?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

239. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

240. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada hydrauliczną regulację wysokości leża w zakresie 560 – 890 mm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

241. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada szerokość leża wynoszącą 725 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

242. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, , który posiada regulację kąta pochylenia segmentu plecowego za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0° – 70°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

243. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada centralny system blokowania kół umieszczony w czterech narożach ramy leża – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec?

Odpowiedź Zamawiającego:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

244. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada centralny system blokowania kół umieszczony w czterech narożach ramy leża – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

245. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada całkowitą długość wózka wynoszącą 2100 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

246. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada szerokość całkowitą wózka z opuszczonymi poręczami bocznymi wynoszącymi 800 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

247. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada szerokość całkowitą wózka z podniesionymi barierkami wynoszącymi 860 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

248. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada regulację pozycji Trendelenburga w zakresie 15° regulowane hydraulicznie za pomocą pedałów nożnych umieszczonych od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

249. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada regulację pozycji anty – Trendelenburga w zakresie 15° regulowane hydraulicznie za pomocą pedałów nożnych umieszczonych od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

250. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada dźwignię do regulacji pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga oraz dźwignię regulacji wysokości leża dostępną od strony nóg pacjenta, regulacje odbywają się płynnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

251. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, które posiada maksymalne dopuszczalne obciążenie wózka wynoszące 220 kg?

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

252. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada lakierowane składane barierki boczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

253. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada podstawę wózka obudowaną wypraskami z tworzywa posiadająca miejsce na butlę z tlenem, natomiast kosz na podręczne rzeczy pacjenta znajduje się pod leżem od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

254. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada materac piankowy 1 warstwowy obszty skajem medycznym, nieprzemakalnym o grubości 6 cm, materac mocowany na kołkach w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie, wymiary materaca dostosowane do wymiarów leża wózka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

255. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada nie zintegrowany na stałe z wózkiem z możliwością składania do poziomu wzdłuż lub w szereg leża chromowany wieszak kroplówki z regulacją wysokości, wyjmowany, posiadający 4 haczyki chromowane, maksymalne obciążenie 2 kg na jeden haczyk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

256. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który nie posiada uchwytów lub wieszaka do worków urologicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

257. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 3 – Wózek do transportu pacjenta – 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta, który posiada uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy i nóg pacjenta nie składane poniżej poziomu materaca, uchwyt od strony głowy wyjmowany, natomiast uchwyt od strony nóg pacjenta zamontowany na stałe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

258. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który nie ma możliwości zastosowania manetki sterującej pozwalającej na manewrowanie stołem podczas jazdy jedną ręką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

259. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który posiada 4 koła o średnicy 150 mm, pozwalające na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta, koła nie schowane w obrysie podstawy, wystające poza podstawę, koła obracające się o 360°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

260. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który posiada możliwość uzyskania wychylenia blatu poza kolumnę stołu na długości 1405 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

261. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który posiada obudowę kolumny wykonaną ze stali nierdzewnej; kolumna posiada dodatkowo częściowe osłony z gumy w celu zapewnienia wysokich parametrów regulacji przechyłów blatu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

262. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który posiada podstawę w całości wykonaną ze stali nierdzewnej zapewniającą dobry dostęp chirurga do blatu stołu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

263. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, w którym koła są centralnie blokowane i odblokowywane są za pomocą pilota przewodowego, jak również za pomocą panelu bocznego; stół gwarantujący stabilność w każdej pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

264. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który nie posiada sygnalizacji blokady stołu przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

265. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który posiada pilot przewodowy z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji, wyposażony w wyświetlacz LCD, pilot aktywny po naciśnięciu przycisku „ON”; stół automatycznie przechodzi w stan uśpienia („stand by”) po upływie kilkunastu sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku, w celu ponownego uaktywnienia stołu należy nacisnąć przycisk „ON”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

266. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Czy jeżeli Zamawiający dopuści w pkt. 18 pilot przewodowy, to czy zrezygnuje z wymogu dołączenia do stołu pilota bezprzewodowego łącznie z ładowarką do tegoż pilota?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

267. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który nie posiada możliwości sterowania poprzez przełącznik nożny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

268. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który posiada regulację pozycji tzw. krzeselkowej za pomocą sekwencji ruchów na pilocie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

269. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który posiada w segmencie podgłówek szyny instrumentalne z dwóch stron (tylko po bokach)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

270. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który nie posiada możliwości zapamiętywania i łatwego wywołania pozycji stołu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

271. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który posiada następującą konfigurację blatu stołu: podgłówek płytowy na całą szerokość blatu; oparcie pleców dwuczęściowe – obie części oparcia posiadają możliwość niezależnego ruchu kąтового poniżej i powyżej poziomu (możliwość uzyskania wypiętrzenia lub wklęsnięcia klatki piersiowej), regulacja obu części poprzez napęd elektrohydrauliczny; płyta lędźwiowa oraz podnóżki: lewy i prawy, podnóżki z dodatkowym podziałem w okolicy kolana; podnóżki rozchylane na boki w zakresie 180°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

272. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który posiada szerokość stołu z szynami wynoszącą 630 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


273. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który posiada regulację płyty nóg z pilota oraz regulację płyty nóg oddzielną dla lewej i prawej kończyny w zakresie -90° do +35°?

Odpowiedź Zamawiającego:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

274. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który posiada regulację podglówka w zakresie +45° / -30° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, podglówek bez tzw. podwójnej artykulacji ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie pacjenta w ułożeniach bocznych oraz ułatwiający intubację?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

275. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w dodatkowy panel sterowania awaryjnego umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego, w celu bezpieczeństwa panel posiada dwustopniową aktywację, najpierw wciśnięcie przycisku „ON” na panelu łączy stół następnie kiedy panel jest aktywny możemy wybrać funkcję stołu; panel dezaktywujący się automatycznie po upływie kilku sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku na panelu, następnie stół przechodzi w stan uspienia („stand by”), w celu ponownego uaktywnienia stołu należy nacisnąć przycisk „ON”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

276. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w podpórkę ręki z poduszką z pianki, antystatyczną, o długości 500 mm, z pasem do mocowania ręki i klamrą mocującą ze stali nierdzewnej, której za pomocą sprężyny gazowej możliwe są regulacje: kątowna, góra/ dół oraz wokół osi pionowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

277. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy w punktach nr 47, 48, 49, 50, 51 tabelki Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w oparcie boczne z dźwignią służące do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej, składającego się z materaca o wymiarach 40x100x200 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta, blokowanej za pomocą klamki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

278. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w dwa pasy o długości 1500 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

279. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w podpórkę ręki z poduszką z pianki, antystatyczną, o długości 500 mm, z pasem do mocowania ręki i klamrą mocującą ze stali nierdzewnej, której za pomocą sprężyny gazowej możliwe są regulacje: kątowna, góra/ dół oraz wokół osi pionowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

280. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w podporę pod rękę do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej wyposażoną w wysięgnik z trzema przegubami kulowymi blokowanymi jednym pokrętle o długości 500 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

281. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy w punktach 65, 66, 67, 68, 69 tabelki Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w oparcie boczne z dźwignią służące do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej, składającego się z materaca o wymiarach 40x100x200 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta, blokowanej za pomocą klamki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

282. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który nie posiada zestawu do zabiegu TUR z sitem z odpływem w komplecie z wózkiem i wiadrem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

283. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w podpórkę ręki z poduszką z pianki, antystatyczną, o długości 500 mm, z pasem do mocowania ręki i klamrą mocującą ze stali nierdzewnej, której za pomocą sprężyny gazowej możliwe są regulacje: kątowna, góra/ dół oraz wokół osi pionowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

284. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy w punktach 83, 84, 85 tabelki Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w oparcie boczne z dźwignią służące do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej, składającego się z materaca o wymiarach 40x100x200 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta, blokowanej za pomocą klamki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

285. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w buty uniwersalne skórzane z pasami mocującymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

286. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który nie jest wyposażony w uchwyt do drutów Kirchnera?

Odpowiedź Zamawiającego:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

287. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w przystawkę do artroskopii kolana mocowaną do szyny bocznej stołu, z regulacją kąta i wysokości przy listwie bocznej, z płynną regulacją rozstawu wraz z elementami dotykającymi ciała pacjenta wykonanymi z poliuretanu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

288. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który nie wyposażony jest w słupek do kości udowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

289. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który nie wyposażony jest w dodatkowy wałek gruby do słupka kości udowej o średnicy 180 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

290. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w podporę pod rękę do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej wyposażoną w wysięgnik z trzema przegubami kulowymi blokowanymi jednym pokrętle o długości 500 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

291. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w półwałek pod kolana o wymiarach 400x140x110 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

292. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w pozycjoner uniwersalny żelowy o wymiarach 245x80x50 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

293. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w pozycjoner żelowy uniwersalny o wymiarach 350x150x75 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

294. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który posiada wózek na akcesoria stołu wyposażony w jeden kosz?

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

295. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który nie posiada manetki sterującej funkcją jazdy stołem montowanej do szyny akcesoryjnej stołu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

296. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który nie posiada ładowarki do manetki sterującej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

297. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w podpórkę ręki z poduszką z pianki, antystatyczną, o długości 500 mm, z pasem do mocowania ręki i klamrą mocującą ze stali nierdzewnej, której za pomocą sprężyny gazowej możliwe są regulacje: kątowa, góra/ dół oraz wokół osi pionowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

298. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który nie jest wyposażony w osłonę ręki w ułożeniu na wznak wsuwaną pod materac, wykonanej z plexi lub innego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

299. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który wyposażony jest w uchwyt nadgarstka z taśmą mocowany do szyny akcesoryjnej stołu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

300. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem – 5 sztuk (poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem, który posiada wózek na akcesoria stołu wyposażony w jeden kosz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

301. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie ma możliwości zastosowania manetki sterującej pozwalającej na manewrowanie stołem podczas jazdy jedną ręką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

302. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie posiada systemu wymiennych blatów – możliwość zamocowania różnych blatów w zależności od wykonywanych zabiegów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

303. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada obudowę kolumny wykonaną ze stali nierdzewnej; kolumna posiada dodatkowo częściowe osłony z gumy w celu zapewnienia wysokich parametrów regulacji przechyłów blatu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

304. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada podstawę w całości wykonaną ze stali nierdzewnej zapewniającą dobry dostęp chirurga do blatu stołu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

305. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada 4 koła z centralną blokadą o średnicy 150 mm, pozwalające na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta, koła nie schowane w obrysie podstawy, wystające poza podstawę, koła obracające się o 360°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

306. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada centralną blokadę kół, stół w pozycji roboczej gwarantujący stabilność tj. w trakcie zabiegu koła w podstawie zablokowane za pomocą pilota przewodowego, jak również za pomocą panelu bocznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

307. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie posiada sygnalizacji blokady stołu przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

308. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie posiada możliwości sterowania poprzez przełącznik nożny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

309. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który wyposażony jest w dodatkowy panel sterowania awaryjnego umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego, w celu bezpieczeństwa panel posiada dwustopniową aktywację, najpierw wciśnięcie przycisku „ON” na panelu łączy stół następnie kiedy panel jest aktywny możemy wybrać funkcję stołu; panel dezaktywujący się automatycznie po upływie kilku sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku na panelu, następnie stół przechodzi w stan uśpienia („stand by”), w celu ponownego uaktywnienia stołu należy nacisnąć przycisk „ON”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

310. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada najwyższą wysokość ustawienia blatu pozwalająca chirurgom na wykonywanie operacji w wygodnej pozycji stojącej (wysokość mierzona bez materaca) wynoszącą 1050 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

311. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada regulację przechyłów bocznych w zakresie +/- 30°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

312. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada regulację płyty plecowej w zakresie +80°/-40°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

313. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, posiada regulację pozycji tzw. krzeselkowej za pomocą sekwencji ruchów na pilocie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

314. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie posiada funkcji elektrycznej jazdy stołem przód – tył?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

315. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie posiada możliwości zapamiętywania pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

316. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada podglówek regulowany w dwóch płaszczyznach w zakresie $+50^{\circ}/-50^{\circ}$?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

317. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada długość stołu wynoszącą 2335 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

318. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada szerokość siedziska z szynami bocznymi wynoszącą 630 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

319. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada szerokość segmentu siedziska bez szyn bocznych wynoszącą 570 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

320. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, w którym segment podglówka oraz podnóżki montowane są poprzez ergonomiczne szybkozłączki oparte na połączeniach klinowych? Montowanie odbywa się przez wsunięcie sekcji (od góry) bez dodatkowych akcji np. wciskanie przycisków.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21





Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

321. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który wyposażony jest w przystawkę ortopedyczną w której płyta siedzeniowa wykonana jest z płyty HPL, natomiast belki wyciągowe wykonane są z włókna węglowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

322. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie posiada blatu ortopedycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

323. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie posiada dedykowanych podnóżków z funkcją regulacji za pomocą pilota?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

324. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada przystawkę ortopedyczną z dwoma belkami wyciągowymi o długości 1250 mm, z możliwością odwodzenia na boki za pomocą przegubu zębatego z blokadą gwarantującą zablokowanie belki w dowolnej pozycji, która odbywa się skokowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

325. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, w którym dodatkowa belka posiada możliwość regulacji wysokości wraz ze stołem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

326. Zapytanie Wykonawcy:


do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, w którym jedna z belek wyciągowych karbonowych posiada możliwość regulacji wysokości wraz ze stołem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

znak: D25C/251/N/23-60rj/21





327. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który wyposażony jest w podpórkę ręki z poduszką z pianki, antystatyczną, o długości 500 mm, z pasem do mocowania ręki i klamrą mocującą ze stali nierdzewnej, której za pomocą sprężyny gazowej możliwe są regulacje: kątowa, góra/ dół oraz wokół osi pionowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

328. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy w punktach 51, 52, 53, 54, 55 tabelki Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który wyposażony jest w oparcie boczne z dźwignią służące do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej, składającego się z materaca o wymiarach 40x100x200 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta, blokowanej za pomocą klamki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

329. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który wyposażony jest w przystawkę do artroskopii kolana mocowaną do szyny bocznej stołu, z regulacją kąta i wysokości przy listwie bocznej, z płynną regulacją rozstawu wraz z elementami dotykającymi ciała pacjenta wykonanymi z poliuretanu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

330. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który wyposażony jest w buty wyciągowe z pasami mocującymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

331. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który wyposażony jest w poduszkę kołka zaporowego o średnicy 80 mm; wysokości 225 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

332. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który wyposażony jest w przystawkę do operacji stawu barkowego montowaną na kliny, z regulacją kąta z poziomu pilota, materace piankowe, szyte i klejone o grubości 80 mm w komplecie z podgłówkiem, umożliwiającej swobodny dostęp do stawu barkowego w dostępie tylnym oraz

znak: D25C/251/N/23-60rj/21



bocznym, dzięki zdejmowanym segmentom umożliwia operację obu stawów, wyposażona w listwy akcesoryjne na podporę boczną i uchwyt ręki po stronie operowanej oraz na podpórkę ręki po stronie nieoperowanej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

333. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie jest wyposażony w płytę do operacji kończyny górnej przy ułożeniu na brzuchu wraz z uchwytem mocującym do szyny bocznej stołu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

334. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który wyposażony jest w podporę pod rękę do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej wyposażoną w wysięgnik z trzema przegubami kulowymi blokowanymi jednym pokrętelem o długości 500 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

335. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie jest wyposażony w podporę ręki do operacji barku wraz z adapterem do mocowania do ramienia mechanicznego przegubowego wraz ze sterylnym obłożeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

336. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada wózek na akcesoria stołu wyposażony w jeden kosz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

337. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który posiada płytę/ blat karbonowy do operacji kręgosłupa długości 1100 mm, umożliwiający prześwietlenie, bez wózka do transportu blatu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

338. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie jest wyposażony w podglówek przezierny z włókna węglowego regulowanego do płyty/ blatu karbonowego do operacji kręgosłupa?

Odpowiedź Zamawiającego:

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nn pismem.

339. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który wyposażony jest w poduszkę do operacji kręgosłupa jednoczęściową o wymiarach 100x460x840 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

340. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który wyposażony jest w pozycjoner uniwersalny żelowy o wymiarach 245x80x50 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

341. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który wyposażony jest w pozycjoner żelowy uniwersalny o wymiarach 350x150x75 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

342. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie posiada manetki sterującej funkcją jazdy stołem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

343. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie posiada ładowarki do manetki sterującej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

344. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie wyposażony jest w pilota bezprzewodowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

345. Zapytanie Wykonawcy:

do załącznika nr 8, zadanie nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego – 1 sztuka (poz. 2):

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny z blatem węglowym i przystawka ortopedyczną z włókna węglowego, który nie wyposażony jest w ładowarkę do pilota bezprzewodowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

II. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ uwzględniający wszystkie ww zmiany - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie..

III. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w nn postępowaniu, poprzez zmianę zapisów rozdz. VII pkt 1 ppkt 1)c), który otrzymuje brzmienie:

„c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054).”

IV. Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

W konsekwencji zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie:

Było:

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni to jest do dnia 17.04.2022 r. (...)

Jest:

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni to jest do dnia 20.04.2022 r. (...)

Było:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARTCIU OFERT

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 18.01.2022 r. do godz. 09:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

Jest:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARTCIU OFERT

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 21.01.2022 r. do godz. 09:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


Marzena Magulska

znak: D25C/251/N/23-60rj/21

