



Znak: AE/ZP-27-91/23

Tarnów, 2024-01-15


**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz siatek do przepuklin i taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewniki centralne do hemodializy do ostrej terapii nerkowej, przeznaczone do stosowania w celu uzyskania krótkotrwałego dostępu (mniej niż 30 dni) do hemodializy lub aferezy o podwójnym świetle, wykonane z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich poliuretanu. Rurki cewnika są oznaczone kolorami, gdzie niebieski oznacza żylny, a czerwony oznacza światło tętnicze. Końcówka cewnika jest zwężona i wykonana z bardziej miękkiego materiału. Elastyczną rurkę cewnika Altius RT można ukształtować jako prostą rurkę z przedłużeniem, prostą rurkę z przedłużeniem w kształcie litery J lub wstępnie zakrzywioną rurkę z prostym przedłużeniem. Inteligentne rowki wokół bocznych otworów zapobiegają przyklejaniu się ich do ścianek naczynia. Produkt jest również wyposażony w zintegrowane zawory hemostatyczne zamiast zwykłych złącz typu Luer Lock. Zastawki hemostatyczne zapewniają bezpieczeństwo poprzez automatyczne uszczelnienie przewodów, dzięki czemu nie jest konieczne zaciskanie przewodów cewnika na żadnym etapie zabiegu.
  - Igła wprowadzająca 1 × 7 cm, 18 Ga Y
  - 1 × strzykawka 5 ml
  - 1 × 70 cm, 0,035'' przewodnik nitinolowy w przewodnicy przewodnika z nasadką
  - Rozszerzacz 1 × 12 Fr z powłoką hydrofilową
  - 1 × 14 Fr lub 16 Fr rozszerzacz z powłoką hydrofilową
  - 1 × skalpel nr 11
  - Usztywniacz 1 × 12 Fr lub 14 Fr

W zależności od rozmiaru, długości i rodzaju cewnika, w zestawach dostępne są różne warianty rozszerzaczy i usztywniaczy. Wymiary komponentów podane są także na etykiecie produktu.


#### Insertion Kit



Dostępne długości cewnika dla rozmiaru 12Fr

Length	Lumen	Priming Volume CC	Flow Rate vs Pressure		
	Side		200ml/min	300ml/min	400ml/min
15cm	Venous	0.8	80	135	190
	Arterial	0.7	-50	-130	-180
20cm	Venous	0.9	70	180	210
	Arterial	0.8	-70	-165	-200
25cm	Venous	0.9	100	200	230
	Arterial	0.8	-90	-190	-225

2. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewniki o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności: Pozycja 1 Cewnik czasowy do hemodializ dwuświatłowy 12 F lub 14F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, w dostępnych długościach 15,20,24cm, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35'' x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, opatrunek na cewnik.

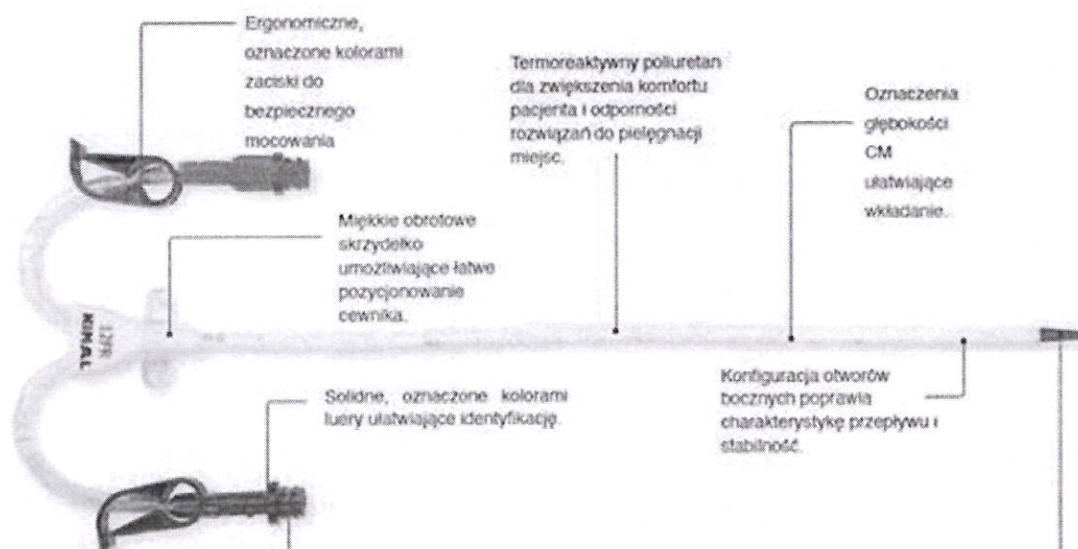

3. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 2.** Zestaw dializacyjny permanentny (stały) wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na odkładanie się skrzepliny. Produkt znany Zamawiającemu. Zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy 15,5F - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip); Długość mierzona jako odległość mufki-koniec cewnika (Cuff to tip) Pakowane pojedynczo. **Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm , 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm,**





- zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,
  - końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,
  - osobny kanał dla przewodnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,
  - posiada mufkę polioesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,
  - wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanych,
  - końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu
  - Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne
4. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:
- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
  - wykonane z miękkiej tkaniny
  - strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
  - unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
  - mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
  - odporne na płyny
  - brak zawartości lateksu
  - przezierny dla promieni RTG
  - uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania typu rzep)
5. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie kocy na całe ciało dla pacjenta dorosłego o wymiarach 195 x 100 cm



Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

7. **Dotyczy Pakietu Nr 45 poz. 1.** Prosimy o potwierdzenie, czy chodzi o technologię Nellcor czy Nellcor Oximax.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 45 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie czujników neonatalnych <3 >30 kg.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 54 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udział w przetargu w pakiecie nr 54 poz. 1 Taśmy podcewkowe do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonane z niewchłanianego polipropylenu monofilamentowego; szerokość 1.2 cm (+/- 0.1 cm), długość 45 cm, grubość 0.34 mm (+/-0,05mm), gramatura 45 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów 1,25 mm. Brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. Taśmy umieszczone w plastikowej, dwuczęściowej osłonce



10. **Dotyczy pkt 23.13 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości brutto umowy.
11. **Dotyczy pkt 23.14 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 51 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści narzędzie, dedykowane do mocowania siatek. Ładunki wchłaniające, zbudowane z PLA (poliaktyd) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 6.7 mm. część penetrująca 5.9mm-6.0mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Średnica głowicy 4,2 mm. Długość trzonu 36cm Ładunki całkowicie wchłaniają się po 12-18 miesiącach. Zawiera 30 zszywek. Urządzenia mają wskaźnik zużycia ładunków, są jednorazowe i sterylne. Zestawy pakowane po 5szt.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 51 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę konfekcjonowania, tak aby wymagana ilość wynosiła 10 szt. Oferowany produkt w tej pozycji jest pakowany po 5 szt. Takie rozwiązanie umożliwi dostarczenie całych opakowań?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze 3.3 zamiast 3.0?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści prowadnice nr 4,7 – 5,0 o długości 340 mm?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego składający się z pojemnika o pojemności 25 ml, dwóch węży przyłączeniowych o długości 33-35 cm z średnicą wlotu wynoszącą 6 mm, ze złączami: 1 złącze żeńskie (lejek) oraz 1 złącze męskie (stożkowe)?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe wykonane z PCV, z miękkim mankietem również wykonanym z PCV, niesilikonowanym?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rozmiary/zakresy wagowe: <5 kg, 5-10 kg, 10-20 kg, 20-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, >70 kg?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści nawilżenie 24 mg H<sub>2</sub>O/L?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.: 2, 4, 5.** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii zabezpieczonym zatyczką, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.: 2, 4, 5.** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii zabezpieczonym zatyczką, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.: 2, 4, 5.** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 30 mg/h20, z portem do kapnografii zabezpieczonym zatyczką, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów +/- 10%?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści pas o wymiarach 135 cm x 3,2 cm?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 19.** Czy Zamawiający wymaga worka na wymiociny zawierającego dodatkowo saszetkę z absorbentem?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści balon 3 ml dla rozmiarów CH6, CH8, CH10?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści balon 5-15 ml dla rozmiarów 12CH i 14CH?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 24.** Czy Zamawiający dopuści rozmiary łyżek:
  - Nr 2 – długość całkowita 105mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 82mm;
  - Nr 3 – długość całkowita 135mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 107mm;
  - Nr 4 – długość całkowita 155mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 127mm;
  - Nr 5 – długość całkowita 175mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 145mm?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 4 łyżki w rozmiarach 1, 2, 3, 4?






30. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz.: 1, 2, 3.** Czy Zamawiający dopuści możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C przez 5 minut?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści diodę LED wkręcaną od zewnątrz rękojeści?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści montaż i demontaż światłowodu przy użyciu narzędzi?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 36.** Czy Zamawiający dopuści 2 rury rozciągliwe o długości 180 cm oraz jedną rurę rozciągliwą o długości 120 cm?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga gąbki do higieny jamy ustnej nasączonej dwuwęglanem sodu, który ma właściwości odświeżające i nawilżające?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 45 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści czujniki dla wcześniaków i noworodków o wadze < 3 kg?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 45 poz. 1.** W jakiej technologii mają być wykonane czujniki?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 45 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści czujniki dla dzieci o wadze 1-15 kg?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 45 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści czujniki dla dzieci o wadze 15-40 kg?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z oświetleniem LED?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z zestawem łyżek typu MacIntosh rozmiar 0, 1, 2, 3, 4?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu z możliwością sterylizacji w 134°C przez 5 minut?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu z możliwością sterylizacji w 134°C przez 5 minut?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu z możliwością sterylizacji w 134°C przez 5 minut?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z zestawem łyżek typu Miller rozmiar 0, 1, 2, 3, 4?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści podobnie jak w poz. 5 rękojeść światłowodową LED?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 5.** – Czy Zamawiający wymaga 8 sztuk zestawów zamiennych światłowodów (z każdego zaofertowanego rozmiaru), czy też 8 sztuk pojedynczych światłowodów z rozmiaru zależnie od zapotrzebowania Zamawiającego?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koc do ogrzewania pacjenta na całe ciało o wymiarach 210 cm x 120 cm?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania w długościach 15-20 cm, spełniający pozostałe wymogi SWZ
49. **Dotyczy pkt 23.13 a) i b) SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia oraz w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości oraz asortymentu. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.
50. **Dotyczy pkt 23.13 c) SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Prosimy o zmniejszenie łącznego limitu kar do poziomu 20% wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 23.13 c ze względu na aktualną linię orzecznictwa sądów powszechnych, limit kar umownych, którego wysokość w stosunku do wartości umowy oscyluje w granicach kilkudziesięciu procent, jest uznawany za nadmierny w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. (np. wyrok SO w Rzeszowie z dnia 25.09.2019 r.; sygn. akt: VI Ga 173/13, w którym za niewspółmierną uznano karę umowną w wysokości 43% wynagrodzenia).
51. **Dotyczy RODO.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?
52. **Dotyczy Pakietu Nr 45 poz. 1-3.** Czy Zamawiający wymaga czujników sterylnych?
53. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości trzech rur 180 cm?
54. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dwoma rurami o długości 180 cm i trzecią rurą do worka o długości 90 cm?





55. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1-2.** Czy Zamawiający dopuści łyżki w rozmiarach, jak w tabeli poniżej:




SIZE	A	B
0	80mm	13mm
1	92mm	18mm
2	100mm	18mm
3	130mm	18mm
4	155mm	22mm
5	175mm	24mm

56. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 2.** Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
57. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
58. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1-3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
59. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści przewodnice do trudnych intubacji o następujących rozmiarach:

ROZMIAR	ŚREDNICA O.D.	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	ROZMIAR RURKI
6 Fr	2,0 mm	535 mm	od 2,0 do 4,0
10 Fr	3,3 mm	600 mm	od 4,5 do 6,0
10 Fr	3,3 mm	800 mm	od 4,5 do 6,0
15 Fr	5,0 mm	600 mm	od 6,5 do 10,0
15 Fr	5,0 mm	800 mm	od 6,5 do 10,0


60. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z możliwością odsysania z nad mankieta?
61. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego jak na zdjęciu o właściwościach:

- Pojemnik na wydzielinę 25 ml (skalowany co 1 ml)
- W nakrętce pojemnika zintegrowane 2 dreny: jeden zakończony łącznikiem żeńskim (lejek), drugi zakończony łącznikiem męskim (stożek) z kontrolą siły ssania
- Kompatybilny ze wszystkimi cewnikami ssącymi między CH 4-20
- W zestawie dodatkowa nakrętka do zabezpieczenia pojemnika oraz naklejka identyfikująca
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

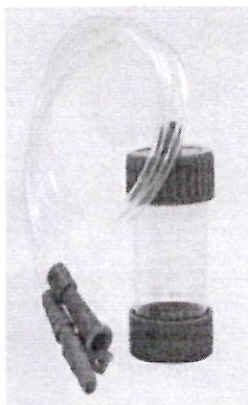

?

62. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego jak na zdjęciu o właściwościach:



- System służy do odsysania śluzu bez ryzyka infekcji;
- Pojemnik na wydzielinę z drenem;
- Z kontrolą siły odsysania i lejkiem;
- Jałowy, nie zawiera pirogenów;
- 40 ml;
- Skalowanie co 5 ml
- Posiada naklejkę z informacją o pacjencie

?

63. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga zestawu do odsysania 24H czy 72H?

64. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści maski w następujących rozmiarach:

ROZMIAR	KOLOR BALONIKA KONTROLNEGO	PRZEDZIAŁ WAGOWY PACJENTA
1,0	Czarny	≤ 5 kg
1,5	Biały	5-10 kg
2,0	Czerwony	10-20 kg
2,5	Pomarańczowy	20-30 kg
3,0	Zielony	30-50 kg
4,0	Żółty	50-70 kg
5,0	Różowy	70-100 kg

?

65. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestawy zakończone są uniwersalną końcówką, która pozwala na podłączenie drenów o średnicach 3,3 ÷ 5,3 mm / 8 ÷ 16 CH/?

66. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści dren Redon o długości 70 cm, w rozmiarach Ch8-Ch18, pakowane w wersji zwiniętej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

67. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści sondy-zgłębniki Sengstakena o całkowitej długości 850 mm?

68. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii o następujących rozmiarach:



ROZMIAR	OBWÓD GŁOWY
S	200 – 280 mm
M	240 – 340 mm
L	300 – 400 mm

69. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Cardio-Aid 50mm x30 m gładki?
70. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści papier kratkowany w rozmiarze 112x100x100?
71. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 210x30?
72. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 152x100x150?
73. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 14** Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 150x100x150?
74. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 36mm?
75. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 43mm lub 48mm?
76. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 36mm lub 54mm?
77. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 30mm?
78. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewniki bez rozmiaru F4-F5, pozostałe parametry i rozmiary zgodne z SIWZ?
79. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści dren o wymiarach ramion 45x18 cm?
80. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści anoskop o długości 8,8cm i średnicy 23mm?
81. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod w opakowaniu a'4 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
82. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarze 32x22mm?
83. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach CH16-24 z balonem 5-10ml?
84. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony atraumatyczną, natłuszczoną końcówką zabezpieczoną zatyczką?
85. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego zadania, co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
86. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1 i 2.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
87. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1 i 2.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania przedłużaczy o średnicy drenu 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego
88. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj. – optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia. co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu.
89. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwi osiągnięcie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej
90. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z dedykowanym łącznikiem do drenów 10,14,18. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zestaw, który chcemy zaferować jest obecnie stosowany w Państwa placówce.
91. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy zamawiający oczekuje zaferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.





92. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.: 1, 2, 3, 7, 8.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu mikrobiologicznie czystego. Pozostałe warunki zgodne z SWZ.
93. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.: 4, 5, 6.** W związku z tym, że nie istnieją ogólne standardy określające rozmiary masek tlenowych prosimy o sprecyzowanie jak zinterpretować rozmiary S,M,L, XL aby zaoferować produkt o wymiarach oczekiwanych przez Zamawiającego. Ewentualnie mając to na uwadze czy wystarczające będą maski przeznaczone dla dorosłego lub pediatrycznego pacjenta uniwersalne o wydłużonym kształcie umożliwiającym dopasowanie do pacjentów o różnych zakresach wagowych i wzrostowych? Produkt mikrobiologicznie czysty

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30 poz. 1** opisanych w pytaniu cewników centralnych do hemodializy do ostrej terapii nerkowej.

**Ad 2.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 31 poz. 1** opisanych w pytaniu cewników czasowych do hemodializ dwuświatłowych.

**Ad 3.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 31 poz. 2** opisanych w pytaniu zestawów dializacyjnych permanentnych (stałych).

**Ad 4.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 38 poz. 1**.

**Ad 5.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 38 poz. 1** koców do ogrzewania pacjenta pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym (w takim przypadku należy zaoferować 2 opakowania po 10 szt.), pod warunkiem że zaoferowane koce spełniają wymagania określone w SWZ.

**Ad 6.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 38 poz. 1**, w tym również dotyczące rozmiaru.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 38 poz. 1** koców do ogrzewania pacjenta pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym (w takim przypadku należy zaoferować 2 opakowania po 10 szt.), pod warunkiem że zaoferowane koce spełniają wymagania określone w SWZ

**Ad 7.** Zamawiający wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 45 poz. 1** określił w SWZ

**Ad 8.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 45 poz. 1**.

**Ad 9.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 54 poz. 1** taśm podcewkowych do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu opisanych w pytaniu.

**Ad 10-11.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów do punktu 23 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

**Ad 12.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 51 poz. 1** narzędzi, dedykowanych do mocowania siatek opisanych w pytaniu.

**Ad 13.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ilości przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 51 poz. 1**. Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do SWZ „Zamawiający dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglić zaoferowane ilości do pełnych opakowań w górę”.

**Ad 14.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 6** przewodnic 3,3 zamiast 3,0, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, w tym również w zakresie pozostałych rozmiarów.

**Ad 15.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 6** przewodnic nr 4,7-5,0 o długości 340 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, w tym również w zakresie pozostałych rozmiarów.

**Ad 16.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 1**.

**Ad 17.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 7 poz. 1**

**Ad 18.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 7 poz. 1**.





- Ad 19.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** nosków z filtrem i portem tlenowym do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych - wymienników ciepła i wilgoci o nawilżaniu 24 mg H<sub>2</sub>O/L, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.
- Ad 20-22.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz.: 2, 4, 5.**
- Ad 23.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 22 poz. 5.**
- Ad 24.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 22 poz. 14.**
- Ad 25.** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 22 poz. 19** worka na wymiociny spełniającego wymagania określone w SWZ.
- Ad 26.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23 poz. 1** cewników Foley z balonem 3 ml dla rozmiarów CH6, CH8, CH10, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.
- Ad 27.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23 poz. 2** cewników Foley z balonem 5-15 ml dla rozmiarów 12CH i 14CH, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym zaoferowania pozostałych rozmiarów cewników.
- Ad 28.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla łyżek do laryngoskopów oferowanych w **Pakiecie Nr 24 poz. : 1, 2, 3.**
- Ad 29.** Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz.. 1** kompletu zawierającego 4 łyżki w rozmiarach 1, 2, 3, 4, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym długości całkowitej, szerokości, długości wewnętrznej poszczególnych rozmiarów oferowanych łyżek.
- Ad 30.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz.: 1, 2, 3,** w tym w zakresie sterylizacji.
- Ad 31.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 3.**
- Ad 32.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 3.**
- Ad 33.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 36 poz. 1.**
- Ad 34.** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 40 poz. 1** gąbek do higieny jamy ustnej spełniających wymagania SWZ.
- Ad 35.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 45 poz. 1.**
- Ad 36.** Zamawiający wymaga dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 45 poz. 1** określił w SWZ
- Ad 37.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 45 poz. 2.**
- Ad 38.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 45 poz. 3.**
- Ad 39.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 1**
- Ad 40.** Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24 poz.. 1** laryngoskopu z kompletem łyżek typu MecIntosh zawierającego 5 łyżek w rozmiarach 0, 1, 2, 3, 4, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym długości całkowitej, szerokości, długości wewnętrznej poszczególnych rozmiarów oferowanych łyżek
- Ad 41.** Zamawiający podtrzymuje określone w SWZ wymagania dotyczące sterylizacji przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 1.**
- Ad 42.** Zamawiający podtrzymuje określone w SWZ wymagania dotyczące sterylizacji przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 2.**
- Ad 43.** Zamawiający podtrzymuje określone w SWZ wymagania dotyczące sterylizacji przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 3.**
- Ad 44.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 3.**





**Ad 45.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 4.**

**Ad 46.** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 24 poz. 5** światłowodów spełniających wymagania SWZ, w tym ilości, która została wyraźnie określona „8 sztuk”.

**Ad 47.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 38 poz. 1.**

**Ad 48.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30 poz. 1** zestawów do cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie tylko w długościach 15-20 cm i podtrzymuje określone w SWZ wymagania w tym zakresie.

**Ad 49-50.** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do zapisów **punktu 23** SWZ- Projektowane postanowienia umowy

**Ad 51.** Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy powierzenia danych osobowych.

**Ad 52.** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 45 poz. 1-3** czujników spełniających wymagania określone w SWZ.

**Ad 53.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 36 poz. 1.**

**Ad 54.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 36 poz. 1.**

**Ad 55.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 24 poz. 1-2.**

**Ad 56.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 22 poz. 2** do osobnego pakietu.

**Ad 57-58.** Zamawiający nie musi dopuszczać wielkości oferowanych opakowań, bo to Wykonawca winien zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ podać wielkość oferowanych opakowań. Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 1 do SWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglić zaoferowane ilości do pełnych opakowań w górę.

**Ad 59.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz.6** przewodnic do rurek intubacyjnych o rozmiarach wymienionych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 60.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 4.**

**Ad 61.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** zestawów do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego opisanych w pytaniu oraz pokazanym na zdjęciu załączonym do pytania.

**Ad 62.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** zestawów do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego opisanych w pytaniu oraz pokazanym na zdjęciu załączonym do pytania.

**Ad 63.** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** zestawu do odsysania z oskrzeli spełniającego wymagania określone w SWZ.

**Ad 64.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** masek krtaniowych w rozmiarach: ≤5 kg, 5 - 10 kg, 10-20 kg, 20-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 65.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 1.**

**Ad 66.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 2.**

**Ad 67.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 4** sond-zgłębników Sengstakena o całkowitej długości 850 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 68.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 3** okularów do fototerapii dla noworodków w rozmiarach wymienionych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 69.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 4** gładkiego papieru do defibrylatora Cardio-Aid.

**Ad 70.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 13 poz. 11.**





**Ad 71.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 13 poz. 12.**

**Ad 72-73.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 13 poz. 14**

**Ad 74.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 1** elektrod do monitorowania EKG o średnicy 36 mm, pod warunkiem, że przeznaczone są dla dzieci i spełniają pozostałe wymagania SWZ.

**Ad 75.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 2** elektrod do monitorowania EKG o średnicy 43 mm, pod warunkiem, że przeznaczone są dla dorosłych i spełniają pozostałe wymagania SWZ.

**Ad 76.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 3** elektrod holterowskich o średnicy 54 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 77.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 4** elektrody o średnicy 30 mm.

**Ad 78.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18 poz. 2** cewników do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych bez rozmiaru F4 lub F-5.

**Ad 79.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 19 poz. 1** drenów Kehr o rozpiętości ramion 45 cm x 18 cm..

**Ad 80.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 9** anoskopów o długości 8,8 cm i średnicy 23 mm.

**Ad 81.** Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę w **Pakiecie Nr 22 poz. 16** elektrod w opakowaniach a' 4 sztuki ponieważ wymaga zaoferowania kompletu składającego się z 6 sztuk.

**Ad 82.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 22 poz. 16.**

**Ad 83.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23 poz. 2** cewników Foley w rozmiarze CH 16-24 z balonem 5-10 ml, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 84.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27 poz. 1** zestawów do lewatywy zakończonych atraumatyczną natłuszczoną końcówką zabezpieczoną zatyczką, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ

**Ad 85.** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 28 poz. 3** do oddzielnego pakietu.

**Ad 86.** Zamawiający określił w SWZ zasady oceny ofert oraz dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą, i nie przewiduje zmian w tym zakresie na etapie oceny już otwartych ofert. Dotyczy to przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 8 poz. 1 i 2** jak i w pozostałych pakietach.

**Ad 87.** Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 8 poz. 1 i 2** przedłużaczy spełniających wymagania określone w SWZ.

**Ad 88-89.** Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 8 poz. 3** kraników trójdrożnych z przedłużaczem spełniających wymagania określone w SWZ.

**Ad 90.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 34 poz. 1** zestawu do drenażu ran w systemie zamkniętym z dedykowanym łącznikiem do drenów: CH 10, CH14, CH18, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 91.** Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 2** folii operacyjnych spełniających wymagania SWZ.

**Ad 92.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz.: 1, 2, 3, 7, 8** asortymentu mikrobiologicznie czystego.

**Ad 93.** Zamawiający określił w SWZ jaki rozmiar winny mieć maski oferowane w **Pakiecie Nr 20 poz.: 4,5, 6** i dla jakiej grupy pacjentów mają być przeznaczone.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora  
*mgr Danuta Nosek*

