



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury” - poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2022 – 2023 lub z największą pediatryczną aktywnością donacyjną w 2023 r.”

Włocławek, dnia 16.09.2024r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp pn. „Zakup systemów grzewczych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.”. Znak postępowania: DZP/ 68 /2024.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że zgodnie z art 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024. 1320), wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania oraz wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 3

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„4 zakresy temperatury:

- temp. otoczenia

- 32°C

- 38°C

- 43°C”

Produktu o poniższym parametrze:

„4 zakresy temperatury:

- temp. otoczenia

- 32,2°C

- 37,8°C

- 43,3°C”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 4

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



„Podstawa jezdna do aparatu na 5 kołach z koszykiem na koce, **min. 3 koła** muszą posiadać blokadę”
Produktu o poniższym parametrze:

„Podstawa jezdna do aparatu na 5 kołach z koszykiem na koce, **min. 2 koła** muszą posiadać blokadę”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 5

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Regulowana wysokość **uchwyty** podstawy jezdnej”

Produktu o poniższym parametrze:

„Regulowana wysokość **uchwyty kosza** podstawy jezdnej”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 5


W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:


„Regulowana wysokość uchwyty podstawy jezdnej”

Produktu o poniższym parametrze:

„Podstawa jezdna bez regulowanej wysokości uchwyty”

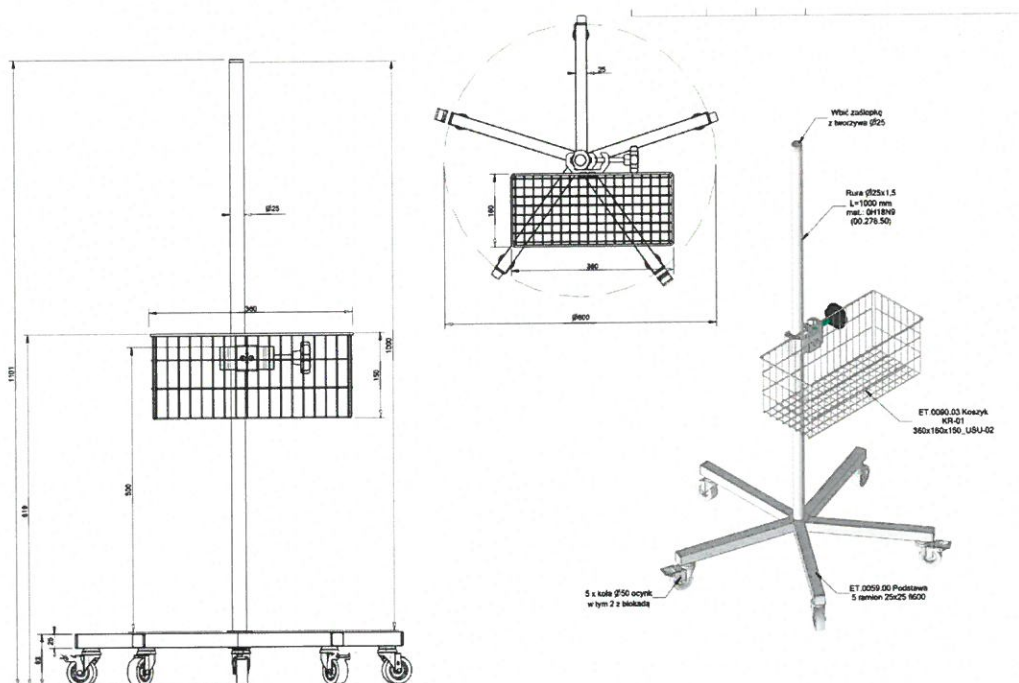

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Handwritten signature or initials.



Pytanie nr 5

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 8

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia nie więcej niż 5 kg”

Produktu o poniższym parametrze:

„Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia nie więcej niż 6,1 kg”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 9

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Niewielkie wymiary urządzenia: max. 20 x 35 x 40 cm (G x S x W)”

Produktu o poniższym parametrze:

„Niewielkie wymiary urządzenia: max. 22,2 x 22,2 x 34,3 cm (G x S x W)”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 13

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Duża wydajność – przepływ powietrza minimum 1400 l/min”

Produktu o poniższym parametrze:

„Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Akceptowalny zakres przepływu powietrza: max 1000 l/min.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 14

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Szybkie osiągnięcie temperatury – max 30 sek.”

Produktu o poniższym parametrze:

„Szybkie osiągnięcie temperatury – 37°C z 23±2°C: około 3 minuty”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 18



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA H13 99,99%”

Produktu o poniższym parametrze:

„Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: filtrowanie powietrza w urządzeniu grzewczym, drugie filtrowanie w kołderce grzewczej.

Filtracja: 0,2 mikrometra, wysoka skuteczność”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 21

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Cicha praca urządzenia – poziom hałasu **max 49 dB** przy maksymalnych obrotach wentylatora”

Produktu o poniższym parametrze:

„Cicha praca urządzenia – poziom hałasu **max 53 dB** przy maksymalnych obrotach wentylatora”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 22

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy **poniżej 650W**.”

Produktu o poniższym parametrze:

„Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy **1200W / VA**.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 23

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Dostępne koce ogrzewające wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG.

Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza.”

Produktu o poniższym parametrze:

„Dostępne koce ogrzewające wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG.

Materiał kołderki bez perforacji (otworów) powodujących silny nadmuch i ruch powietrza.

Struktura materiału zapewnia dodatkowe (obok filtra w urządzeniu) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza przez całą powierzchnię kołderki.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 13

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 24

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Dostępne koce ogrzewające pacjenta **min. w 15 rozmiarach**, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koc na dolną część ciała; koc na górną część ciała; koc na całe ciało; koc pediatryczny; koc pod pacjenta).”

Produktu o poniższym parametrze:

„Dostępne koce ogrzewające pacjenta **min. w 8 rozmiarach**, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koc na dolną część ciała; koc na górną część ciała; koc na całe ciało; koc pediatryczny; koc pod pacjenta).”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 25

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego”

Produktu o poniższym parametrze:

„Dostępne koce, posiadając właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta kilka minut również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 1 - „System grzewczy z nawiewem – 3 szt” - podpunkt 25

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu:

„Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego”





Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt”



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Czy zamawiający wymaga aby System ogrzewania pacjenta posiadał Zasilanie bateryjne z możliwością pracy przez min. 1,5 godz. niezależnie od zasilania z sieci?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 4

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Przełącznik zasilania umieszczony z tyłu urządzenia”

Produktu o poniższych parametrach:

„Przełącznik zasilania umieszczony w przedniej części urządzenia”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 6

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania 3 elementami grzewczymi jednocześnie – 3 porty do podłączenia elementów grzewczych ”

Produktu o poniższych parametrach:

„Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania 2 elementami grzewczymi jednocześnie – 2 porty do podłączenia elementów grzewczych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 7

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Porty posiadające oznakowanie od 1 do 3 odpowiadające numeracji na interfejsie użytkownika”

Produktu o poniższych parametrach:

„Porty posiadające oznakowanie od A do B odpowiadające numeracji na interfejsie użytkownika.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 8

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu co ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy”

Produktu o poniższych parametrach:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



„Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu (od dolnej części) co ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 9

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia”

Produktu o poniższych parametrach:

„Brak wyprofilowanego uchwyty do przenoszenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 10

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Możliwość zawieszenia jednostki sterującej na stojaku do kroplówek – w kpl. niezbędny osprzęt lub postawienia np. na kolumnie”

Produktu o poniższych parametrach:

„Mocowanie sterownika na stojaku do kroplówek lub na medycznej szynie profilowej za pomocą własnych, zintegrowanych ze sterownikiem uchwytów.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 11

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Możliwość zamocowania jednostki sterującej na dedykowanym statywie mobilnym”

Produktu o poniższych parametrach:

„Możliwość zamocowania jednostki sterującej na statywie mobilnym.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 12

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Klasa przed dostępem do niebezpiecznych części przed penetracją czynników zewnętrznych min IP20”

Produktu o poniższych parametrach:

„Ochrona przed wnikaniem płynów min. IPX2”



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 14

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Moc 997 VA”

Produktu o poniższych parametrach:

„Maksymalny pobór mocy max: 160W”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 16

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Klasa zabezpieczenia elektrycznego II typ BF”

Produktu o poniższych parametrach:

„Klasa ochrony I, część aplikacyjna z zabezpieczeniem przed defibrylacją, typ BF”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 17

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Zakres regulacji temperatury 30-40°C co 0,1°C dla każdego portu grzewczego niezależnie -30-39°C co 0,1°C dla noworodków -urządzenie automatycznie ustala limit w zależności od typu podłączonego elementu grzewczego”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zakres regulacji temperatury 32-39°C co 0,5°C dla każdego portu grzewczego niezależnie -32-39°C co 0,5°C dla noworodków ”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 18

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Okres żywotności min. 10 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu”

Produktu o poniższych parametrach:

„Oczekiwana żywotność sprzętu wynosi 10 lat od daty pierwszego użycia, o ile produkt nie był używany w sposób niewłaściwy, niedbały, grożący uszkodzeniem lub nieuzasadniony, a był użytkowany w warunkach, które umożliwiają prawidłową i zgodną z przeznaczeniem eksploatację i konserwację - informacja zawarta w instrukcji użytkowania”



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 19

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Dotykowy, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia”

Produktu o poniższych parametrach:

„Przyciski membranowe, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia”



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 20

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Interfejs wyświetla ustawienia dla wszystkich 3 portów jednocześnie”

Produktu o poniższych parametrach:

„Interfejs wyświetla ustawienia dla wszystkich 2 portów jednocześnie”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 21

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co najmniej:
- nr portu grzewczego



- włącznik aktywacji portu – z kolorystycznym indykátorem aktywacji
- wskaźnik temperatury ustawionej, ze skokiem 0,1°C
- wskaźnik temperatury rzeczywistej ze skokiem 0,1°C, wskaźniki w innych kolorach w celu ułatwienia identyfikacji
- wskaźnik temperatury ciała pacjenta w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego
- nazwa podłączonego elementu grzewczego
- wskaźnik słupkowy mocy ogrzewania
- przycisk menu trybu regulacji temp. z automatycznym powrotem w przypadku braku zmiany ustawień
- menu regulacji temperatury – przyciski góra / dół, zakres 30-40°C skok co 0,1°C lub 30-39°C co 0,1°C dla noworodków
- zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania – wymagana akceptacja ustawionej temperatury
- wskaźnik alarmu – komunikat tekstowy z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy wystąpieniu sytuacji alarmowej”

Produktu o poniższych parametrach:

„Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co najmniej:

- nr portu grzewczego
- wskaźnik temperatury ustawionej, ze skokiem 0,5°C
- wskaźnik temperatury rzeczywistej ze skokiem 0,5°C, wskaźniki w celu ułatwienia identyfikacji
- wskazanie podłączonego elementu grzewczego
- wskaźnik strzałkowy opisujący ogrzewanie
- przycisk menu trybu regulacji temp. z automatycznym powrotem w przypadku braku zmiany ustawień
- menu regulacji temperatury – przyciski góra / dół, zakres 32-39°C skok co 0,5°C lub 32-39°C co 0,5°C dla noworodków
- zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania – wymagana akceptacja ustawionej temperatury
- wskaźnik alarmu – komunikat tekstowy z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy wystąpieniu sytuacji alarmowej”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 23

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Dostępne następujące komunikaty alarmowe:

- odchylenia temperatury;
- wysokiej temperatury;
- rozłączenia elementu grzewczego;
- niedogrzenia,

Alarmy z możliwością wyciszenia na 10 minut”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony symbol i wyświetlany jest dla danego kanału, w którym wystąpił błąd):

- temperatura materaca za wysoka < 41°C
- temperatura materaca za niska
- przekroczenie czasu osiągnięcia temperatury zadanej
- uszkodzenie/awaria czujnika



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



- Uszkodzenia / awaria materacaj"

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 25

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wymiary max. 250x280x170 mm”

Produktu o poniższych parametrach:

„Rozmiar sterownika maks. wys. / szer. / głęb. 310 x 160 x 140 mm”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 27

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Dokładność pomiaru +/-0,3°C dla elementów grzewczych, +/-0,2°C dla zewnętrznych czujników temperatury”

Produktu o poniższych parametrach:

„Regulacja temperatury powierzchni styku (istotna cecha eksploatacyjna według normy IEC/EN 80601-2-35) od 32,0°C do 39,0°C w krokach co 0,5°C tolerancja ±1,0°C

Dokładność wskazywania temperatury powierzchni styku ±0,7°C”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 28

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Warunki pracy -10°C / +40°C”

Produktu o poniższych parametrach:

„Warunki pracy:

- Podczas eksploatacji/przechowywania od +16°C do +26°C

- Podczas transportu od -20°C do +50°C”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 29

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Okres żywotności min. 7 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu”

Produktu o poniższych parametrach:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



„Okres żywotności min. 5 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu, z możliwością wydłużenia przez Polski serwis usług przeglądów oraz napraw elementów grzewczych, tak długo jak jest to ekonomicznie uzasadnione - nawet do 10 lat. ”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 31

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Pokrowiec zewnętrzny elementów grzewczych o gramaturze min. 200 g/m², materiał poliester / poliwęglan poliuretan, paroprzepuszczalne min. 500g/m²/24h, brak zawartości halogenu, Oeko-Tex klasa I, z możliwością prania do 50 razy w temp. 95°C”

Produktu o poniższych parametrach:

„Pokrowce na elementy grzewcze z możliwością prania w temp. do 95° C i dezynfekcji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 36


W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Element grzewczy składający się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, silikonowego włókna do izolacji termicznej, grzałki z tkaniny węglowej, warstwy z pianki przewodzącej”

Produktu o poniższych parametrach:

„Element grzewczy składający się” z zewnętrznej trwałej powłoki ochronnej (1), zewnętrzna warstwa folii (2), materiał izolacyjny (3), warstwa folii wewnętrznej (4), technologia grzewcza Carbotex (oparta na włóknach węglowych) (5)”

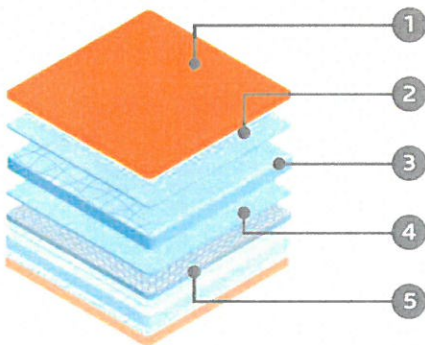

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 37

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00




Zamiast:

„Min 10 czujników temperatury w elemencie grzewczym z trwale oznaczonym diagramem na pokrowcu elementu grzewczego”

Produktu o poniższych parametrach:

„Min 8 czujników temperatury w elemencie grzewczym.”

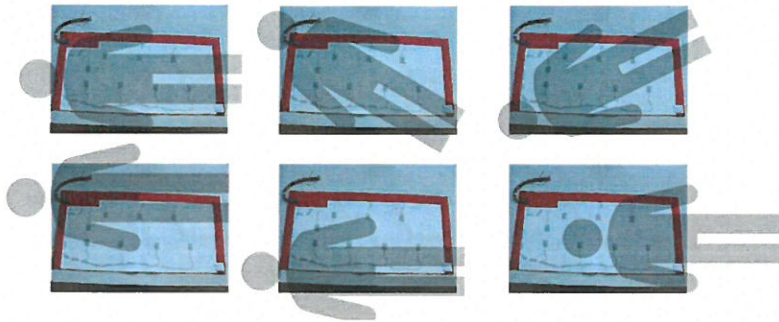

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 38

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu”

Produktu o poniższych parametrach:

„Brak potrzeby oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu, ze względu na obustronne działanie elementu grzewczego (materaca).”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 40

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 1m”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 50cm”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 41

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Materac grzewczy z pianką przeciwdleżynową 190x50x4cm, 145W – 2 szt.
Materac grzewczy z pianką przeciwdleżynową 120x50x4cm, 135W – 2 szt.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:

Materac grzewczy 180x80x3cm, 150W – 2 szt.

Materac grzewczy 150x50x3cm, 150W – 2 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 41

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:

Materac grzewczy z pianką przeciwdleżynową 190x50x4cm, 145W – 2 szt.

Materac grzewczy z pianką przeciwdleżynową 120x50x4cm, 135W – 2 szt.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:

Materac grzewczy 180x80x3cm, 150W – 2 szt.

Materac grzewczy 105x50x3cm, 115W – 2 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 42

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Okres żywotności min. 7 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu”

Produktu o poniższych parametrach:

„Okres żywotności min. 5 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu, z możliwością wydłużenia przez Polski serwis usług przeglądów oraz napraw elementów grzewczych, tak długo jak jest to ekonomicznie uzasadnione - nawet do 10 lat. ”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 44

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Pokrowiec zewnętrzny elementów grzewczych o gramaturze min. 200 g/m², materiał poliester /poliwęglan poliuretan, paroprzepuszczalne min. 500g/m²/24h, brak zawartości halogenu, Oeko-Tex klasa I, z możliwością prania do 50 razy w temp. 95°C”

Produktu o poniższych parametrach:

„Pokrowce na elementy grzewcze z możliwością prania w temp. do 95° C i dezynfekcji.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 46

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 49


W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Element grzewczy składający się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, silikonowego włókna do izolacji termicznej, grzałki z tkaniny węglowej, warstwy z pianki przeciwdrożdżynowej ”

Produktu o poniższych parametrach:

„Element grzewczy składający się” z zewnętrznej trwałej powłoki ochronnej (1), zewnętrzna warstwa folii (2), materiał izolacyjny (3), warstwa folii wewnętrznej (4), technologia grzewcza Carbotex (oparta na włóknach węglowych) (5)”

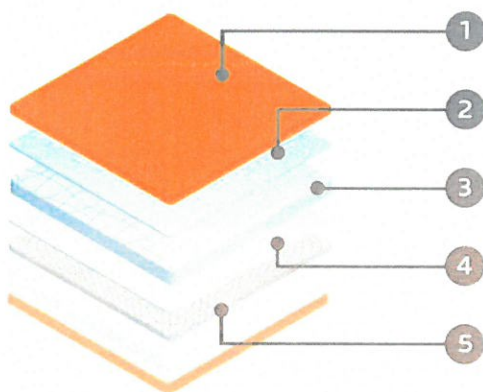

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 50


W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Min 10 czujników temperatury w elemencie grzewczym z trwale oznaczonym diagramem na pokrowcu elementu grzewczego”

Produktu o poniższych parametrach:

„Min 8 czujników temperatury w elemencie grzewczym.”

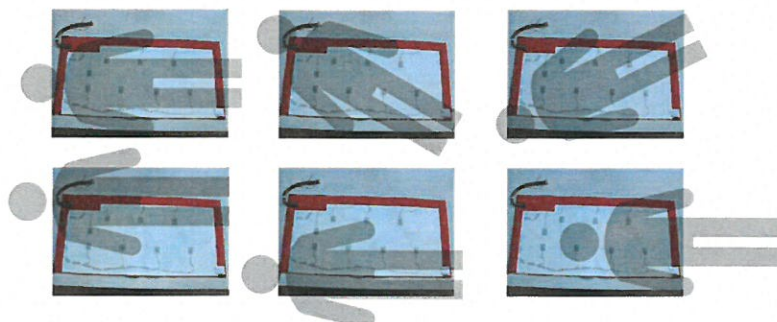



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 51

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu”

Produktu o poniższych parametrach:

„Brak potrzeby oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu, ze względu na obustronne działanie elementu grzewczego (materaca).”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 52

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 1m”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 50cm”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 53

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:

Koc grzewczy 80x70cm, 90W – 2 szt.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:

Koc grzewczy 105x50cm, 115W – 2 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 53

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktuna zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:

Koc grzewczy 80x70cm, 90W – 2 szt.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:

Koc grzewczy 68x48cm, 60W – 2 szt.”



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 53

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:
Koc grzewczy 80x70cm, 90W – 2 szt.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:
Koc grzewczy 150x50cm, 150W – 2 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 55

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Każdy przewód oznakowany indywidualnym numerem seryjnym w minimum 2 miejscach w celu zabezpieczenia przed zmazaniem.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Każdy przewód oznakowany indywidualnym numerem seryjnym w minimum 1 miejscu w celu zabezpieczenia przed zmazaniem”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 56

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„DEDYKOWANY STOJAK MOBILNY Z KOSZEM DO SYSTEMU OGRZEWANIA.”

Produktu o poniższych parametrach:

„ STOJAK MOBILNY PRZEZNACZONY DO ZAWIESZENIA SYSTEMU OGRZEWANIA.”



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt”

Czy zamawiający wymaga aby System ogrzewania pacjenta posiadał Zasilanie bateryjne z możliwością pracy przez min. 1,5 godz. niezależnie od zasilania z sieci?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 56

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 4

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktuna zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Przełącznik zasilania umieszczony z tyłu urządzenia”

Produktu o poniższych parametrach:

„Przełącznik zasilania umieszczony w przedniej części urządzenia”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 6

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania 3 elementami grzewczymi jednocześnie – 3 porty do podłączenia elementów grzewczych ”

Produktu o poniższych parametrach:

„Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania 2 elementami grzewczymi jednocześnie – 2 porty do podłączenia elementów grzewczych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 58

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 7

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Porty posiadające oznakowanie od 1 do 3 odpowiadające numeracji na interfejsie użytkownika”

Produktu o poniższych parametrach:

„Porty posiadające oznakowanie od A do B odpowiadające numeracji na interfejsie użytkownika.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 59

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 8

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu co ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy”

Produktu o poniższych parametrach:

„Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu (od dolnej części) co ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

14



Pytanie nr 60

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 9

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia”

Produktu o poniższych parametrach:

„Brak wyprofilowanego uchwyty do przenoszenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 61

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 10

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Możliwość zawieszenia jednostki sterującej na stojaku do kroplówek – w kpl. niezbędny osprzęt lub postawienia np. na kolumnie”

Produktu o poniższych parametrach:

„Mocowanie sterownika na stojaku do kroplówek lub na medycznej szynie profilowej za pomocą własnych, zintegrowanych ze sterownikiem uchwytów.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 11

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Możliwość zamocowania jednostki sterującej na dedykowanym statywie mobilnym”

Produktu o poniższych parametrach:

„Możliwość zamocowania jednostki sterującej na statywie mobilnym.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 12

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Klasa przed dostępem do niebezpiecznych części przed penetracją czynników zewnętrznych min IP20”

Produktu o poniższych parametrach:

„Ochrona przed wnikaniem płynów min. IPX2”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 64

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 14



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Moc 997 VA”

Produktu o poniższych parametrach:

„Maksymalny pobór mocy max: 160W”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 65

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 16

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Klasa zabezpieczenia elektrycznego II typ BF”

Produktu o poniższych parametrach:

„Klasa ochrony I, część aplikacyjna z zabezpieczeniem przed defibrylacją, typ BF”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 66

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 17

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Zakres regulacji temperatury 30-40°C co 0,1°C dla każdego portu grzewczego niezależnie - 30-39°C co 0,1°C dla noworodków- urządzenie automatycznie ustala limit w zależności od typu podłączonego elementu grzewczego”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zakres regulacji temperatury 32-39°C co 0,5°C dla każdego portu grzewczego niezależnie - 32-39°C co 0,5°C dla noworodków ”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 18

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Okres żywotności min. 10 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu”

Produktu o poniższych parametrach:

„Oczekiwana żywotność sprzętu wynosi 10 lat od daty pierwszego użycia, o ile produkt nie był używany w sposób niewłaściwy, niedbały, grożący uszkodzeniem lub niezasadniony, a był użytkowany w warunkach, które umożliwiają prawidłową i zgodną z przeznaczeniem eksploatację i konserwację - informacja zawarta w instrukcji użytkowania”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 19



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Dotykowy, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia”

Produktu o poniższych parametrach:

„Przyciski membranowe, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia”



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 20

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Interfejs wyświetla ustawienia dla wszystkich 3 portów jednocześnie”

Produktu o poniższych parametrach:

„Interfejs wyświetla ustawienia dla wszystkich 2 portów jednocześnie”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 70

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 21

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co najmniej:

- nr portu grzewczego
- włącznik aktywacji portu – z kolorystycznym indykátorem aktywacji
- wskaźnik temperatury ustawionej, ze skokiem 0,1°C



- wskaźnik temperatury rzeczywistej ze skokiem 0,1°C, wskaźniki w innych kolorach w celu ułatwienia identyfikacji
- wskaźnik temperatury ciała pacjenta w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego
- nazwa podłączonego elementu grzewczego
- wskaźnik słupkowy mocy ogrzewania
- przycisk menu trybu regulacji temp. z automatycznym powrotem w przypadku braku zmiany ustawień
- menu regulacji temperatury – przyciski góra / dół, zakres 30-40°C skok co 0,1°C lub 30-39°C co 0,1°C dla noworodków
- zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania – wymagana akceptacja ustawionej temperatury
- wskaźnik alarmu – komunikat tekstowy z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy wystąpieniu sytuacji alarmowej”

Produktu o poniższych parametrach:

„Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co najmniej:

- nr portu grzewczego
- wskaźnik temperatury ustawionej, ze skokiem 0,5°C
- wskaźnik temperatury rzeczywistej ze skokiem 0,5°C, wskaźniki w celu ułatwienia identyfikacji
- wskazanie podłączonego elementu grzewczego
- wskaźnik strzałkowy opisujący ogrzewanie
- przycisk menu trybu regulacji temp. z automatycznym powrotem w przypadku braku zmiany ustawień
- menu regulacji temperatury – przyciski góra / dół, zakres 32-39°C skok co 0,5°C lub 32-39°C co 0,5°C dla noworodków
- zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania – wymagana akceptacja ustawionej temperatury
- wskaźnik alarmu – komunikat tekstowy z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy wystąpieniu sytuacji alarmowej”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 71

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 23

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Dostępne następujące komunikaty alarmowe:

- odchylenia temperatury;
- wysokiej temperatury;
- rozłączenia elementu grzewczego;
- niedogrzenia,

Alarmy z możliwością wyciszenia na 10 minutj”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony symbol i wyświetlany jest dla danego kanału, w którym wystąpił błąd):

- temperatura materaca za wysoka < 41°C
- temperatura materaca za niska
- przekroczenie czasu osiągnięcia temperatury zadanej
- uszkodzenie/awaria czujnika
- Uszkodzenia / awaria materacaj”



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

14



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 72

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 25

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wymiary max. 250x280x170 mm”

Produktu o poniższych parametrach:

„Rozmiar sterownika maks. wys. / szer. / głęb. 310 x 160 x 140 mm”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 73

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 27

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Dokładność pomiaru +/-0,3°C dla elementów grzewczych, +/-0,2°C dla zewnętrznych czujników temperatury”

Produktu o poniższych parametrach:

„Regulacja temperatury powierzchni styku (istotna cecha eksploatacyjna według normy IEC/EN 80601-2-35) od 32,0°C do 39,0°C w krokach co 0,5°C tolerancja $\pm 1,0^\circ\text{C}$

Dokładność wskazywania temperatury powierzchni styku $\pm 0,7^\circ\text{C}$ ”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 74

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 28

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Warunki pracy -10°C / +40°C”

Produktu o poniższych parametrach:

„Warunki pracy:

- Podczas eksploatacji/przechowywania od +16°C do +26°C

- Podczas transportu od -20°C do +50°C”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 30

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Okres żywotności min. 7 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkownika oraz oznaczony na etykiecie wyrobu”

Produktu o poniższych parametrach:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



„Okres żywotności min. 5 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu, z możliwością wydłużenia przez Polski serwis usług przeglądów oraz napraw elementów grzewczych, tak długo jak jest to ekonomicznie uzasadnione - nawet do 10 lat. ”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 76

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 32

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Pokrowiec zewnętrzny elementów grzewczych o gramaturze min. 200 g/m², materiał poliester / poliwęglan poliuretan, paroprzepuszczalne min. 500g/m²/24h, brak zawartości halogenu, Oeko-Tex klasa I, z możliwością prania do 50 razy w temp. 95°C”

Produktu o poniższych parametrach:

„Pokrowce na elementy grzewcze z możliwością prania w temp. do 95° C i dezynfekcji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 77

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 37


W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Element grzewczy składający się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, silikonowego włókna do izolacji termicznej, grzałki z tkaniny węglowej, warstwy z pianki przeciwdźwiękowej ”

Produktu o poniższych parametrach:


„Element grzewczy składający się” z zewnętrznej trwałej powłoki ochronnej (1), zewnętrzna warstwa folii (2), materiał izolacyjny (3), warstwa folii wewnętrznej (4), technologia grzewcza Carbotex (oparta na włóknach węglowych) (5)”

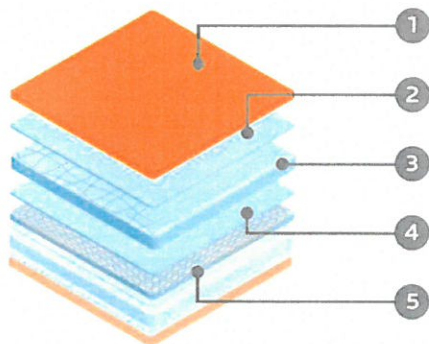

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 78

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 38



ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00




W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Min 10 czujników temperatury w elemencie grzewczym z trwale oznaczonym diagramem na pokrowcu elementu grzewczego”

Produktu o poniższych parametrach:

„Min 8 czujników temperatury w elemencie grzewczym.”

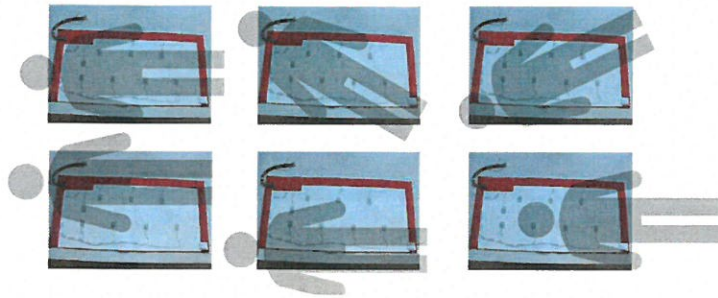

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 79

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 39

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu”

Produktu o poniższych parametrach:

„Brak potrzeby oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu, ze względu na obustronne działanie elementu grzewczego (materaca).”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 41

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 1m”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 50cm”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie nr 81

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 42

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:





Materac grzewczy z pianką przeciwoleżynową 120x50x4cm, 135W – 2 szt.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:

Materac grzewczy 105x50x3cm, 115W – 2 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 82

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 42

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:

Materac grzewczy z pianką przeciwoleżynową 120x50x4cm, 135W – 2 szt.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego:

Materac grzewczy 150x50x3cm, 150W – 2 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 83

Zadanie nr 3 - „System grzewczy duży – 2 szt” - podpunkt 45

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Każdy przewód oznakowany indywidualnym numerem seryjnym w minimum 2 miejscach w celu zabezpieczenia przed zmazaniem.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Każdy przewód oznakowany indywidualnym numerem seryjnym w minimum 1 miejscu w celu zabezpieczenia przed zmazaniem”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84

Zadanie nr 2 - „System grzewczy mały – 3 szt” - podpunkt 46

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„DEDYKOWANY STOJAK MOBILNY Z KOSZEM DO SYSTEMU OGRZEWANIA.”

Produktu o poniższych parametrach:

„ STOJAK MOBILNY PRZEZNACZONY DO ZAWIESZENIA SYSTEMU OGRZEWANIA.”



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dariusz Szczepański
p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
mgr Dariusz Szczepański

Sporządził: Beata Magos



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

