



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27  
Tel. : 47 710 41 00 fax: 47 710 41 01  
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



DZP.2344.49.2022

Białystok, 11.08.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

**Pakiet nr 43**

Czy Zamawiający w Pakiecie 43 w pozycji 2 dopuści (stosowany obecnie przez Zamawiającego) sterylne zestawy do drenażu opakowane podwójnie tj. w folię i kartonową osłonkę i zewnętrznie folia/papier; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 43**

Czy Zamawiający w Pakiecie 43 w pozycji 3 dopuści (stosowany obecnie przez Zamawiającego) łącznik schodkowy niebędący wyrobem medycznym (23% VAT); spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 47**

Czy Zamawiający dopuszcza Trokar laparoskopowy z bezpiecznym płaskim zaokrąglonym ostrzem i jednostronną osłonką, średnica 11mm, z kaniulą karbowaną, dwustopniowym zaworem stop/insuflacja/stop oraz całkowicie zdejmowalna głowica uszczelki ułatwiająca usuwanie tkanki do biopsji i szybką desuflację. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji, mieszczącym narzędzia od 5 do 11 mm. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 47**

Czy Zamawiający dopuszcza Trokar laparoskopowy z bezpiecznym płaskim zaokrąglonym ostrzem i jednostronną osłonką, średnica 5mm, z kaniulą karbowaną, dwustopniowym zaworem stop/insuflacja/stop oraz całkowicie zdejmowalna głowica uszczelki ułatwiająca usuwanie tkanki do biopsii i szybką desuflację. System podwójnej uszczelki. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 47**

Czy Zamawiający dopuszcza Trokar laparoskopowy z bezpiecznym płaskim zaokrąglonym ostrzem i jednostronną osłonką, średnica 12mm, z kaniulą karbowaną, dwustopniowym zaworem stop/insuflacja/stop oraz całkowicie zdejmowalna głowica uszczelki ułatwiająca usuwanie tkanki do biopsii i szybką desuflację. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji, mieszczącym narzędzia od 5 do 12 mm. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 7 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach: 1,9mm, 2,0mm, 2,2mm, 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm o długości 230mm - 600mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 7 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach: 3,0mm, 5,0mm o długości 600 - 1000mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 29 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 29 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 29 poz. 9**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 29 poz. 13**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 144 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 29 poz. 18**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 30l o średnicy 38 cm i wysokości 37,1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 30l o średnicy 38 cm i wysokości 37,1 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 53 poz. 1-4**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk o poniższych parametrach:

Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż. wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiające dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, pojedyncza kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z logiem producenta, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na opakowaniu zbiorczym. Strzykawki bez ftalanów. Informacja o braku ftalanów nie umieszczona na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 53 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk ze skalą nominalną 2ml bez rozszerzenia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 53 poz.2**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk ze skalą nominalną 5 ml bez rozszerzenia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 53 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk ze skalą nominalną 10 ml bez rozszerzenia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 53 poz. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk ze skalą nominalną 20 ml bez rozszerzenia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 53 poz. 1-3**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 53 poz. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 55 poz. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do krwi o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa z PVC pozbawionego szkodliwych ftalanów o długości min. 75mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy nie wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, bez nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne. Przyrząd z opaską stabilizującą dren w opakowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 55 poz. 5**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do płynów infuzyjnych o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99999% (poziom filtracji potwierdzony oświadczeniem producenta) stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 55 poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym znajdowała się instrukcja użytkowania przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym znajdowała się instrukcja użytkowania przyrządu.

**Pakiet nr 55 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat do infuzji grawitacyjnych posiadał dren o długości 180cm, co zwiększy jego możliwości użytkowania na poszczególnych oddziałach wraz z odpowietrznikiem z filtrem BFE min. 99,9999941% - potwierdzony badaniami, który daje bezpieczeństwo pacjentowi podczas użycia aparatu przez personel medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby aparat do infuzji grawitacyjnych posiadał dren o długości 180cm, co zwiększy jego możliwości użytkowania na poszczególnych oddziałach wraz z odpowietrznikiem z filtrem BFE min. 99,9999941% - potwierdzony badaniami, który daje bezpieczeństwo pacjentowi podczas użycia aparatu przez personel medyczny.

**Pakiet nr 68 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 68 poz. 2**

Czy Zmawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 68 poz. 4**

Czy Zmawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 68 poz. 5**

Czy Zmawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową oraz bez łącznika redukcyjnego Luer?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 68 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 68 poz. 1-2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawek kompatybilnych z pompami infuzyjnymi, ale nie wpisanych w menu pompy ASCOR AP 22.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 7 poz. 1, 2, 4**

Czy Zamawiający wymaga masek tlenowych pozbawionych ftalanów, które posiadają szkodliwe związki rakotwórcze?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga masek tlenowych pozbawionych ftalanów.

**Pakiet nr 25 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na przewody medyczne o rozm. 13 cm x 235cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 55 poz. 5**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do płynów infuzyjnych o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99999% (poziom filtracji potwierdzony oświadczeniem producenta) stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra ścięta trójplaszczynowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 53 poz. 1-4**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o poniższych parametrach:

Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j. uż. wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiające dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną pojedynczą czarną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na opakowaniu zbiorczym. Strzykawki bez ftalanów. Informacja o braku ftalanów umieszczona na opakowaniu jednostkowym.

- Strzykawka jednorazowego użytku 2 ml , jałowa, skala do 3 ml
- Strzykawka jednorazowego użytku 5 ml, jałowa, skala do 6 m
- Strzykawka jednorazowego użytku 10 ml, jałowa, skala do 12 ml
- Strzykawka jednorazowego użytku 20 ml, jałowa skala do 24 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie dot. projektu umowy**

W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie ze SWZ – projekt umowy.

#### **Pakiet nr 2 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie kraników wykonanych z poliwęglanu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pakiet nr 2 poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie ramp wykonanych z poliwęglanu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pakiet nr 2 poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie ramp wykonanych z poliwęglanu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pakiet nr 2 poz. 10**

Prosimy o dopuszczenie kraników z przedłużaczem o dł. 10 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pakiet nr 2 poz. 11**

Prosimy o dopuszczenie przyrządu o podanych parametrach:

- Pozwala na wielokrotne bezigłowe pobieranie lub dodawanie płynów do fiolek, butelek
- Składa się z dwukanałowego kolca z ABS i zaworu wykonanego z biokompatybilnego kopoliestru z silikonową membraną
- Posiada filtr powietrza 0,2  $\mu$  i odpowietrznik
- Pomaga zachować sterylność leku w fiołce
- Czas użytkowania to 7 dni lub 600 aktywacji
- Wolny od ftalanów, lateksu i części metalowych
- Korpus jest przezierny i przezroczysty co pomaga zmniejszyć ilość infekcji układu krwionośnego
- Powierzchnia zaworu jest całkowicie płaska co ułatwia dezynfekcję
- Droga przepływu jest prosta, przebiega bez zakłóceń i jest łatwa do przepłukania.
- Zaprojektowany zgodnie z normą ISO 594-1 i ISO 594-2, więc może być bezpiecznie używany z innymi końcówkami Luer.
- Przystosowany do użycia z krwią, alkoholem, lipidami, chemioterapeutykami, chloroheksydyną

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 7 poz. 3, 5, 6**

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 9 poz. 2**

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 53 poz. 1-4**

Prosimy o dopuszczenie strzykawk posiadających dodatkowe przewężenie w środkowej części tłoka.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 53 poz. 1-4**

Prosimy o dopuszczenie strzykawk z kolorystycznym oznakowaniem na opakowaniu karton typu 100 szt, 80 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 53 poz. 1-4**

Prosimy o dopuszczenie strzykawk z piktogramem o braku ftalanów na opakowaniu karton typu 100 szt, 80 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 68 poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie strzykawk kompatybilnych z pompami typu omnifix. Kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta strzykawk. Posiadające dokładną, czytelną skalę w kolorze czarnym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 68 poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie strzykawkę z typem producenta na opakowaniu jednostkowym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 2 poz. 19**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 19 z pakietu 2 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 2 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy EASYLANCE?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 34 poz. 10**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 10 z pakietu 34 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 6 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pakiet nr 18**

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) posiadały wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



**Pakiet nr 22 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści taśmy o specyfikacji zbliżonej do wymagań Zamawiającego :

Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry: szerokość: 1,1 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów: 0,90 mm.

Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą. Końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do przewodnicy.

Taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonięte.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 22 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 22

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 40, 44, 61**

Czy Zamawiający w formularzu cenowym w pakiecie nr 40, 44, 61 podając ilości, ma na myśli ilość sztuk ?

Odpowiedź: Zamawiający w formularzu cenowym w pakiecie nr 40, 44, 61 podając ilości, ma na myśli ilość sztuk.

**Pakiet nr 34**

Czy Zamawiający w Pakiecie 34 wymaga wyceny wszystkich igieł jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pakiet nr 34**

Czy Zamawiający w Pakiecie 34 dopuści wycenę opakowań x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 53**

Czy Zamawiający w Pakiecie 53 dopuści wycenę opakowań x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 55 poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 55 poz. 2 dopuści wycenę opakowań x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 55 poz. 1-3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 55 poz. 1-3 odstąpi od wymogu produktów jednego producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 55 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 55 poz. 3 dopuści wycenę podwójnego systemu bezigłowego o długości 10cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 68 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 68 poz. 1, 2 dopuści wycenę strzykawkę do pomp infuzyjnych 50ml MARGOMED, powszechnie stosowanych w szpitalach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 68 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 68 poz. 3 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 68 poz. 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 68 poz. 6 dopuści wycenę strzykawki z czarną skalą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 29 poz. 17**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 29, Pozycji nr 17 zawierającej Testy Ureazowe do osobnego pakietu - podobnie jak Zamawiający uczynił to dla innych indywidualnych produktów w niniejszym postępowaniu ?

Uzasadnienie: Testy ureazowe są szczególnym testem diagnostycznym IVD, nie mającym nic wspólnego z pozostałymi pozycjami w pakiecie takimi jak pojemniki , kieliszki itp.

W dostawie tych testów specjalizują się dystrybutorzy, którzy zajmują się kompleksowo diagnostyką laboratoryjną in vitro, a testami w kierunku *Helicobacter pylori* w szczególności. Wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty tym firmom, a Zamawiającemu uzyskanie właściwego testu po najniższej cenie. Szpital uniknie w ten sposób np. groźby dostawy wadliwych testów starej generacji - po zawyżonych cenach. Testy ureazowe są wykorzystywane w bardzo drogim i skomplikowanym badaniu gastroscopowym, a fałszywe wyniki uzyskane przez niewłaściwe testy ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi wydatkami na drogą terapię eradykacyjną.

W Polsce 100% użytkowników tych testów mających na uwadze powyższe czynniki wydzieliła je do dokładnie opisanych , pojedynczych pakietów. W obecnej postaci przetarg w zakresie Pakietu Nr 29 dla pozycji nr 17 [Testy Ureazowe] generuje jedynie dodatkowe zyski dla firm farmaceutycznych( hurtowni materiałów medycznych),zawyżając niepotrzebnie cenę dla posiadającego zawsze ograniczone środki Szpitala.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 45 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym, z balonikiem retencyjnym, z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego. Z rękawem zintegrowane wyraźnie oznaczone porty do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika w postaci zaworu bezpieczeństwa chroniącym przed jego przepełnieniem oraz irygacji. Klamra zamykająca światło drenu. Dodatkowy port do pobierania próbek stolca. W zestawie 3 worki o pojemności 1500 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wy-laniem zawartości, skalowane oraz z filtrem węglowym. Pasek do podwieszania na ramie łóżka. System przebadany klinicznie, czas utrzymywania do 29 dni, biologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

### **Pakiet nr 45 poz. 2**

Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane oraz z filtrem węglowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

### **Pakiet nr 21**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 21 w poz. 1 i 2 siatek przepuklinowych częściowo wchłaniających zbudowanych w 50 % z włókien polipropylenowych (część niewchłaniająca) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktanu PGA-PCL (część wchłaniająca), o czasie wchłaniania 90-120 dni , gramaturze 28mg/m<sup>2</sup> , wielkości porów 2,5 mm i grubości włókna 0,5 mm , rozmiary zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie dot. SWZ**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, do dwóch miejsc po przecinku.

### **Pytanie dot. projektu umowy - §3 pkt 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie dot. projektu umowy - §8 ust. 1 pkt. a)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2% wartości towaru nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy

okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% wartości towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio 365% wartości towaru niedostarczonego w ustalonym terminie. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie dot. projektu umowy - §8 ust. 1 pkt. b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 % wartości brutto towarów wadliwych za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% wartości brutto towarów wadliwych za każdy dzień opóźnienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio 365% wartości brutto towarów wadliwych. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie dot. projektu umowy - §8 ust. 1 pkt. c)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1 % wartości brutto nie zrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 31 poz. 2, 3, 4, 5**

Czy zamawiający zgadza się na zaoferowanie szkiełek nakrywkowych posiadających krawędzie cięte? Szlifowanie stosuje się do szkiełek podstawowych, szkiełka nakrywkowe ze względu na grubość 0,15-0,2 mm są szkiełkami ciętymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 31 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na mocz niesterylne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pakiet nr 47 poz. 3**

Czy Zamawiający omyłkowo wpisał trokar o średnicy 11mm, a miał na myśli trokar o średnicy 12 mm? W dalszej części opisu jest wymóg, aby ten sam trokar posiadał uszczelkę na narzędzie od 5 do 12 mm.

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo wpisał trokar o średnicy 11mm. Zamawiający oczekuje trokar o średnicy 12 mm

**Pakiet poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści Myjka w formie gąbki o szybkim działaniu, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała. Łatwe użycie w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej, w domu opieki. Ze względu na jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom.

Produkt wykonany z miękkich włókien poliestru o gramaturze 100 g/m<sup>2</sup>, nasączona mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 54 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 34x74 cm z rzepem 80x5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 2 poz. 17**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 17 dopuści strzykawkę typu enteralnego jednorazowego użytku ENFiT przeznaczona do żywienia enteralnego dla jednego pacjenta drogą przewodu pokarmowego o pojemności 60 ml, bez lateksu, sterylna z końcówką niecentryczną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 2 poz. 18**

Czy zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 18 oczekuje Konektora do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock , pakowany 6x5 szt. po przeliczeniu 47 opakowań zbiorczych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje łącznika do połączenia aparatu z zgłębnikiem żołądkowym.

**Pakiet nr 2 poz. 16, 17, 18**

W związku z faktem, iż oczekiwany asortyment w Pakiecie 2 w pozycjach: 16, 17, 18 jest obecnie stosowany przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o zrezygnowanie z wymogu dostarczenia próbek wyżej wymienionych pozycji.

Odpowiedź: Tak.

**Pakiet nr 29 poz. 1-2, 9, 13, 19**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,9,13,19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 29 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 29 poz. 2, 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 29 poz. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 29 poz. 19**

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 11 000 sztuk = 11 000 odcinków o dł. 45 cm , czy za 11 000 opakowań po 25 szt. odcinków?

Odpowiedź: Zgodnie z ilością podaną w SWZ.

**Pakiet nr 68 poz. 5**

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 68 poz. 6**

Czy zamawiający wymaga strzykawki wpisanej do menu pomp ASCOR?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 68 poz. 6**

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 68 poz. 1-6**

Czy zamawiający dopuści skalę dwustronną lub jednostronną?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie dot. SWZ**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga próbek wraz z ofertą czy na wezwanie (jak w załączniku nr 1)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą.

**Pytanie dot. projektu umowy**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §8 ust.1a) i 1b) do 0,5%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### Pakiet nr 16

Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga przetwornika o parametrach obecnie stosowanych : Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w linię pomiarową 152cm, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w prostą igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw bez koreczka tłumiącego, wyposażony w żółto kontrastowe koreczki zapobiegające przypadkowej kontaminacji. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw kompatybilny z monitorem Mindrey Beneview T8 na czas trwania umowy dostarczany kablami interfejsowymi.



Oraz podwójny przetwornik o parametrach obecnie stosowanych: Zestaw z dwoma przetwornikami podwójny do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w dwie linie pomiarowe 152cm (niebieska/czerwona), przetworniki ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w prostą igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw bez koreczka tłumiącego, wyposażony w żółto kontrastowe koreczki zapobiegające przypadkowej kontaminacji. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw kompatybilny z monitorem Mindrey Beneview T8 na czas trwania umowy dostarczany kablami interfejsowymi.

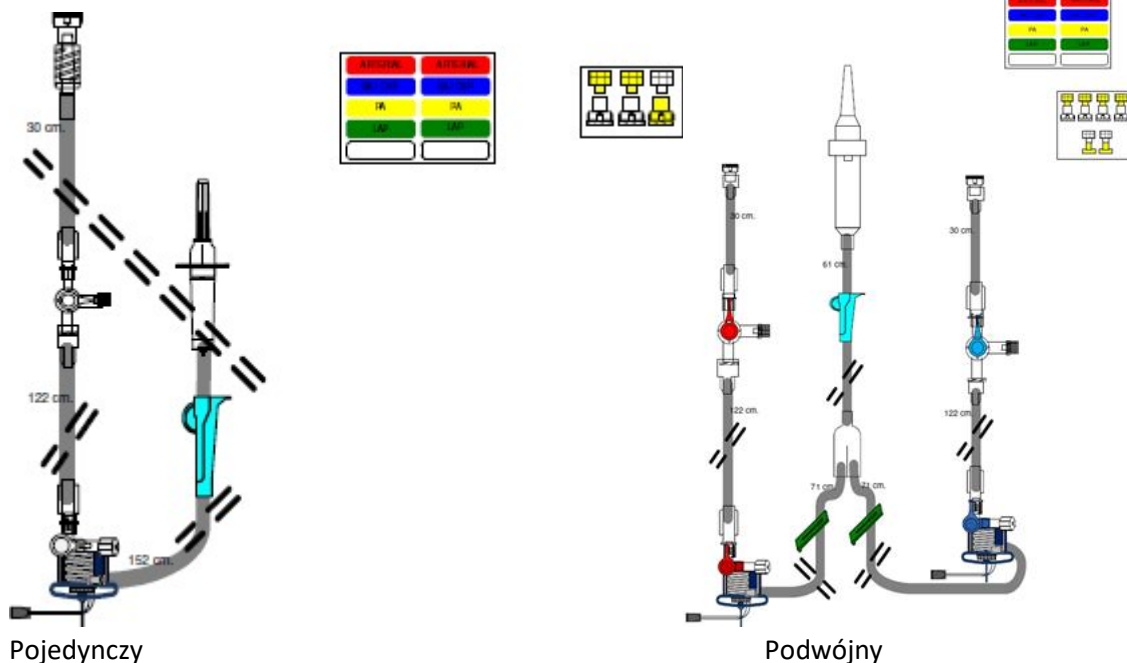

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

### Pakiet nr 16


Czy przetwornik powinien zawierać w opakowaniu dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza) naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji?



Odpowiedź: : Dopuszcza, nie wymaga.

#### **Pakiet nr 72**

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na jednopacjentowy czujnik do pomiaru saturacji typu Y dla dorosłych powyżej 30kg wyprodukowany w technologii Masimo SET oraz złączem (LNCS), kompatybilny z monitorami Beneview T8 firmy Mindray posiadający technologię SpO2 Masimo SET. Technologia Masimo SET do prawidłowego działania wymaga stosowania czujników wykonanych w tej samej technologii. Technologia Masimo SET jest chroniona patentem na całym świecie. A moduły SpO2 są przed stosowaniem nie odpowiednich akcesoriów. Czy Zamawiający w związku z tym na wezwanie będzie chciał dostarczenia potwierdzenia kompatybilności oferowanych czujników przez autoryzowany serwis lub producenta modułu firmę Masimo w Polsce?

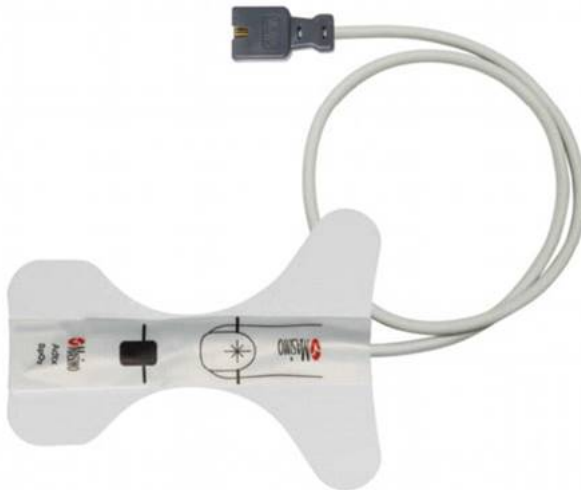

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

#### **Pakiet nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego bez portów w łączniku Y i portem kapno zabezpieczonym zatyczką na uwięzi (nie zakręcany korek) co uniemożliwia jest zgubienie? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pakiet nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania cewnika o długości 400cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pakiet nr 66 poz. 1**



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym o rozmiarach 540mm do rurek intubacyjnych oraz 305mm do rurek trach.? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 40 poz. 1**

Czy Zamawiający dla pakietu nr 40 poz. 1 zgodzi się dopuścić następujący produkt:

REOXCEL Fibril: Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać tkanej, 7-warstwowej włókniny. Czas hemostazy max 3-4 min. Czas wchłaniania max. 7-14 dni. Powyższe parametry potwierdzone w instrukcji użytkowania wraz z działaniem bakteriobójczym in vivo oraz in vitro przeciwko 40 typom bakterii gram+ i gram- w tym na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, , BORDATELLA PERTUSIS, STREPTOCOCCUS FAECALIS, E.coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, MOTT ( prądkie inne niż gruźlica). Potwierdzone w instrukcji użytkowania przeznaczenie dla neurochirurgii. Wysokość Ph 2,5-3,5 potwierdzona badaniami. Zawartość grupy karboksylowej 18-24% potwierdzona oświadczeniem producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 4**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne pojemniki z wodą sterylną o pojemności 450ml, z możliwością stosowania do 35 dni od otwarcia, ze sterylnym łącznikiem, umożliwiającym podłączenie do dozownika tlenowego. Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o możliwość przeliczenia zaoferowanej ilości pojemników 450ml względem pierwotnej ilości wody w ml wymaganej w SIWZ z zaokrągleniem w górę do pełnych sztuk . Pozwoli to na złożenie porównywalnych i konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wodę o pojemności 325ml spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak.

**Pakiet nr 32 poz. 15**

Zważywszy na fakt, minimalne opakowanie mikrometody do oznaczania OB. zawiera 50 szt., zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 50 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 32 poz. 17, 18**

Zważywszy na fakt, minimalne opakowanie mikrometody do hematologii i surowicy (poz. 17, 18) zawiera 100 szt., zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 100 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 32 poz. 19**

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowane igieł motylkowych zawiera 120 sztuk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 32 poz. 19**

Czy Zamawiający wymaga w poz. 19, igły motylkowej 0,8 z drenem 200 mm do pobierania krwi na posiew, po otwarciu gotowej do użycia?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w poz. 19, igły motylkowej 0,8 z drenem 200 mm do pobierania krwi na posiew.

**Pakiet nr 32 - warunki pkt. 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania etykiety wobec strzykawek (próbówko-strzykawek) do gazometrii w poz. 9 oraz mikropróbówek w poz. 15, 17 i 18.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 32 - warunki pkt. 6, 7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby wymagane gwarancje zostały złożone przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 32 - warunki pkt. 8**

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma złożyć po 1 szt. próbek do każdej pozycji?

Zarówno w treści SWZ jak i w warunkach opisanych w Formularzu cenowym Zamawiający nie określił ilości próbek.

Odpowiedź: Po 1 sztuce.

**Pakiet nr 32 - warunki pkt. 8**

Prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia próbek dla pakietu nr 32, ze względu na fakt iż w ww. postępowaniu nie jest oceniana jakość a produkty te znane są Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.

**Pytanie dot. projektu umowy - § 4 ust. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie dot. projektu umowy - § 8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku

VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 7 poz. 5**

Czy zamawiający dopuści przewodnice do rurek intubacyjnych dostępne w następujących rozmiarach:

| ROZMIAR | DLA RUREK INTUBACYJNYCH W ROZMIARZE |
|---------|-------------------------------------|
| 06 Fr   | 2.5-4.5 mm                          |
| 10 Fr   | 4.0-6.0 mm                          |
| 12 Fr   | 5.5-6.5 mm                          |
| 14 Fr   | 5.5-10.0 mm                         |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 7 poz. 6**

Czy zamawiający dopuści przewodnice Bougie w rozmiarze 15Fr (5,0 mm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 9 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rurą o długości 1,2m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 9 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy bez zatyczki zabezpieczającej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 9 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z zatyczką zabezpieczającą dołączoną osobno?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 13 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pakiet nr 13 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pakiet nr 13 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o martwej przestrzeni 70ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pakiet nr 13 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści łącznik o długości 15cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pakiet nr 13 poz. 6**

Czy zamawiający dopuści aparat do ćwiczeń oddechu o następujących parametrach:

- Urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu i bardzo efektywne. Redukuje ból, zwiększa przepływ powietrza przez płuca, powiększa pojemność płuc, pozwala na dokładniejszą wentylację organizmu
- Prowadzi do poszerzenia pęcherzyków płucnych i zwiększenia przepływu dróg oddechowych
- Urządzenie dokonuje pomiaru za pomocą trzech komór, na których przedziałki ukazują trzy różne wartości - 600, 900 oraz 1200cm<sup>3</sup>
- Wskazane objętości obrazują objętość wdychanego powietrza na sekundę



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 18 poz. 1**

Czy zamawiający oczekuje 55 000 sztuk myjek czy 55 000 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 55 000 sztuk.

**Pakiet nr 35 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 45 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 45 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy, mikrobiologicznie czyste, kompatybilne z systemem z pozycji 1?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 65 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści rurki z niewielką zawartością ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 66 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania w systemie zamkniętym o długości 300mm dla rurek tracheostomijnych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 66 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści potwierdzenie stosowania cewnika przez 72h w oryginalnej instrukcji obsługi dołączonej do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie stosowania cewnika przez 72h w oryginalnej instrukcji obsługi dołączonej do oferty.

**Pakiet nr 67 poz. 4**

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki Yankauer bez kontroli siły ssania oraz drenu o średnicy CH24 oraz długości 210cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 67 poz. 4**

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki Yankauer bez kontroli siły ssania oraz drenu o średnicy CH30 oraz długości 210cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 67 poz. 4**

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki Yankauer bez kontroli siły ssania oraz drenu o średnicy CH24 oraz długości 300cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 67 poz. 4**

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki Yankauer bez kontroli siły ssania oraz drenu o średnicy CH30 oraz długości 300cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 52 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe szczypce biopsyjne. Długość robocza 230 mm, średnica osłonki 2,3 mm, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm. Rozwarcie szczęk 6,7 mm oraz pojemność 7,7mm<sup>3</sup>. Łyzeczki owalne, z możliwością biopsji stycznej i możliwością otwarcia szczypiec w każdym zagięciu. Bez igły. Osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną PE i markerami sygnalizacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 52 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe szczypce biopsyjne. Długość robocza 180 i 230 cm. Średnica osłonki 2,3 mm. Rozwarcie szczęk 6,7 mm oraz pojemność 7,7mm<sup>3</sup>m. Współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm. Łyzeczki owalne i aligator z możliwością biopsji stycznej i otwarcia szczypiec w każdym zagięciu. Bez igły i z igłą. Osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną PE i markerami sygnalizacyjnymi

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 52 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowa pułapka jednokomorowa lub dwukomorowa do wyboru zamawiającego typu Wild Eye, Dren o długości 15 cm. Wielkość Pułapki 4cmx1,5cm. Każda pułapka wyposażona w szufladkę do wyjmowania biopatów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 19 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 sztuk w magazynek.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 19 poz. 3**

Czy Zamawiający w pozycji 3 wymaga użyczenia klipsownic laparoskopowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga użyczenia klipsownicy.

**Pakiet nr 47**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trokarów z zaworem dwustopniowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 47 poz. 2**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie trokarów 5,5 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 47 poz. 3**

Czy Zamawiający w pozycji 3 wymaga zaoferowania trokara o średnicy 12 mm z uszczelką do narzędzi od 5 do 12 mm.

Odpowiedź: Tak.

**Pakiet nr 52 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o rozwarciu szczęk 8,0 mm, o pojemności 9,5 mm<sup>3</sup>, pokrytych substancją poślizgową PTFE.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 19 poz. 1**

Czy Zamawiający w pak 19 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe z zamkiem niewchłaniające, rozmiar duży "L" o sugerowanym zakresie rozmiarów zamykanej tkanki magazynku, pakowane 1 magazynek=6 sztuk klipsów. Bezpłatne użyczenie klipsownicy Premium do chirurgii otwartej dł. 27cm 70° na czas trwania umowy. (1 mag.= 6szt.)? Klipsy pakowane po 4 sztuki w magazynku oferuje wyłącznie jedna firma i w związku z tym dowolnie może je wyceniać.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 19 poz. 2**

Czy Zamawiający w pak 19 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe z zamkiem rozmiar extra-duże "XL" o sugerowanym zakresie rozmiarów zamykanej tkanki, pakowane 1

magazynek=6 sztuki klipsów. Klipsy pakowane po 4 sztuki w magazynku oferuje wyłącznie jedna firma i w związku z tym dowolnie może je wyceniać. Bezpłatne użyczenie klipsownicy do zabiegów laparoskopowych do klipsów polimerowych niewchłaniających extra-dużych , śr. 10mm , dł. robocza 32,5-33cm na czas trwania umowy ( 1 mag. = 6 szt. ) ? Klipsy pakowane po 4 sztuki w magazynku oferuje wyłącznie jedna firma i w związku z tym dowolnie może je wyceniać.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pakiet nr 19 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie numerów referencyjnych obecnie używanych przez Szpital klipsownic przeznaczonych do współpracy z klipsami opisanymi w pak 19 poz 3. Nie ma na rynku klipsów spełniających opisane w SIWZ parametry.

Odpowiedź: Clip klipsy naczyniowe ML Grena Ltd 0301-06ML

### **Pakiet nr 20 poz. 1**

Czy Zamawiający w pak 20 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny jednorazowego użytku – zszywka o wymiarach 6,5x4,7mm, grubość 0,60 powlekanwe teflonem - 35 zszywek w magazynku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pakiet nr 20 poz. 2**

Czy Zamawiający w pak 20 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Narzędzie wielorazowego użytku do zdejmowania zszywki z numerem katalogowym i nazwą producenta na opakowaniu, wykonanym ze stali chirurgicznej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pakiet nr 52 poz. 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować jednorazowe szczypce biopsyjne. Długość robocza 230 mm, średnica osłonki 2,3 mm, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm. Rozwarcie szczęk ok. 7 mm oraz pojemność ok.8 mm<sup>3</sup>. Łyżeczki owalne z możliwością otwarcia szczypiec w każdym zagięciu. Bez igły. Osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pakiet nr 52 poz. 2**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować jednorazowe szczypce biopsyjne. Długość robocza 160 i 230 cm. Średnica osłonki 2,3 mm. Rozwarcie szczęk ok. 7,5 mm oraz pojemność ok. 8mm<sup>3</sup>m. Współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm. Łyżeczki owalne z możliwością otwarcia szczypiec w każdym zagięciu. Bez igły i z igłą. Osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

### **Pakiet nr 52 poz. 3**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować jednorazowa pułapka jednokomorowa dren o długości 15 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



**Pytanie dot. projektu umowy - § 3 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem zapisów ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający, niezależnie od uprawnień określonych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, ma prawo dokonania zakupu niedostarczonego towaru u innego dostawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu do wywiązania się z obowiązków umowy, a Wykonawca ....”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie dot. projektu umowy - § 4 ust. 8**

Prosimy o zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru w momencie dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt wadliwej części dostawy na towar wolny od wad w terminie 7 dni od dnia uznania zasadności złożonej reklamacji, w razie stwierdzenia wad jakościowych towaru w późniejszym czasie, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt wadliwej części dostawy na towar wolny od wad w terminie 7 dni od dnia uznania zasadności złożonej reklamacji”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie dot. projektu umowy - § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisów umowy poniższej treści:

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie dot. projektu umowy - § 8 ust. 1 a) i b)**

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,1%.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie dot. projektu umowy - § 8 ust. 1 c)**

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści gąbkę do toalety jamy ustnej bez zawartości dwuwęglanu sodu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 4 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 7 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o parametrach:

| ROZMIAR | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | DŁUGOŚĆ ROBOCZ | ROZMIAR RURKI  |
|---------|----------|-------------------|----------------|----------------|
| 6 Fr    | 2.0 mm   | 310 mm (±10)      | 250 mm (±5)    | od 2,0 do 4,0  |
| 10 Fr   | 3.3 mm   | 390 mm (±10)      | 350 mm (±5)    | od 4,5 do 6,5  |
| 14 Fr   | 4.7 mm   | 390 mm (±10)      | 355 mm (±5)    | od 7,0 do 10,0 |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 7 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę zakrzywioną w rozmiarach:

| ROZMIAR | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | ROZMIAR RURKI  | SKALOWANIE |
|---------|----------|-------------------|----------------|------------|
| 6 Fr    | 2,0 mm   | 535 mm            | od 2,0 do 4,0  | 10 – 45 cm |
| 10 Fr   | 3,3 mm   | 600 mm            | od 4,5 do 6,0  | 10 – 50 cm |
| 10 Fr   | 3,3 mm   | 800 mm            | od 4,5 do 6,0  | 10 – 60 cm |
| 15 Fr   | 5,0 mm   | 600 mm            | od 6,5 do 10,0 | 10 – 50 cm |
| 15 Fr   | 5,0 mm   | 800 mm            | od 6,5 do 10,0 | 10 – 60 cm |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m<sup>2</sup>. Sklasyfikowaną jako kosmetyk. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Opakowanie foliowe, pakowanie próżniowe zmniejszające objętość przechowywanych myjek. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za oferowane opakowanie handlowe z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 24 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 24 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni przylepnej 42 x 36 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 24 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni przylepnej 60 x 46 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 24 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni przylepnej 15 x 20 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 24 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni przylepnej 10 x 18 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 25 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę o rozmiarach 14 cm x 2,5 m lub 16 cm x 2,5 m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 29 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kieliszek w op. a'90 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 29 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 29 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 29 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'144 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 29 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z nakładaną pokrywą o wysokości 322, średnicy górnej 390 mm, oraz dolnej 322mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 29 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści staze wykonaną z termoplastycznego elastomeru o długości całkowitej 11,25m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 29 poz.10**

Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarach:

- 0,33x12,
- 0,30 x 8,
- 0,25 x 6,
- 0,25 x 8 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 45 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 45 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 53 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą i pojedynczą kryzą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 53 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na zagłówek w rozmiarze 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 54 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jałowe osłony na podłokietnik o wymiarach 75 x 35 cm zintegrowane 1 jedną taśmą przyklepną do stabilizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 55 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do bezpiecznego przetaczania płynów w terapii infuzyjnej, z możliwością utrzymania przez 24 godziny w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji. Przyrząd został wykonany z wysokiej jakości materiałów. Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami. Wyposażony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml. Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 10 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu. Miękki i elastyczny dren o długości min. 180cm z dodatkowym portem do podawania leków. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia. Uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz

zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Nie zawiera lateksu oraz ftalanów. Sterylizowany tlenkiem etylenu.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pakiet nr 55 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pakiet nr 55 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy o parametrach:

- Przezroczysta obudowa wykonana z poliwęglanu
- Niebieska silikonowa membrana umożliwia wielokrotną aplikację portu
- Membrana dostosowana do standardowych złączy luer i luer lock
- System podzielnej membrany umożliwia prosty tor przepływu
- Obrotowy łącznik luer lock gwarantuje w pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Dren wykonany z PVC
- Dwie średnice drenów: 1,2 x 2,5 mm oraz 3,0 x 4,1 mm, długość całkowita 21 cm
- Zacisk ślizgowy na każdym przedłużaczu
- Czas użytkowania 7 dni lub 140 aktywacji
- Odporny na działanie lipidów
- Bez lateksu
- Bez ftalanów
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie: papier/folia



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 55 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z PVC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 55 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową wykonaną z PVC, z częścią przezroczystą o długości 55 mm, z igłą biorczą ściętą 4-płaszczyznowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 65 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną o właściwościach:

- Wykonana z elastycznego PVC
- Zbrojenie na całej długości rurki
- Zawiera przewodnicę
- Znacznik RTG na całej długości rurki
- Wyposażona w boczny otwór Murphy'ego
- Skalowanie co 1 cm
- Podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki
- Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)
- Uniwersalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm
- Nie zawiera lateksu
- Jednorazowa
- Sterylizowana tlenkiem etylenu

▪ Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 68 poz. 1, 2, 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści pojedynczą skalę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obwody z trójnikiem bez portów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obwody niesterylne w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 9 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 9 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści linię 260 cm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 13 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości własnej 54 ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 13 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o właściwościach filtracji elektrostatycznej z barierą mechaniczną w postaci wymiennika ciepła i wilgoci?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 13 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści łącznik 15mmM – 22mmM/15mmF?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 13 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści łącznik 22mmF – 22mmM/15mmF?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 13 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści podkładkę niesterylną?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 28**

Prosimy o podanie numeru katalogowego pułapek obecnie stosowanych przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

Odpowiedź: PUŁ-05240- PUŁAPKI NA POLIPY

PUŁ-09018- Pułapka wodna Dryline II 115-043024-00-1

#### **Pakiet nr 72**

Czy Zamawiający dopuści czujniki dla pacjentów >40 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pakiet nr 28**

Prosimy o podanie numeru katalogowego pułapek obecnie stosowanych przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

Odpowiedź:

PUŁ-05240- PUŁAPKI NA POLIPY

PUŁ-09018- Pułapka wodna Dryline II 115-043024-00-1

#### **Pakiet nr 45 poz. 1**

Mając na uwadze zaoferowanie zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o szerszych parametrach niż oczekiwał Zamawiający, czy zamawiający dopuści system zgodnie z parametrami jak poniżej:

Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego:

1. Zestaw składający się z przewodu cewnika, worka odbiorczego, strzykawki 50 ml, strzykawki z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora zapachów.
2. System bez elementów wykonanych z naturalnego lateksu
3. Skład opakowania zestawu:
  - Worek odbiorczy 1l. (1 szt.)
  - Strzykawka 50 ml
  - Strzykawka z żelem smarującym (10 ml)
  - Instrukcja użycia
  - 1 buteleczka (30 ml) preparatu Medi-aire™ Biologiczny eliminator zapachów
  - Zacisk na przewody
4. Zestaw przewodu cewnika składa się z: trzon cewnika i worek odbiorczy wykonane w większości z kopolimeru Permalene, połączonych z niskociśnieniowym mankietem mocującym i strefą przechodzącą przez zwieracz, wykonanych głównie z silikonu.
5. Otwór przewodu cewnika w obrębie mankieta ma kształt lejka w celu ułatwienia kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej min 1.34 in<sup>2</sup>, max 1,4 in<sup>2</sup>
6. Przewód odprowadzający wyposażony w cztery porty, każdy z oddzielnym dostępem.
  - Zielony port do napełniania („INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) jest przeznaczony do napełniania/oprózniczenia mankieta.
  - Przezroczysty port irygacji („IRRIG”) służy do wprowadzania wody na końcu mankieta mocującego i umożliwia dostęp do podawania leków.
  - Fioletowy port do przepłukiwania („FLUSH”) jest stosowany do wlewu wody przez szczeliny na całej długości przewodu odprowadzającego w celu ułatwienia odprowadzania stolca.
  - Port do pobierania próbek na przewodzie odprowadzającym umożliwia pobieranie próbek stolca przy użyciu strzykawki z wsuwaną końcówką
7. Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza i zaworu tłoczkowego



8. System zarządzania stolcem wyposażony w mechanizm samozamykania aby zminimalizować kontakt na działanie szkodliwych mikroorganizmów podczas zmiany worków.

9. Przewód odprowadzający wyposażony w zintegrowany, łatwy w użyciu port do pobierania próbek kawy zmniejszający możliwość zanieczyszczenia podczas pobierania próbek

10. Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pakiet nr 45 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści worki kompatybilne z proponowanym systemem do zbiórki stolca zgodnie z parametrami jak poniżej :

Worek odbiorczy :

- Wymienny worek odbiorczy pojemność 1000 ml., skalowany od 50 ml co 100 ml, kompatybilny z proponowanym systemem do zbiórki stolca.

- Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie dot. projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### **Pakiet nr 9 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego światowego producenta, stosowanego z powodzeniem w wielu szpitalach w Polsce:

Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 63**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły dopęcherzowej do podawania botuliny o długości igły 4 mm, zapewniającej idealną długość wkłucia, z zabezpieczeniem redukującym ryzyko perforacji pęcherza oraz systemem z nasadką chroniącą kanał roboczy cystoskopu przed uszkodzeniem. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 71**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór ma nie wywoływać refluksu krwi do światła cewnika, czyli ma posiadać neutralne ciśnienie przy odłączaniu od zaworu końcówki luer?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 71**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór bezigłowy ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki? Pragniemy nadmienić, iż mniej drobnoustrojów transferowanych do wnętrza zaworu i dalej do światła cewnika, a w konsekwencji do organizmu pacjenta z obniżoną odpornością, tym mniejsze ryzyko zakażenia odcewnikowego i możliwość dłuższego utrzymania drożnego wkłucia oraz zmniejszenie kosztów leczenia.

Odpowiedź: Zawór bezigłowy ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki.

**Pakiet nr 24 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultracienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m<sup>2</sup>/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze : karton 15 szt..

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 24 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultracienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m<sup>2</sup>/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze : karton 15 szt..

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 24 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultracienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym

wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min.  $670 \pm 50 \text{ g/m}^2/24\text{h}$ ); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 15x20cm (całkowita 20x20cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze : karton 15 szt..

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 24 poz. 1-3**

Prosimy o potwierdzenie, że w celu zapewnienia skuteczności środka bakteriobójczego Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych pakowanych w folię aluminiową, sterylizowanych radiacyjnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pakiet nr 24 poz. 1-3**

Prosimy o potwierdzenie , czy Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych klasyfikowanych jako klasa III?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pakiet 25, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej osłony na przewody medyczne o rozmiarze 13x240cm pakowane po 1 sztuce. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 16**

Bardzo prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co ma na myśli wymagając przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnień 1 i 2 przetworników? Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przetworników pojedynczych i podwójnych? Jeżeli tak to bardzo prosimy o podanie ile Zamawiający będzie wymagał przetworników pojedynczych, a ile sztuk podwójnych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przetworników pojedynczych i podwójnych. Pojedynczych 100 sztuk, a podwójnych 20.

**Pakiet nr 16**

Bardzo prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu użyczenia 9 szt. kabli na okres trwania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 16**

Bardzo prosimy Zamawiającego o udostępnienie zdjęcia kabla, który wykonawca będzie musiał użyczyć na czas trwania umowy kompatybilnych z monitorem BeneView T8 Mindray.

Odpowiedź:



**Pakiet nr 16**

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?


Connectors available



Odpowiedź: Zgodnie z przestany zdjęciem.

**Pakiet nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:

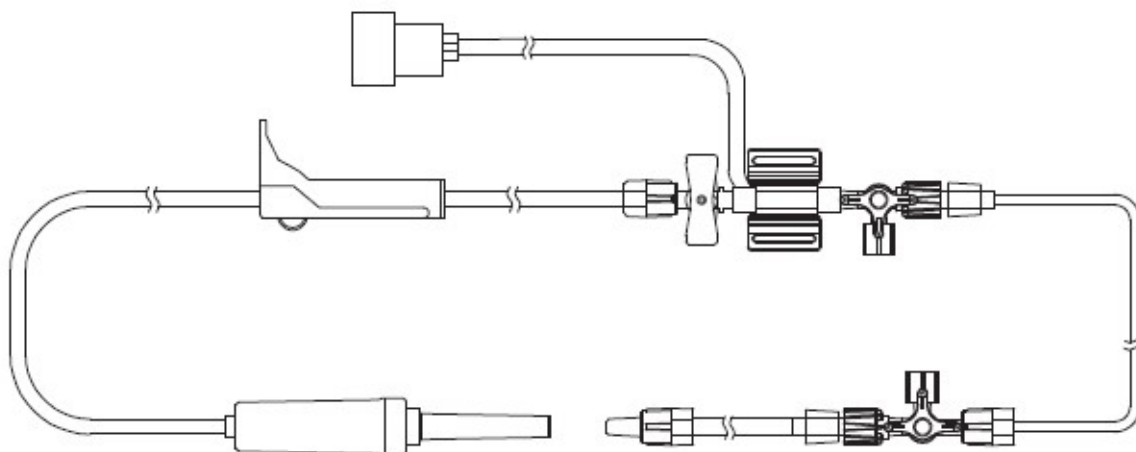

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pakiet nr 56**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 56, poz. 15 pętle elektrochirurgiczne, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm, oraz 15mm do wyboru zamawiającego. Pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie do SWZ**

Prosimy o informację na temat minimalnego i maksymalnego terminu dostawy oferowanych wyrobów jakie Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu.

Po przeanalizowaniu zapisów SWZ i projektu umowy nie znajdujemy tam informacji na ten temat.

Odpowiedź: Do 5 dni roboczych.

#### **Pakiet nr 18**

Czy zamawiający wymaga aby informacja o hypoalergicznosci żelu zawartego w gąbkach znajdowała się na każdym pojedynczym opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Do projektu umowy**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 8 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 8 ust. 1A wskazał: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

a) zwłoki w dostarczaniu towaru w wysokości 1 % wartości brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki,

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 1% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 1% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”.W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 8 ust 1A wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5% wartości .

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 23:**

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisów SWZ w postępowaniu nr DZP.2344.49.2022 w pakiecie 23 część 1 proszku hemostatycznego pochodzenia roślinnego o gramaturze 1g w celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania produktu o tym samym zastosowaniu klinicznym dla Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 23:**

W ramach pakietu 23 części 1 – Zamawiający oczekuje zaoferowania 2 opakowań handlowych zawierających 5 szt w każdym opakowaniu, tj. łącznej ilości 20g produktu. Wnosimy o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i tym samym zaoferowanie 4 opakowań handlowych – (opakowanie zawiera 5 szt produktu - każdy osobno pakowany ).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 23:**

Prosimy o wskazanie ilości wymaganych w zakresie pakietu nr 23 próbek.

Odpowiedź: Po 2 próbki.