



**D.25C/250/ 680 /2023**

**wg rozdzielnika**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/252/N/21-59rj/23**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.3** - Czy Zamawiający dopuści możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży:

- leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków,
- żywienia pozajelitowego
- leków światłoczułych,
- krwi i preparatów krwiopochodnych

Bez możliwości podaży żywienia dojelitowego? Producent posiada specjalną pompę dopasowaną do żywienia dojelitowego aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i wykluczyć błąd podania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**2. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.4** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę posiadającą bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną umożliwiającą szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**3. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym czytelnym graficznym wyświetlaczem LCD o wymiarach 70 mm x 35 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**4. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.12** – Czy Zamawiający dopuści zakres szybkości dozowania 0,1 – 1500 ml/h dający większe możliwości infuzji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**5. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.14** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/ kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m2/h, mg/m2/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**6. Zapytanie Wykonawcy:**



**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.15** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową zawierającą następujące tryby : tryby w ml/h: Objętość + Szybkość Przepływu, Objętość + Czas, Szybkość Przepływu + Czas, Objętość + Czas + Szybkość Przepływu, Wzrastająco / Malejąco, Sekwencyjnie / Okresowo, Krople/min?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**7. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.16** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z ekranem infuzji z możliwością jednoczesnego wyświetlania:

- nazwy leku,
- stężenia(koncentracja)
- szybkość infuzji
- informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecany zakres lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego,
- dawki,
- prędkości przepływu infuzji,
- nazwy oddziału,
- aktualnego ciśnienia w formie graficznej

stan naładowania akumulatora?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**8. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz. 17** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową bez możliwości podaży żywienia dojelitowego? Producent posiada specjalną pompę dopasowaną do żywienia dojelitowego aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i wykluczyć błąd podania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**9. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.20** – Czy Zamawiający dopuści pompę z systemem zabezpieczającym „Antybolus”, który znacznie zmniejsza bolus po usunięciu okluzji (maksymalnie 0,35 ml)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**10. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.21** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z możliwością wgrania biblioteki leków z możliwością zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z:

- nazwy leku,
- 5 stężeń(koncentracja) lub zakres
- szybkości dozowania (dawkowanie),
- całkowitej objętości (dawki) infuzji, -parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej,
- limitów dla wymienionych parametrów infuzji:
  - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów,
  - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu,
- notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji,

Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym na 19 profili. Wybór oddziału dostępny w pompie. Zawierającą 2850 leków?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



**11. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.24-25** – Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia okluzji na 19 poziomach, progi ciśnienia w zakresie 50 - 750 mmHg?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie w zakresie ilości poziomów regulacji ciśnienia okluzji. W zakresie progów ciśnienia Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**12. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.26** - Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i terapii, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej z możliwością zmiany progu ciśnienia okluzji po zatrzymaniu infuzji i ponownym zatwierdzeniu parametrów ze wskaźnikiem ciśnienia widocznym na wyświetlaczu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**13. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.30** – Czy Zamawiający dopuści wysokość pompy 13,5 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**14. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.36** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową z historią infuzji 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**15. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.39-40** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową z czasem pracy z akumulatora pow. 8 h przy 25 ml/h, z czasem ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 6h?


**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**16. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

**Poz.45** - Czy Zamawiający dopuści stojak wykonany ze stali nierdzewnej i zaprojektowany specjalnie do montażu stacji dokujących wraz z 8 pompami – obciążenie maksymalne 25 kg? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

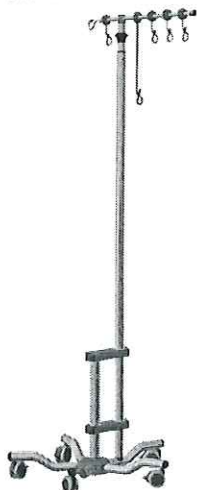



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**17. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania jedynie głowicy ultrasonograficznej, a nie pełnego zestawu zawierającego głowicę ultrasonograficzną wraz z urządzeniem obrazującym (tabletem).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zaoferowania głowicy ultrasonograficznej wraz z urządzeniem obrazującym (tabletem).

**18. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 3 punkt 24.**

Czy Zamawiający poprzez parametr „szerokość czoła głowicy”, rozumie: szerokość pola widzenia głowicy i dopuści głowicę ultrasonograficzną, której szerokość pola widzenia wynosi 34,5 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**19. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ UMOWA nr znak: D25C/252/N/21-59rj/23 (PROJEKT UMOWY), § 1 PRZEDMIOT UMOWY, ust.2, pkt a), b), c), d), Zadanie 3 Mobilny, przenośny ultrasonograf**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności instalacji i przeszkolenia personelu Zamawiającego oraz obowiązkowych przeglądów technicznych.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z dokumentem fabrycznym Producenta urządzenia oferowany przez Wykonawcę produkt jest instalowany samodzielnie przez użytkownika. Użytkowanie aparatu nie wymaga instalacji oraz instruktażu, a wszelkie materiały dotyczące użytkowania są dostępne na stronie internetowej dedykowanej urządzeniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W zakresie instalacji i przeszkolenia personelu Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**20. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ UMOWA nr znak: D25C/252/N/21-59rj/23 (PROJEKT UMOWY) § 2 CENA, ust. 3, Zadanie 3 Mobilny, przenośny ultrasonograf**

Prosimy o modyfikację § 2 CENA, ust. 3 zgodnie z poniższym:

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty: opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu, przekazania nieograniczonej czasowo licencji na oprogramowanie służące do eksploatacji sprzętu i jego akcesoriów (jeżeli licencja jest konieczna) oraz uwzględnia wszelkie rabaty, upusty i marże.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z dokumentem fabrycznym Producenta urządzenia oferowany przez Wykonawcę produkt jest instalowany samodzielnie przez użytkownika. Użytkowanie aparatu nie wymaga instalacji oraz instruktażu, a wszelkie materiały dotyczące użytkowania są dostępne na stronie internetowej dedykowanej urządzeniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**21. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ UMOWA nr znak: D25C/252/N/21-59rj/23 (PROJEKT UMOWY), § WARUNKI REALIZACJI UMOWY, ust. 8, a), Zadanie 3 Mobilny, przenośny ultrasonograf**

Prosimy o rezygnację z konieczności przekazania paszportu technicznego, gdyż zgodnie z z dokumentem fabrycznym Producenta urządzenia oferowany przez Wykonawcę produkt nie wymaga wykonywania okresowych przeglądów przez autoryzowany serwis.

**Odpowiedź Zamawiającego:**





Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie. W związku z powyższym Zamawiający po podpisaniu umowy, oczekuje przedstawienia potwierdzonej informacji o braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów.

**22. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ UMOWA nr znak: D25C/252/N/21-59rj/23 (PROJEKT UMOWY), § WARUNKI REALIZACJI UMOWY, ust. 7, Zadanie 3 Mobilny, przenośny ultrasonograf**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności i przeszkolenia personelu Zamawiającego i usunięcie ust. 7.

**Uzasadnienie:**

Oferowany przez Wykonawcę przenośny aparat USG nie wymaga specjalistycznego szkolenia w zakresie użytkowania. Montaż oraz pierwsze uruchomienie odbywa się we własnym zakresie.

Wykonawca dysponuje filmami instruktażowymi dostępnymi na stronie internetowej.

W przypadku utrzymania zapisów umowy, koszty związane z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem zostaną uwzględnione w ofercie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**23. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ UMOWA nr znak: D25C/252/N/21-59rj/23 (PROJEKT UMOWY), § 8 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA JAKOŚCI, SERWIS W OKRESIE GWARANCJI , ust. 6, Zadanie 3 Mobilny, przenośny ultrasonograf**

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ust. 6, gdyż zgodnie z z dokumentem fabrycznym Producenta urządzenia oferowany przez Wykonawcę produkt nie wymaga wykonywania okresowych przeglądów przez autoryzowany serwis.

Wszelkie przewidywane czynności konserwacyjne i sprawdzające mogą być wykonywane przez użytkownika, są one opisane w instrukcji obsługi urządzenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**24. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ UMOWA nr znak: D25C/252/N/21-59rj/23 (PROJEKT UMOWY), Zadanie 3 Mobilny, przenośny ultrasonograf**

Wykonawca wnosi o usunięcie z § 4 ust. 6, § 6 ust. 2 i § 7 ust. 1 Projektu umowy sformułowań „bez zastrzeżeń” lub „bez uwag i zastrzeżeń”. Umowa nie przewiduje bowiem dalszego, szczególnego sposobu postępowania w przypadku podpisania protokołu z uwagami/zastrzeżeniami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**25. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ UMOWA nr znak: D25C/252/N/21-59rj/23 (PROJEKT UMOWY), Zadanie 3 Mobilny, przenośny ultrasonograf**

Wykonawca wnosi o usunięcie § 7 ust. 2 z projektu umowy jako uzależniającego podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego, a w konsekwencji wypłatę wynagrodzenia przez Zamawiającego od zrzeczenia się przez Wykonawcę wszelkich znanych mu roszczeń. Podkreślić należy, że tego typu postanowienie rażąco faworyzuje Zamawiającego, ponieważ bardzo ogranicza, a niemalże pozbawia, Wykonawcę możliwości dochodzenia innych roszczeń, które potencjalnie przysługiwałyby mu w związku z Umową, poza wynagrodzeniem. Tego rodzaju postanowienie umowne będzie musiało zostać uwzględnione przez wykonawców jako istotne ryzyko prawne, co niewątpliwie przełoży się na wyższe ceny ofertowe.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**26. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ UMOWA nr znak: D25C/252/N/21-59rj/23 (PROJEKT UMOWY), Zadanie 3 Mobilny, przenośny ultrasonograf**



Wykonawca wnosi o zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 50% łącznej wartości przedmiotu umowy. Obecny limit 70% skrajnie faworyzuje Zamawiającego jako stronę umowy. Tego rodzaju postanowienie umowne będzie musiało zostać uwzględnione przez wykonawców jako istotne ryzyko prawne, co niewątpliwie przełoży się na wyższe ceny ofertowe.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych do 50%.

**27. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ UMOWA nr znak: D25C/252/N/21-59rj/23 (PROJEKT UMOWY), Zadanie 3 Mobilny, przenośny ultrasonograf**

Wykonawca wnosi o zmianę § 9 ust. 1 pkt. 3 poprzez usunięcie możliwości naliczenia kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego – w opinii Wykonawcy obecne postanowienia umowne i przepisy prawa nie przewidują bowiem możliwości takiego odstąpienia przez Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**28. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 2: Respirator**

Prosimy o doprecyzowanie:

- jakiego typu wtyków gazowych tlenu, powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga wtyków typu AGA.

**29. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 2: Respirator**

Pkt 107 Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator umożliwiający wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu, płci a także wagi pacjenta?

Umożliwia to pozyskanie większej liczby informacji o pacjencie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**30. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 2: Respirator**

6Czy w zakresie Zadania nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zdefiniowanie terminu dostawy na 6 tygodni od daty zawarcia umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**31. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 1: Aparat do znieczulenia**

Czy w zakresie Zadania nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zdefiniowanie terminu dostawy na 6 tygodni od daty zawarcia umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**32. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 1: Aparat do znieczulenia**

Prosimy o doprecyzowanie:

- jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający.

- odciągu gazów – czynny (w kolumnie/listwie) czy pasywny (bierny); w przypadku odciągu czynnego - jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II ( Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający.

- jakiego typu przetworników krwawego ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, będzie wymagał Zamawiający.





**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga wtyków typu AGA, odciążu gazów – czynny (w kolumnie/listwie) - typ wtyku odciążu gazów poanestetycznych: AGSS AGA; typu przetworników krwawego ciśnienia – ICU MEDICAL.

**33. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 1: Aparat do znieczulenia**

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wlewu parownika do sevofluranu: QF Abbvie czy STS Baxter, będzie wymagał Zamawiający.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga typu wlewu parownika do sevofluranu: STS Baxter.

**34. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 1: Aparat do znieczulenia**

Prosimy o odpowiedź jaki rodzaj odciążu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia:

- bierny odciąż lub brak instalacji odciążu
- czynny odciąż o dużym przepływie instalacji odciążu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2
- czynny odciąż o małym przepływie instalacji odciążu

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający na stanowisku na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia posiada czynny odciąż o dużym przepływie instalacji odciążu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2.

**35. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy SWZ / Przedmiotowe środki dowodowe (1.7)**

Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia katalogów/materiałów informacyjnych zawierających numery katalogowe oferowanych produktów. Numery katalogowe podlegają częstym zmianom i w związku z tym nie są elementem ujętym w treści materiałów informacyjnych opracowanych przez producenta urządzeń medycznych. Pozostawienie wymagania w obecnym kształcie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia numerów katalogowych w folderach czy materiałach źródłowych producenta

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**36. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy SWZ / Przedmiotowe środki dowodowe (1.7)**

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia Wykonawcy lub dystrybutora, albowiem takie oświadczenie jest integralną częścią SWZ jako załącznik nr 6 do SWZ, natomiast dopuszcza oświadczenie producenta oferowanego sprzętu, które to oświadczenie potwierdzi konkretnie oferowane parametry, które nie są potwierdzone w pozostałych dokumentach.

**37. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 2 ppkt b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego wymogu lub modyfikację w taki sposób, że szkolenie personelu będzie dotyczyło obsługi sprzętu i aplikacji medycznych niezbędnych do eksploatacji urządzenia? Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów, regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za używanie respiratorów oraz aparatów do znieczulenia i kardiomonitorów, a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników **autoryzowanego serwisu**. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia są urządzeniami, których używanie



ma szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie ich napraw i przeglądów serwisowych wymaga zaawansowanego przeszkolenia przez producenta.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**38. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 5**

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte:

- a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
  - eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
  - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
  - Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**39. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 10**

Z uwagi na specyfikę opisanego sprzętu medycznego czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprzęt zastępczy był dostarczony do siedziby Zamawiającego na naprawę dłuższą niż 4 dni robocze?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**40. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 11**

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

*„Kaźda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**41. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 18**

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmiami w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmiami, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmiami zostaje wyłączone:

*„(...) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmiami”.*

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku





wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękopis wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękopis, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**42. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 ppkt 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,2% wartości urządzenia, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**43. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 ppkt 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**44. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 ppkt 4) „maksymalna wysokość kar”**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalna łączna wysokość kar nie mogła przekroczyć 20% łącznej wartości przedmiotu umowy w odniesieniu do poszczególnych zadań?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych do 50%.

**45. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie osobnych umów w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie w postępowaniu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**46. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 5. Załącznik nr 6 do SWZ Dotyczy części: **PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** w ramach doprecyzowania powstałej omyłki pisarskiej, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie nazwy zadania 5: Z nazwy: „Zadanie 5 Aparat do znieczulenia CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne” Na nazwę: „Zadanie 5 Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne” Załącznik nr 1 - wycinek

**Zadanie 5**

**Aparat do znieczulenia**

CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

**Zestaw 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp**

CPV: 33100000-1

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nastąpiła omyłka pisarska i w zadaniu 5 wymaga zaoferowania zestawu 8 pomp objętościowych i 6 statywów do stacji i pomp.



Wykonawca oferując asortyment o dopuszczonym parametrze odmiennym od zapisanego pierwotnie w SWZ jest zobowiązany podać tę informację w załączniku nr 6 do SWZ w odpowiedniej rubryce, powołując się na nr nn pisma.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

**KOORDYNATOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

  
*mgr Monika Klause*