



## SEKCJA ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Łódź, 17.11.2023 r.

**e-mail: [marta.kieras@barlicki.pl](mailto:marta.kieras@barlicki.pl)**

**Tel. 42 677-68-24**

**Znak sprawy: 128/PN/ZP/D/2023**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „W związku z modernizacją Oddziału Klinicznego Okulistyki z odcinkiem dla Dzieci dostawa sprzętu medycznego. Cz. II”**

**Szanowni Państwo!**

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

### **Pytanie 1**

#### **dotyczy pakietu nr 1**

dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie lampy szczelinowej o poniższych parametrach:

- Lampa szczelinowa z dedykowanym torem wizyjnym
- Typ Haag-Streit
- Pięć powiększeń: 6,3x, 10x, 16x, 25x, 40x
- Okulary 12,5x
- Kąt między okularami 10°
- Regulacja dioptrii -8D - +8D
- Pole widzenia: 40x (5.7mm), 25X (8.9mm), 16X (14mm), 10X (22.3mm), 6x (36.2mm)
- System optyczny biomikroskopu HD
- Regulacja rozstawu okularów: 52-80mm
- Szerokość szczeliny: 0-14mm, regulowana płynnie
- Długość szczeliny: 1-14mm
- Pochylenie szczeliny: 5°, 10°, 15°, 20°
- Kąt szczeliny 0-180° (regulowany w pionie i poziomie)
- Wbudowane filtry: pochłaniający ciepło, neutralnej gęstości, bezczerwienny, kobaltowy niebieski, wbudowany filtr żółty
- Oświetlenie: LED
- podbródek regulowany: ruch pionowy 80 mm
- Wygodny szeroki przycisk wyzwalania fotografii znajdujący się w podstawie lampy w pobliżu joysticka (umożliwiający obsługę joysticka i przycisku jedną ręką)
- Regulacja jasności w podstawie lampy
- Dodatkowy oświetlacz do badania gruczołów Meiboma
- Automatyczne wykrywanie pozycji podstawy lampy: oko prawe/oko lewe
- Regulacja przesłony (głębi ostrości), automatyczny balans bieli
- W zestawie dedykowane oprogramowanie producenta
- Stolik regulowany elektrycznie pod urządzenie

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie 2**

#### **Pytanie dotyczące zadania nr 4 punkt 13**

Czy Zamawiający dopuści lampę, która posiada 16 diod LED? Liczba diod LED nie ma wpływu na parametry świetlne. Pozostałe parametry lepsze od wymaganych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 16-ledową lampę. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Zamawiający nie ma informacji o pozostałych oferowanych parametrach sprzętu.**

### **Pytanie 3**

#### **Pytania do Pakietu Nr 2 –TONOMETR PNEUMATYCZNY**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie, które zamiast systemu Clair posiada specjalną mechaniczną konstrukcję dyszy, która w redukuje hałas i intensywność powietrza wypychanego przez co pacjent w mniejszym stopniu odczuwa ciśnienie podmuchu pomiarowego.?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 4****Pytania do Pakietu Nr 2 –TONOMETR PNEUMATYCZNY**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie, w którym automatyczna regulacja ciśnienia (APA) nowi nazwę własną APC - automatic puff control?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 5****Pytania do Pakietu Nr 2 –TONOMETR PNEUMATYCZNY**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z zakresem pomiarowym:

- ciśnienie: 1-60 mmHg
- grubość rogówki: 300-800  $\mu\text{m}$ .

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 6****Pytania do Pakietu Nr 2 –TONOMETR PNEUMATYCZNY**

Czy Zamawiający w pakiecie wyrazi zgodę na stolik pod urządzenie o następujących parametrach:

- wymiarach blatu 580x470x25
  - regulacja blatu w zakresie 670 – 860 mm
  - minimalna wysokość kolumny 550 mm
- pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 7****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym długość impulsu wynosi 3ns?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 8****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym energia wiązki wynosi:

- pojedynczy impuls 0.3-10 mJ
- podwójny impuls 0.6-18,0 mJ
- potrójny impuls 0.9-24,0 mJ

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 9****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym maksymalna energia wiązki wynosi 24mJ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 10****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający w pakiecie 3 załącznik 1a3 zintegrowany laser wyrazi zgodę na urządzenie w którym średnica plamki wynosi 8  $\mu\text{m}$  ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 11****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym zmiana energii wiązki SLT następuje w w sposób skokowy: 0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.5;2.0;2.5;3.0 mJ

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 12****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym maksymalna energii wiązki SLT wynosi 3 mJ ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 13****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym kąt stożka wynosi 5,5 stopnia +/-1stopień?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**



**Pytanie 14****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym powiększenia lampy szczelinowej wynoszą 5x, 8x, 12.5x, 20x, 32x?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 15****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym lampa szczelinowa zamiast lusterka V posiada alternatywne rozwiązanie konstrukcyjne polegające na schowaniu/obniżeniu wieżyczki dające możliwość uzyskania koaksjalnej wiązki promieniowania lasera i oświetlenia lampy?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 16****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie wyposażone w panel LCD o przekątnej 5,7", umieszczenie po obu stronach?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 17****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym zamiast pokręteł po obu stronach zastosowany został przełącznik w joysticku typu „smart switch” pozwalający bez puszczenia joysticka na:

- podnoszenie i obniżanie energii impulsu
- przełączanie trybu gotowości i StandBy
- ogniskowanie w przód i w tył
- tryb serii impulsów
- start/zatrzymanie rotacji wiązki celowniczej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 18****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie wyposażone w port USB do kalibracji i serwisu stacjonarnego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 19****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym moc lasera żółtego wynosi 50-1500mW?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 20****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym laser żółty wyposażony jest w dwa tryby: ciągły i LPM - Low Power Mode równoważny z mikropulsami oraz interfejs z oddzielnymi trybami dla trybów CW i LPM?

**Odpowiedź:**

**Pytanie 21****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym czas trwania impulsu lasera żółtego wynosi: 0,01-3000 ms oraz 0.01-0.5 ms?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 22****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym interwał impulsu lasera żółtego wynosi: 0,05-1000 ms?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 23****Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie laser żółty o wymiarach 23,7x31,8x9cm i wadze 5,6kg?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 24**

**Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie laser żółty z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym z możliwością odłączenia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 25**

**Pytania do Pakietu Nr 3 – Zintegrowany laser do realizacji zabiegów w zakresie odcinka przedniego oraz tylnego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie laser żółty bez walizki transportowej.?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 26**

**PAKIET 4**

**Lampa operacyjna stojąca:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o wskaźniku oddawania barw (Ra/R9/R13) 98/90/100, Producent zastrzega tolerancje dla wszystkich wartości  $\pm 5\%$ ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 27**

**PAKIET 4**

**Lampa operacyjna stojąca:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną ze źródłem światła w postaci diod LED nowej generacji o bardzo wysokiej bezcieniowości posiadających 15 diod.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 28**

**PAKIET 4**

**Lampa operacyjna stojąca:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną, w której pobór mocy wynosi 24VA, parametr nieznacznie się różni od wymaganego

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 29**


**PAKIET 4**

**Lampa operacyjna stojąca:**

Czy Zamawiający dopuści lampę o regulacji oprawy w postaci ramienia uchylnego: regulacja odległości lampy od podłogi od 1 metra do ponad 2 metrów i więcej.



A = 720 mm  
B = 1.750 mm  
C = 560 mm  
D = 560 mm

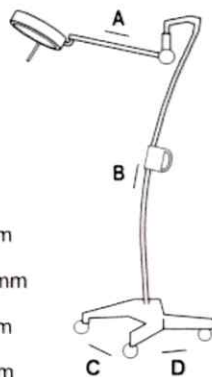

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 30**

**PAKIET 4**

**Lampa operacyjna stojąca:**

W jakim celu dostawca lampy ma dostarczyć wkładkę topikową WTA-T 500 mA?

**Odpowiedź: W celu zabezpieczenia ciągłości pracy gabinetu zabiegowego. Części zamienne powinny być na miejscu, aby nie wydłużyć się czas naprawy.**

Z poważaniem

p.o. Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia Medycznego  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1  
im. N. Barlickiego w Łodzi  
  
mgr Anna Pietrzyk