

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®] ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/28/2022
	Dostawa łóżek anestezyjologicznych - szt.4	

Elbląg, dnia 24.10.2022r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę łóżek anestezyjologicznych - szt.4. Nr sprawy ZP/28/2022

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie nr 1

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 230V bez wskaźnika informującego o podłączeniu do sieci?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 2

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu bez wskaźnika naładowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 3

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego wskaźnika informującego o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 4

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość zewnętrzną 2220 mm (+- 10 mm)?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 5

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję manualnego przedłużania leża o 300 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 6

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szerokość zewnętrzną 1010 mm (+- 10 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 7

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na szczelnych kolumnach o przekroju prostokątnym?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 8

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment oparcia pleców wypełniony płytą umożliwiającą wykonywanie zdjęć RTG, segment uda i podudzia wypełnione odczepianymi płytami HPL, z systemem zatrząskiwania, segment miednicy wypełniony płytą HPL zamocowaną na stałe, płyty wyposażone w otwory wentylacyjne, płyty HPL przezierny dla promieni RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 9

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment pleców wyposażony w prowadnicę z tacą kasety RTG, możliwość wykonywania zdjęć zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej pacjenta, taca kasety wsuwana od strony szczytu głowy pacjenta (tzw. pozycjonowanie pionowe) pod segmentem oparcia pleców?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 10

1

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®] ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/28/2022
	Dostawa łóżek anestezjologicznych - szt.4	

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego alarmu niewłaściwie umieszczonej lub wsuniętej tacy na kasetę RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 11

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego barierki boczne o wysokości 43 cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych, czy też innych rozwiązań klinicznych pozostawiające bezpieczną wysokość od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierki - wymóg bezpieczeństwa dyktowany przez normę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 12

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym podudzie jest regulowane za pomocą sprężyny gazowej, a funkcja przedłużania leża jest regulowana manualnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 13

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego sterowanie elektryczne przy pomocy:

- zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierki bocznych dla pacjenta oraz po zewnętrznej stronie dla personelu
- 2 sterowników nożnych zabezpieczonych przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół, sterowniki zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem poprzez konieczność uniesienia stopą blokady zabezpieczającej, sterowniki po obu stronach leża do regulacji wysokości leża oraz przechyłów bocznych leża
- panel sterowniczy dla personelu posiadający dotykowy ekran LCD służący do zarządzania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka oraz do zarządzania systemem pomiaru masy ciała pacjenta, dotykowy ekran LCD zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta, posiadający możliwość ustawienia kąta nachylenia w celu zwiększenia komfortu pracy personelu
- pilota przewodowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 14

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 500 mm do 900 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 15

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment pleców nie wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania podczas regulacji w pozycji 30° oraz 45°?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 16

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców znajdujące się na barierkach bocznych od wewnętrznej i zewnętrznej strony z wyraźnym zaznaczeniem kąta 0°, 30°, 60° - wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierki oraz wskaźniki kąta nachylenia pozycji Trendelenburga oraz anti-Trendelenburga znajdujące się na barierkach bocznych od strony wewnętrznej i zewnętrznej z wyraźnym zaznaczeniem kąta 0°, 10°, 20° - wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 17

Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wyświetlacz wagi umieszczony w panelu sterowniczym dla personelu posiadającym dotykowy ekran LCD zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 18

Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego alarmu sygnalizującego przemieszczanie się pacjenta na leżu w kierunku krawędzi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 19

2

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®] ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/28/2022
	Dostawa łóżek anestezjologicznych - szt.4	

Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 18° (+/- 2°) tylko za pomocą panelu centralnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 20

Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem za pomocą pilota przewodowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 21

Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym przyciski sterowania nożnego przechyłami bocznymi zabezpieczone są przed przypadkowym uruchomieniem – zablokowanie na panelu sterowniczym funkcji przechyłów bocznych spowoduje także zablokowanie możliwości regulacji przechyłów bocznych za pomocą sterowania nożnego (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego)?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 22

Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym panele sterujące nożne nie muszą być zabezpieczone przed wnikaniem wody i płynów (przyciski z gumową osłoną), ponieważ łóżko posiada cały układ elektryczny o klasie szczelności IPX6?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 23

Czy (w pkt. 34) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pozycje zaprogramowane i ustawiane za pomocą jednego przycisku na panelu sterującym zintegrowanym w szczycie od strony nóg pacjenta (pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja egzaminacyjna) - osobne przyciski dla każdej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 24

Czy (w pkt. 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną funkcję CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem tylko na panelu sterowniczym zintegrowanym ze szczytem od strony nóg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 25

Czy (w pkt. 36) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego selektywne blokowanie funkcji elektrycznych:

- regulacja segmentu oparcia pleców
- regulacja segmentu uda
- regulacja wysokości leża
- regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- regulacja przechyłów bocznych

Kontrolki diodowe informujące o zablokowanej funkcji umieszczone w sterowaniu w barierkach bocznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 26

Czy (w pkt. 37) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji tylko w sterowaniu na panelu i w barierkach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego parametru opisanego w pkt. 38?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 28

Czy (w pkt. 39) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji w sterowaniu w barierkach bocznych oraz w panelu po kilku / kilkunastu sekundach

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®] ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/28/2022
	Dostawa łóżek anestezjologicznych - szt.4	

nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 29

Czy (w pkt. 40) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka nie posiadającego przycisku bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 30


Czy (w pkt. 42) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego koła tworzywowe o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym, dźwignia blokady hamulca dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie) oraz dodatkowo dwie dźwignie dostępne przy kołach od strony głowy pacjenta (lewa i prawa strona łóżka)?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 31

Czy (w pkt. 43) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie robocze 250 kg w każdej pozycji (także pozycji horyzontalnej) pozwalające na regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

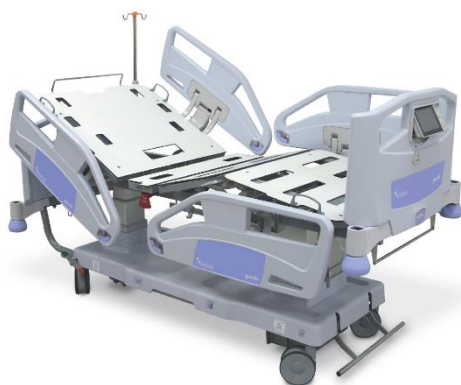

(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Dyrektor
 Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
 (-)
 lek. Mirosław Gorbaczewski