



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-105/24

Tarnów, 2024-11-13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawę: sterylnych zestawów obłożeń operacyjnych, zarękawków.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5g/m²) o odporności na przenikanie cieczy mni.129 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min.175 kPa, na mokro min.185 kPa o zdolności absorpcji cieczy 340%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. O składzie i parametrach:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm – owinięcie zestawu
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 110 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 190 cm x 225 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 300 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji
Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5g/m²) o odporności na przenikanie cieczy mni.129 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min.175 kPa, na mokro min.185 kPa o zdolności absorpcji cieczy 340%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. O składzie i parametrach:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm – owinięcie zestawu
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9x50cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm paskiem samoprzylepnym 80cm
Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego o następującym składzie i parametrach:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm – owinięcie zestawu



4 rączniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna wzmocniona w strefie krytycznej samoprzylepna (ekran anestetyczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych
1 serweta operacyjna, wzmocniona w strefie krytycznej, samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/- 0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m²(+/-0,5g/m²). o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min.273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do stawu barkowego o następującym składzie i parametrach:**

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - owinięcie zestawu
2 rączniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm serweta posiada pasek samoprzylepny zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji
1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji
1 oddzielnie pakowana osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 55 cm z 1 taśmą samoprzylepną 10 x 50 cm. Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²). Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m²(+/-0,5g/m²). o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min.273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do stawu barkowego o następującym składzie i parametrach:**

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - owinięcie zestawu
2 rączniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm serweta posiada pasek samoprzylepny zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji



1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji,

1 oddzielnie pojedynczo pakowana osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 24 x 80 cm z 1 foliową taśmą samoprzylepną 10 cm x 50 cm. Osłona na kończynę wykonana z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej białej dzianiny. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109, g/m² (+/-0,5g/m²). o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min. 273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795 Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylne zestawu do artroskopii o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - owinięcie zestawu

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 oddzielnie pakowaną serwetą operacyjną o wymiarach 75 cm x 90 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5g/m²).

1 taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 cm pakowana oddzielnie

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5g/m²). o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min. 273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5g/m²) o odporności na przenikanie cieczy min. 129 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 175 kPa, na mokro min. 185 kPa o zdolności absorpcji cieczy 340%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety



samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm – owinięcie zestawu

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5g/m²). o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min.273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na kroczę 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze laminatu 57 g/m² (+/- 0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5g/m²). o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min.273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do implantacji portu naczyniowego o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm – owinięcie zestawu

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta 225 cm x 240 cm z wycięciem „U” 20 cm x 20 cm wzmocniona

1 serweta 150 cm x 260 cm z wycięciem „U” 20 cm x 60 cm


Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze laminatu 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego serwety z wycięciem 20cm x 20cm polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5g/m²). o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min. 273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia



spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osobno dołączoną serwetą 75x90cm?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną z wycięciem U o wymiarach 8 x 85 cm?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kończyne o wymiarach 30 x 60 cm?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z 1 szt taśmy samoprzylepnej lub z drugą taśmą dołączoną osobno?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną posiadającą dodatkowe wzmocnienie wysokochłonne?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną o wymiarach 230 x 300 cm, z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osobno dołączoną serwetą 75x90cm?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z elastyczną osłoną na kończyne o wymiarach 22 x 75 cm?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłonami na kończyne w rozmiarze 30x60cm?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osobno dołączoną serwetą w rozmiarze 150x200cm?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z 1 szt taśmy samoprzylepnej lub z drugą taśmą dołączoną osobno?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m²?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną na stolik Mayo dołączoną osobno?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami wykonanymi z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m²?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
 - 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.



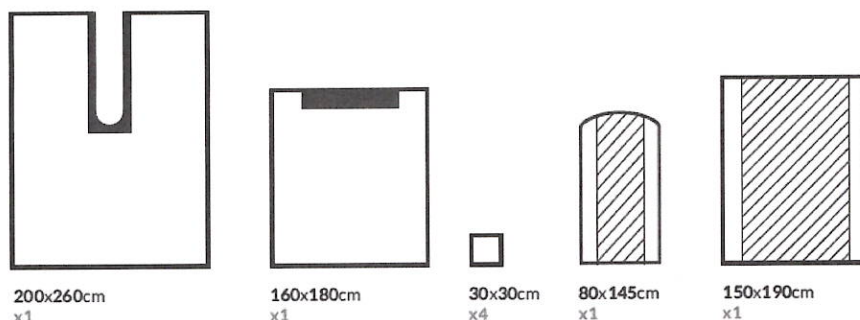

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** sterylnych obłożeń uniwersalnych opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** sterylnych obłożeń uniwersalnych opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sterylnego obłożenia opisanego w pytaniu.

Ad. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** sterylnego obłożenia stawu barkowego opisanego w pytaniu.

Ad. 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** sterylnego obłożenia stawu barkowego opisanego w pytaniu.

Ad. 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** sterylnego zestawu do artroskopii opisanego w pytaniu.

Ad. 7

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 8

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** sterylnego zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych opisanego w pytaniu.

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** sterylnego zestawu do implantacji portu naczyniowego, opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sterylnego zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego z serwetą główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów.

Ad. 12

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** zestawu z osobno dołączoną serwetą 75x90 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym dotyczących składu zestawu.

Ad. 13

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** zestawu z serwetą główną z wycięciem U o wymiarach wycięcia 8 cm x 85 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 14

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** zestawu z osłoną na kończyne o wymiarach 30 x 60 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 15

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** zestawu z 1 taśmą samoprzylepną pod warunkiem dołączenia 2-giej sztuki osobno.

Ad. 16

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu z serwetą główną posiadającą dodatkowe wzmocnienie wysokochłonne, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 17

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu z serwetą główną opisaną w pytaniu.

Ad. 18

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** serwety osobno dołączonej o wymiarach 75x90 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym dotyczących składu zestawu.

Ad. 19

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu z elastyczną osłoną na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm.

Ad. 20

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu opisanego w pytaniu.

Ad. 21

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu z osłoną na kończyne opisaną w pytaniu.

Ad. 22

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** serwety 150x200 cm pakowanej osobno, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym dotyczących składu zestawu.

Ad. 23

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu z 1 taśmą samoprzylepną pod warunkiem dołączenia 2-giej sztuki osobno.

Ad. 24

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 5**.

Ad. 25

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** zestawu z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej opisaną w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym dotyczących składu zestawu.

Ad. 26

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** zestawu opisanego w pytaniu.

Ad. 27

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** zestawu z osłoną na stolik Mayo dołączoną osobno, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym dotyczących składu zestawu.

Ad. 28

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** zestaw opisaną w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym dotyczących składu zestawu.

Ad. 29

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** sterylnego zestawu do implantacji portu naczyniowego, opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

