


|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/>ZP/20/2023</p> |
|---|---|----------------------------------|

Elbląg, dnia 10.05.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3. Nr sprawy ZP/20/2023

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp o poniższej treści:

**Załącznik nr 1.3 do SWZ**

W związku, iż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia niezgodnie z ustawą Pzp ponieważ parametry techniczne i warunki spełniają tylko i wyłącznie urządzenia oferowane przez firmę Getinge Polska Sp. z o.o. prosimy o pozytywne rozpatrzenie parametrów oferowanych, równoważnych urządzeń.

**PAKIET NR 3 – STÓŁ OPERACYJNY – 5 SZTUK**

**Pytanie 1. dot. pkt 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zagłówka odejmovalnego z regulacją w dwóch płaszczyznach z szynami akcesoryjnymi z 2 stron. Opisane rozwiązanie nie ma znaczenia medycznego i w komplecie z innymi parametrami wskazuje na konkretnego producenta jakim jest firma Getinge.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 2. dot. pkt 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pozycji reflex o większym ustawieniu płyt lędźwiowej oraz pleców pod łącznym kątem 110°.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 3. dot. pkt 4**

Ze względu na rozwiązanie charakterystyczne dla jednego producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pozycji „beach-chair” wywoływanej z pamięci ustawień pilota. Pozycja „leżaka” jest rzadko używanym ustawieniem stołu.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 4. dot. pkt 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szerszego zakresu regulacji podglówka: -90 /+45 stopni.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 5. dot. pkt 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pilota bez gniazda na przewód, a z nowszą technologią- ładowany indukcyjnie. Opisane rozwiązanie wskazuje na konkretnego producenta jakim jest firma Getinge.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 6. dot. pkt 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu z blatem modułowym o długości standardowej konfiguracji równej 2070 mm i o długości 2330 mm razem z wymaganym segmentem przedłużającym.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**


**Pytanie 7. dot. pkt 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie średnicy kół 80 mm.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 8. dot. pkt 23**



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/>         ZP/20/2023</p> |
|---|---|---|

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu wyposażonego w materace, bezszwowe, z pamięcią kształtu, o właściwościach przeciwdrożdżynowych i antystatycznych. Grubość materaca 75 mm. Odejmwalne, mocowane do stołu za pomocą rzepów.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 9. dot. pkt 45**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego rozwiązania jakim są buty skórzane które można dopasować zarówno dla stopy dzieci jak i dorosłych.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 10. dot. pkt 50**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przystawki do artroskopii barku częściowo przeźiernej dla RTG z możliwością wykonywania zdjęć w zależności od operowanego barku.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 11. dot. pkt 54**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pogrubienia wałka.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 12. dot. pkt 57**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wygodniejszego rozwiązania jakim jest wózek z jednym koszem, który pozwala na magazynowanie wszystkich akcesoriów do stołu operacyjnego z miejscami odpowiednio na nie przeznaczonymi.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytania dotyczące Wzoru umowy**

**Pytanie 13 - dotyczy §6 ust. 1 pkt 3) i pkt 4)**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisów w sposób następujący:

„3) w przypadku zwłoki w reakcji na zgłoszenie awarii o której mowa w § 4 ust. 4, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości **0,05% wartości brutto urządzenia, które uległo awarii** za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas określony w § 4 ust. 4

4) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma czasu naprawy o którym mowa w § 4 ust. 4 (i nie dostarczy sprzętu zastępczego o którym mowa w zestawieniu parametrów technicznych – jeżeli dotyczy), Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości **0,2% wartości brutto naprawianego urządzenia** za każdy dzień zwłoki”

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w reakcji na zgłoszenie awarii bądź usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony.

Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany treści umowy. Poprawiony załącznik nr 3 zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Dot. Pakiet nr 2 – pytania od n-ru 14 do n-ru**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (25 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 410-810 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (25 szt.) z barierkami bocznymi wykonanymi z profili owalnych o wymiarach 40 x 20 mm, co minimalnie różni się od parametru oczekiwanego?


**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (25 szt.) z powierzchniami lakierowanymi w kolorze białym lub szarym oraz możliwością wyboru koloru blatów spośród 10 kolorów?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 17**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/>         ZP/20/2023</p> |
|---|---|---|

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (25 szt.) z blatem wykonanym z płyty HPL, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 18**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (25 szt.) o wysokości 800 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (25 szt.) o głębokości (wraz z uchwyty do otwierania) wynoszącą 460 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (25 szt.) z szufladą o wysokości 9 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (25 szt.) z komorą zamykaną drzwiczkami o wysokości 32,5 cm, co minimalnie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 410-810 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (30 szt.) z barierkami bocznymi wykonanymi z profili owalnych o wymiarach 40 x 20 mm, co minimalnie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 24**

Prosimy o wskazanie, czy w przypadku łóżka psychiatrycznego (35 szt.) Zamawiający oczekuje łóżka dwusegmentowego (pkt 6), czy łóżka czterosegmentowego (pkt. 10)? Zapisy są ze sobą sprzeczne.

**Odpowiedź Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka dwusegmentowego. Wykreślony zostaje punkt 10. (dot. Pakietu nr 2, część III - Łóżko szpitalne z wyposażeniem (psychiatryczne) – 35 szt.)**

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (2 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 410-810 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (2 szt.) z barierkami bocznymi wykonanymi z profili owalnych o wymiarach 40 x 20 mm, co minimalnie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (7 szt.) z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?


**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 28**

Czy w związku z pkt. 2 Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (7 szt.) o wysokości 87,5 cm, szerokości 55,5 cm, głębokości 45,1 cm (blat główny o wymiarach 428 x 434 mm; blat boczny o wymiarach 550 x 370 mm) , co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**



|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/>ZP/20/2023</p> |
|---|---|----------------------------------|

4) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma czasu naprawy o którym mowa w § 4 ust. 4 (i nie dostarczy sprzętu zastępczego o którym mowa w zestawieniu parametrów technicznych – jeżeli dotyczy), Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto naprawianego urządzenia za każdy dzień zwłoki”  
Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w reakcji na zgłoszenie awarii bądź usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 13**

**Pytanie 41**

punkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z dwuczęściowym oparciem pleców, z możliwością wypiętrzenia ławeczki nerkowej. Zakres regulacji oparcia pleców -80/+40 stopni. W oferowanym modelu stołu możliwe jest jedynie odejmowanie segmentów podgłównka i podnóżków? Reszta wymogów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 42**

punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją wysokości blatu w zakresie 680-1080mm?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 43**

punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z Pozycją „beach-chair” wykonywaną za pomocą 2 ruchów z poziomu pilota przewodowego?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 44**

punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pozycją podnóżków w zakresie -90° do +25°?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 45**

punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z Pozycja reflex- ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 100° co jest parametrem lepszym niż wymaganym?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 46**

punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem przewodowym, który nie posiada możliwości pracy jako pilot bezprzewodowy?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 47**

punkt 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem przewodowym oraz dodatkowym pilotem bezprzewodowym z dedykowaną ładowarką sieciową ?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 48**

punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym segmenty montowane są za pomocą szybkozłączek opartych na układzie prostokątnych klinów/gniazdo (bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach, jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe stanowi bezpieczne połączenie elementów)?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 49**

punkt 18 i 19 tabeli: : Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podstawą jezdnią, w kształcie litery T (3 koła w tym jedno obrotowe). Wszystkie koła skrętne umożliwiające jazdę w dowolnym kierunku. Koła zabudowane w podstawie jezdnej, niewystające poza podstawę stołu podczas zabiegu? Reszta wymogów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 50**

Punkt 19 tabeli: Czy Zamawiający będzie dodatkowo wymagał, aby Podstawa oraz kolumna stołu pokryte zostały włóknem węglowym? Oprócz tego Zamawiający zyskuje wówczas wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al.?

Zdjęcia poglądowe poniżej:




**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu  
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl) , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> [https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag)

Nr sprawy:  
ZP/20/2023

Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3

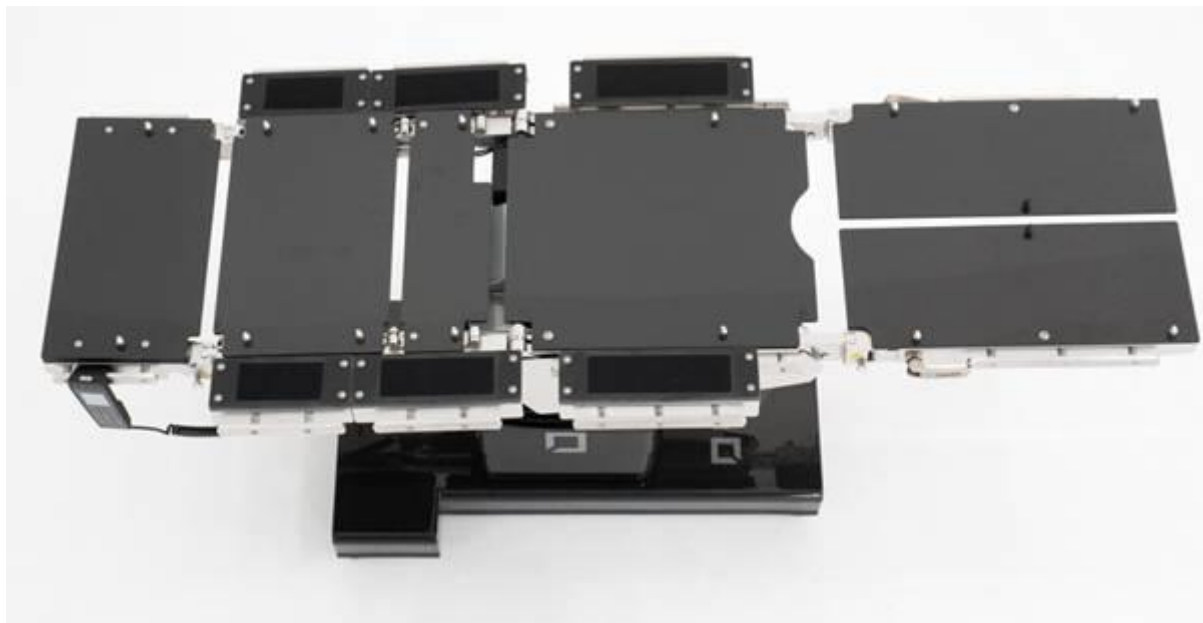

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 51**

Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z blokadą stołu do podłoża, realizowaną za pomocą elektrohydraulicznie wysuwanych stopek?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 52**

Punkt 21 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie 00H17N14M2. W górnej części kolumny znajduje się tworzywowa osłona harmonijkowa- zdjęcie poglądowe poniżej:



**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 53**


Punkt 23 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace, bezszwowe, z pamięcią kształtu, o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i antystatycznych. Grubość materaca 80mm. Odejmowalne. Materace montowane za pomocą czopów i gniazd wpustowych co jest rozwiązaniem lepszym niż montaż na rzepy ?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 54**

punkt 24 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z udźwigniem stołu w pozycji centralnej 460kg oraz odwróconej 200 kg?

**Odpowiedź: Nie**

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/> ZP/20/2023</p> |
|---|---|-----------------------------------|

#### Pytanie 55

punkt 26 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół z możliwością uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego 900 mm?

**Odpowiedź: Nie**

#### Pytanie 56

Punkt 47 tabeli: Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu Uchwytu do drutów Kirchnera – 1 szt?

**Odpowiedź: Nie**

#### Pytanie 57

Punkt 50 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół z przystawką do artroskopii barku -przeziarna dla RTG - krótka płyta z dwoma odejmowalnymi częściami. Możliwość montażu płyty barkowej w segmencie podnózków – 1 szt.?

**Odpowiedź: Nie**

#### Pytanie 58

Punkt 57 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół z wózkiem na akcesoria z jednym, dużym koszem ?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### **Dotyczy: Załącznika nr 1.3 do SWZ (ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH)** **Pakiet nr 3 - STÓŁ OPERACYJNY - SZT. 5.**

#### Pytanie 59

Czy Zamawiający dopuści stół, w którym zagłówek wyposażony jest w szyny akcesoryjne umieszczone z dwóch stron (po bokach)? – dotyczy l.p. 2

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w dwa podglówki (stosowane zamiennie): jednopłaszczyznowy, który mocowany może być zarówno do segmentu pleców, jak i w miejscu podnózków (możliwa ręczna i elektrohydrauliczna regulacja podnózków) oraz dwupłaszczyznowy, który mocowany może być wyłącznie do segmentu pleców (możliwa ręczna i elektrohydrauliczna regulacja podnózków)? – dotyczy l.p. 2 i...

**Odpowiedź: Nie**

#### Pytanie 61

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości blatu w zakresie: 610/1240mm (wysokość mierzona do górnej płaszczyzny blatu bez materacy – blat w pozycji horyzontalnej)? Oferowany stół w dolnej granicy minimalnie różni się od wymaganego w SWZ, natomiast w górnym zakresie znacznie przewyższa oczekiwania Zamawiającego. Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż pozwala na wykonywanie szerszego spektrum zabiegów – dotyczy l.p. 4

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 62

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją dolnej płyty plecowej w zakresie +80°/-30°? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego w SWZ, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 4

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 63

Czy Zamawiający dopuści stół z pozycją reflex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 110°? – dotyczy l.p. 4

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 64


Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w zagłówek regulowany manualnie za pomocą blokady mechanicznej - zakres regulacji podglówka min. +45 /- 45 stopni? – dotyczy l.p. 5

**Odpowiedź: Nie**

#### Pytanie 65

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w pilot przewodowy i osobny pilot bezprzewodowy? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego w SWZ – dotyczy l.p. 6

**Odpowiedź: Nie**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/>         ZP/20/2023</p> |
|---|---|---|

#### Pytanie 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pilota bez wyświetlacza ciekłokrystalicznego, ale wyposażonego w podświetlane przyciski i wyraźne ikony dla poszczególnych funkcji? Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Z uwagi na brak wyświetlacza – po włączeniu pilota przy realizacji poszczególnych funkcji nie wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Realizacja zadania odbywa się podświetlanymi przyciskami z konkretnymi ikonami dla danej funkcji. Z uwagi na brak wyświetlacza – po włączeniu pilota nie wyświetla się na wyświetlaczu informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Po włączeniu pilota – diody (3 kolory) sygnalizują stan naładowania. Diody zmieniające kolor w zależności od poziomu naładowania pilota. – dotyczy l.p. 7

**Odpowiedź: Nie**

#### Pytanie 67

Czy Zamawiający dopuści panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji tj. przycisku start i danej funkcji, ale poza regulacją Trendelenburga / Anty-trendelenburga? – dotyczy l.p. 9

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 68

Czy Zamawiający dopuści podstawę w kształcie litery T wyposażoną w 3 koła: jedno koło pojedyncze obrotowe fi 100 mm, pozostałe dwa koła fi 125 mm podwójne nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost. Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. w podstawie nie wystające poza jej obrys. Podstawa zapewniająca dobre własności jezdne oraz przestawianie stołu na boki. – dotyczy l.p. 18-19

**Odpowiedź: Nie**

#### Pytanie 69

Czy Zamawiający dopuści stół, w którym konieczne jest zdemontowanie całej osłony pokrywy, aby uzyskać dostęp serwisowy? Oferowane rozwiązanie jest szybkie i bezproblemowe, w szczególności, że serwis wykonywany jest przez wyspecjalizowany i wyszkolony w tym celu personel – dotyczy l.p. 19

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 70

Czy Zamawiający dopuści stół z centralną blokadą podstawy stołu – podstawa na czas zabiegu, poprzez schowanie kół jest stabilnie posadowiona na posadzce – stół w pozycji „zablokowany” opiera się 4 wysuwanych stopkach – funkcja sterowana elektrohydraulicznie za pomocą pilota? – dotyczy l.p. 20

**Odpowiedź: Nie**

#### Pytanie 71

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w osłonę mieszkową umieszczoną tylko na połączeniu blatu z kolumną, jak na poniższej wizualizacji? Jest to rozwiązanie stosowane przez wielu producentów stołów operacyjnych, pozwalające na ochronę elementów stanowiących połączenie stołu z blatem. – dotyczy l.p. 21




**Odpowiedź: Nie**

#### Pytanie 72

Czy Zamawiający dopuści stół z udźwignięciem stołu 320 kg oraz w pozycji odwróconej 160kg? – dotyczy l.p. 24

**Odpowiedź: Nie**



|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/> ZP/20/2023</p> |
|---|---|-----------------------------------|

### Pytanie 73

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w podporę pod rękę do ułożenia w pozycji siedzącej lub leżącej na boku długości 500 mm? – dotyczy l.p. 40

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

### Pytanie 74

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w buty wykonane ze stali nierdzewnej z pasami do mocowania stóp pacjenta (wersja dla dorosłych i dzieci)? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego w SWZ. – dotyczy l.p. 45

**Odpowiedź: Nie**

### Dotyczy zamówienia – Pakiet nr 3 – Załącznik nr 1.3 do SWZ - Stół operacyjny:

#### Pytanie 75

1) Pkt 4 w Tabeli:

- Czy Zamawiający dopuszcza regulację wysokości blatu w zakresie: 800 – 1200 mm?
- Czy Zamawiający dopuszcza regulację pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga w zakresie: min. 25° / 25°?
- Czy Zamawiający dopuszcza pozycję reflex - ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 90°?
- Czy Zamawiający dopuszcza pozycję podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. -90° do +65°?
- Czy Zamawiający dopuszcza przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 300 mm?
- Czy Zamawiający dopuszcza dodatkową manualną regulację pochylenia podnóżków w zakresie: min. -80° do 0°?

**Odpowiedź: Lit. c), e) – Dopuszczamy. Lit. a), b) d), f) - Nie**

#### Pytanie 76

Pkt 7 w Tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza pilot bez podświetlonych przycisków funkcji możliwych do wykonania?

**Odpowiedź: Nie**

#### Pytanie 77

Pkt 9 w Tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza panel sterowania awaryjnego bez wyposażenia w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji?

**Odpowiedź: Nie**

#### Pytanie 78

Pkt 10 w Tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza, żeby pilot zdalnego sterowania nie posiadał funkcji - pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego?

**Odpowiedź: Nie**

#### Pytanie 79

Pkt 16 w Tabeli: Czy Zamawiający dopuszcza brak możliwości zamiany segmentów podnóżków z segmentem zagłówek?

**Odpowiedź: Nie**

#### Pytanie 80

Pkt 31 w Tabeli: Czy zamawiający dopuszcza stół wyposażony w dwa wbudowane akumulatory 24V/1,2Ah?

**Odpowiedź: Nie**

### Dotyczy zamówienia – Załącznika nr 3 – Projekt Umowy:


#### Pytanie 81

§2 ust. 2 Projektu Umowy stanowi: Przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie w terminie do 31.12.2023r., przy czym Wykonawca ma 30 dni od momentu wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia na dostarczenie wskazanego sprzętu. Mając na względzie treść art. 433 pkt 4 uPzp a dyspozycję art. 99 ust. 1 i 4 uPzp, Wykonawca wnosi o wskazanie minimalnej liczby dostaw jaką przewiduje Zamawiający.

Powyższe ma o tyle znaczenie, że od ilości dostaw jest w istocie uzależnione prawidłowe (zgodne z uPzp) skalkulowanie ceny oferty, które to wiąże się z kosztami transportu czy też konieczności wysłania ekipy montażowej do Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający posiada harmonogram dostaw, Wykonawca wnosi o jego ujawnienie na potrzeby niniejszego postępowania.

**Odpowiedź: Na dostawę stołów operacyjnych przygotowane zostanie jedno zamówienie, z jednym terminem dostawy.**

#### Pytanie 82

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/>         ZP/20/2023</p> |
|---|---|---|

Mając na względzie fakt, że na dzień składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ (08 maja 2023 r.), termin składania/otwarcia ofert przypada na 22 maja 2023 r., istnieje prawdopodobieństwo, że Zamawiający będzie w stanie rozstrzygnąć przedmiotowe postępowanie w czerwcu 2023 r. i w tymże miesiącu zawrzeć umowę ws. zamówienia publicznego. W takim oto przypadku, z racji realizacji zamówienia do 31 grudnia 2023 r. zaistnieje przesłanka, o której mowa w art. 439 uPzp. Czy Zamawiający przewiduje przy opisanej powyżej sytuacji zmiany w umowie dot. waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy?

**Odpowiedź: Nie**

**Dotyczy: Łóżko szpitalne z wyposażeniem (z szafką przyłóżkową) – 25 szt.**

**Pytanie 83**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka posiadającego konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 84**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2180 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 85**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości 960 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 86**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża 200 x 850 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy zaoferowane łóżka o wymiarach leża 2000 x 850 mm?**

**Pytanie 87**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające szczyty wypełnione HPL 6 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 88**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami lakierowanymi?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 89**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym siatką?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 90**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym płytami HPL?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 91**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wypełnieniem leża montowanymi na stałe?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 92**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 44°?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 93**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresie 360-810 mm?


**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 94**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 95**

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/> ZP/20/2023</p> |
|---|---|-----------------------------------|

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające barierki okrągłe fi 25?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 96**

Czy Zamawiający dopuści działanie barierek: Opuszczenie poręczy bocznej polega na odciągnięciu zatrzasku, co powoduje zwolnienie blokady i umożliwia złożenie poręczy w kierunku nóg pacjenta.

Podnoszenie poręczy polega na uniesieniu poręczy do góry (w kierunku głowy pacjenta) - zablokowanie następuje samoczynnie, co sygnalizowane będzie dźwiękiem zatrzaskującej się blokady.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 97**

Czy Zamawiający zmieni zapis dot. terminu przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy z 48 na 72 godz.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Dotyczy: Łóżko szpitalne z wyposażeniem – 30 szt.**

**Pytanie 98**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka posiadającego konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 99**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2180 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 100**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości 960 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 101**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża 200 x 850 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy zaoferowane łóżka o wymiarach leża 2000 x 850 mm?**

**Pytanie 102**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające szczyty wypełnione HPL 6 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 103**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami lakierowanymi?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 104**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym płytami HPL?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 105**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym siatką?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 106**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wypełnieniem leża montowanymi na stałe?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 107**


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 44°?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 108**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresie 360-810 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/>         ZP/20/2023</p> |
|---|---|---|

#### Pytanie 109

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 110

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko posiadające barierki okrągłe fi 25?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 111

Czy Zamawiający dopuści działanie barierek: Opuszczenie poręczy bocznej polega na odciągnięciu zatrzasku, co powoduje zwolnienie blokady i umożliwia złożenie poręczy w kierunku nóg pacjenta. Podnoszenie poręczy polega na uniesieniu poręczy do góry (w kierunku głowy pacjenta) - zablokowanie następuje samoczynnie, co sygnalizowane będzie dźwiękiem zatrzaskującej się blokady.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 112

Czy Zamawiający zmieni zapis dot. terminu przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy z 48 na 72 godz.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Dotyczy: Łóżko szpitalne z wyposażeniem (psychiatryczne) – 35 szt.**

#### Pytanie 113

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko o długości całkowitej 2180 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 114

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko o szerokości całkowitej 960 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 115

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko o wymiarach leża 2000 x 850 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 116

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko posiadające szczyty wypełnione HPL 6 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 117

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko ze szczytami lakierowanymi?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 118

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości segmentów łożka: W pkt. 6 Zamawiający wymaga łożka dwusegmentowego z ruchomym segmentem pleców, natomiast w pkt. 10 wymaga regulacji oparcia pleców oraz uda za pomocą dźwigni umieszczonych pod ramą leża.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania łożka dwusegmentowego. Wykreślony zostaje punkt 10.**

#### Pytanie 119

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko w wersji z leżem 3 segmentowym posiadającym regulację kąta uniesienia segmentów oparcia pleców i oparcia nóg.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**


#### Pytanie 120

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko posiadające barierki okrągłe fi 25?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytanie 121

Czy Zamawiający dopuści działanie barierek: Opuszczenie poręczy bocznej polega na odciągnięciu zatrzasku, co powoduje zwolnienie blokady i umożliwia złożenie poręczy w kierunku nóg pacjenta. Podnoszenie poręczy polega na

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/> ZP/20/2023</p> |
|---|---|-----------------------------------|

uniesieniu poręczy do góry (w kierunku głowy pacjenta) - zablokowanie następuje samoczynnie, co sygnalizowane będzie dźwiękiem zatraskującej się blokady.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 122**

Czy Zamawiający zmieni zapis dot. terminu przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy z 48 na 72 godz.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Dotyczy: Łóżko na salę wybudzeń – 7 szt.**

**Pytanie 123**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka posiadającego konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 124**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2140 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 125**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające prześwit do podłogi: 155 mm na odcinku ok. 117 cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 126**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające krążki odbojowe talerzowe?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 127**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krążki odbojowe jednoosiowe?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 128**

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem z HPL?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 129**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z segmentami leża mocowanymi na stałe?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 130**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nieposiadające tworzywowej kieszeni po obu stronach łóżka, zabezpieczających pilota w trakcie transportu?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 131**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu łóżka ze sterowaniem w barierkach?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 132**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego barierki ze sterowaniem nie posiadają możliwości położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°, 30°, 45°?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**


**Pytanie 133**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego barierki ze sterowaniem nie posiadają możliwości położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°, 30°, 45° za pomocą 3 osobnych przycisków?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 134**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego barierki posiadają inny niż LCD wyświetlacz?

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/>         ZP/20/2023</p> |
|---|---|---|

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 135**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z regulacją wysokości 375-835 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 136**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z zakresem regulacji wysokości leża góra/dół 460 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 137**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty szybko i łatwo wyjmowane w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, szczyty osadzone w tulejach pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 138**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające bariery bez możliwości powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, gdzie uchwyty stanowią część barierki bocznych?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 139**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z indywidualną blokadą kół?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 140**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z bezpiecznym obciążeniem roboczym 250 kg?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 141**

Czy Zamawiający zmieni zapis dot. terminu przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy z 48 na 72 godz.?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Dotyczy: Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym – 2 szt.**

**Pytanie 142**

Czy Zamawiający wymaga zaferowania łóżka posiadającego konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązania, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 143**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko o długości całkowitej 2180 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 144**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko o szerokości 960 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 145**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko o wymiarach leża 200 x 850 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy zaferowane łóżka o wymiarach leża 2000 x 850 mm?**

**Pytanie 146**


Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające szczyty wypełnione HPL 6 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 147**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko ze szczytami lakierowanymi?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/>         ZP/20/2023</p> |
|---|---|---|

#### **Pytanie 148**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z leżem wypełnionym siatką?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### **Pytanie 149**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z leżem wypełnionym płytami HPL?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### **Pytanie 150**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z wypełnieniem leża montowanymi na stałe?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### **Pytanie 151**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z regulacją segmentu uda w zakresie 44°?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### **Pytanie 152**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z regulacją wysokości w zakresie 360-810 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### **Pytanie 153**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### **Pytanie 154**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko posiadające barierki okrągłe fi 25?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### **Pytanie 155**

Czy Zamawiający dopuści działanie barierek: Opuszczenie poręczy bocznej polega na odciągnięciu zatrzasku, co powoduje zwolnienie blokady i umożliwia złożenie poręczy w kierunku nóg pacjenta. Podnoszenie poręczy polega na uniesieniu poręczy do góry (w kierunku głowy pacjenta) - zablokowanie następuje samoczynnie, co sygnalizowane będzie dźwiękiem zatrzaskującej się blokady.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### **Pytanie 156**

Czy Zamawiający dopuści łożko z materacem jak poniżej?

POMPA:

- Wymiary: 300 x 190 x 120 mm (L x B x H).
- Waga: 3 kg.
- Kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z trwałą membraną wykonaną z PU z uchwytyami do powieszenia na panelu łożka oraz postawieniu na podłodze.
- Zmienny cykl pracy (10 min).
- Tryb statycznych pracy dla pacjentów wrażliwych na ból.
- Alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych).
- Regulacja ciśnienia-płynna z podziałką kg.,

MATERAC:

- Wymiary 200 x 80/90 x 14 cm.
- Waga: 4 kg.
- 18 komór dynamicznych, 3 statyczne komory głowy.
- Komory z mikroperforacją.
- Przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem( z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu).
- Zawór reanimacyjny CPR.
- Funkcja transportowa,


MATERIAŁY WYKORZYSTANE:

Komory :

- Nylon/ TPU gwarantuje olbrzymią trwałość, możliwość wymiany poszczególnych komór materaca.

Pokrowiec:

- Nylon z PU oddychający zapinany na zatrzaski.
- Wodoszczelny i paroprzepuszczalny.

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/> ZP/20/2023</p> |
|---|---|-----------------------------------|

– Max. Waga pacjenta: **130**

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 157**

Czy Zamawiający zmieni zapis dot. terminu przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy z 48 na 72 godz.?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ**

**Dotyczy: Stół operacyjny – 5 szt.**

**Pytanie 158**

Dot. pkt. 2: Prosimy o dopuszczenie do zaferowania podglówka (zagłówka) odejmowanego z regulacją w dwóch płaszczyznach wyposażonego w dwie boczne szyny akcesoryjne, bez szyny trzeciej.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 159**

Dot. pkt. 4: Prosimy o dopuszczenie do zaferowania stołu operacyjnego z regulacją Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 30 stopni, jako parametru zbliżonego do oczekiwanego.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 160**

Dot. pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie stołu operacyjnego z pozycją reflex 100 stopni, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego (pozycja refleks to zamykanie kąta, a zatem im mniejsza wartość, tym bardziej kąt zamknięty)?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 161**

Dot. pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym pozycja „beach-chair” uzyskiwana jest za pomocą przywołania jej z menu pamięci pilota?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 162**

Dot. pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym pozycja „beach-chair” uzyskiwana jest za pomocą kilku przycisków pilota wybieranych kolejno?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 163**

Dot. pkt. 4 i 5: Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie stołu operacyjnego z regulacją elektrohydrauliczną podnóżków i/lub segmentu przedłużającego w zakresie -90/50 stopni, z dodatkową manualną regulacją podnóżków (każdego niezależnie) w zakresie -90/90 stopni?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 164**

Dot. pkt. 5: Zamawiający nie określił wymaganego kąta regulacji drugiej płaszczyzny podglówka. Czy zatem Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z podglówkiem regulowanym manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą blokad i pokręteł odpowiadających za poszczególne osie / płaszczyzny, tj. system zapadkowy z blokadami sprężynowymi dla regulacji kątowej – bliższej kolumny (+/- 530) oraz system mikrometryczny (gałka – pokrętko) do regulacji pionowej góra / dół – dalszej od kolumny (w zakresie ok. 300 = ok. 10 cm)? System jest niezwykle wygodny i precyzyjny., prawdopodobnie lepszy niż wymagany w SWZ.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 165**

Dot. pkt. 6: Prosimy o dopuszczenie do zaferowania pilota sterującego, przewodowego, bez możliwości pracy jako pilot bezprzewodowy.

**Odpowiedź: Nie**


**Pytanie 166**

Dot. pkt. 6: Prosimy o dopuszczenie do zaferowania pilota sterującego bezprzewodowego, wyposażonego w zewnętrzną ładowarkę (stację), bez możliwości używania go jako pilota przewodowego. Ładowanie baterii pilota możliwe jedynie w wspomnianej wyżej zewnętrznej ładowarce.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 167**



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/>         ZP/20/2023</p> |
|---|---|---|

Dot. pkt. 7: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pilota, w którym, gdy jest aktywny, podświetlone są wszystkie klawisze oraz ekran LCD.

**Odpowiedź: Nie**

#### **Pytanie 168**

Dot. pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym awaryjny panel sterowania zlokalizowany jest na ścianie kolumny od strony głowy pacjenta? Rozwiązanie to jest coraz powszechniej stosowane w wysokiej klasy stołach operacyjnych i wynika z doświadczeń i badań nad ergonomią pracy operujących. Chirurg lub asystent, stojący podczas operacji przy wzdłużnej krawędzi stołu, ma łatwiejszy dostęp do panelu sterującego, mając go po swojej lewej lub prawej stronie. To usytuowanie panelu jest także dogodniejsze dla anestezjologa, który zazwyczaj reguluje ustawienia stołu podczas operacji. Jeśli panel umieszczony jest frontem do operującego, z boku kolumny, dostęp do sterowania jest trudniejszy, bo lekarz zasłania go nogami, poza tym zazwyczaj panel ukryty jest pod obłożeniami i osprzętem stołu.

**Odpowiedź: Nie**

#### **Pytanie 169**

Dotyczy pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem sterowania awaryjnego wyposażonym w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem działającym w następujący sposób:

1) po ok. 60 sekundach nieużywania funkcji sterowanie wchodzi w stan uśpienia (blokady); 2) wówczas wywołanie dowolnej regulacji wymaga jednokrotnego krótkiego naciśnięcia wyraźnie oznaczonego klawisza odblokowującego, po czym można dokonywać dowolnej regulacji. Rozwiązanie to jest korzystniejsze od wymaganego opisem przedmiotu zamówienia, gdyż operator może odbezpieczyć stół i regulować nim jedną dłoń, bez konieczności przytrzymywania dwóch klawiszy równocześnie. Przy tym rozwiązanie to pozostaje nadal w pełni bezpieczne.

**Odpowiedź: Nie**

#### **Pytanie 170**

Dot. pkt. 11: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z blatem modułowym o łącznej długości 2142 mm, co jest parametrem lepszym od opisanego w SWZ.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### **Pytanie 171**

Dot. pkt. 15: 32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania modułarny stół operacyjny z systemem mocowania komponentów blatu (segmentów) za pomocą wysoce precyzyjnego i szybkiego systemu hakowo – zatraskowego? Montaż segmentów tym systemem odbywa się niezwykle szybko, pewnie, bezpiecznie. Nie wymaga dodatkowych zacisków, pokręteł i blokad. System ten jest obecnie cechą stołów o najwyższej jakości. Jest zatem systemem równoważnym lub nawet lepszym niż opisany w SWZ system cylindryczny.

**Odpowiedź: Nie**

#### **Pytanie 172**

Dotyczy pkt. 18 i 19: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kołami o średnicy 100 mm, pod podstawą, które można tak ustawić, aby nie wystawały poza obrys podstawy, ale też w różnych sytuacjach skrętnych wychodzą poza jej obrys? Kształt podstawy – wąski równoległobok, z łatwym dostępem dla chirurga. Obudowa podstawy nie jest zdejmowana, stanowi monolit łatwy w dezynfekcji, gdyż dostęp serwisowy znajduje się pod osłoną kolumny. Fotografia poglądowa oferowanej podstawy poniżej:

**Odpowiedź: Nie**

#### **Pytanie 173**

Dot. pkt. 20: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydraulicznym systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych czterech stoppek, aktywowanych za pomocą pilota ręcznego lub panelu sterowania? Stopki posiadają przy tym system kompensacji nierówności podłoża. Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ


**Odpowiedź: Nie**

#### **Pytanie 174**

Dot. pkt. 21: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konstrukcyjne kolumny wykonanej ze stali nierdzewnej elektropolerowanej z gumowym miechem (osłoną siłowników) znajdującym się w górnej części kolumny, posiadającym przekrój zbliżony do przekroju kolumny - osłona w jednym kawałku, dookólna, zapewniająca szczelność i zakrywająca wszystkie elementy wewnętrzne kolumny pod blatem?

**Odpowiedź: Nie**

#### **Pytanie 175**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b><br/> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b></p> <p>e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p> | <p>Nr sprawy:<br/>         ZP/20/2023</p> |
|---|---|---|

Dot. pkt. 26: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stołu operacyjnego z blatem modułowym, w którym, dzięki konfiguracji segmentów blatu istnieje możliwość uzyskania znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu , tj. ok. 1359 mm, co jest parametrem bezpiecznym i idealnym dla współpracy z ramieniem C.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 176**

Dotyczy wyposażenia stołów operacyjnych: Prosimy (dla bezpieczeństwa procedury przetargowej) o potwierdzenie, że wyszczególnione w punktach 34-59 wyposażenie należy zaoferować dokładnie w takich ilościach jak określono w tychże punktach, a nie mnożyć go np. przez ilość stołów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wyszczególnione w punktach 34-59 wyposażenie należy zaoferować dokładnie w takich ilościach jak określono w tychże punktach, a nie mnożyć go np. przez ilość stołów (pkt. 45 został wykreślony)**

**Pytanie 177**

Dotyczy pkt. 44, przystawka ortopedyczna: Ponieważ każdy z producentów nieco inaczej konfiguruje elementy przystawki ortopedycznej, prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia jej w tzw. podpory prętowe.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 178**

Dot. pkt. 47: Prosimy o odstąpienie od wymogu dostawy uchwytu do drutów Kirchnera

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ**

**Pytanie 179**

Czy Zamawiający zmieni zapis dot. terminu przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy z 48 na 72 godz

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ**

Dyrektor  
 Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu  
 (-)  
 lek. Mirosław Gorbaczewski