

Olsztyn, dnia 01.06.2021 r.

L.dz. 860/2021

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania nr 125/2021/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń do sekcji zwierząt, aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz urządzeń do przygotowywania i przechowywania odczynników do badań dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020.***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 4**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

**Pytanie nr 1. Pytania do umowy:**

1. (§ 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od **wartości NETTO** niezrealizowanej dostawy?

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Dlatego też zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu.**

2. (§ 7 ust. 1 pkt. a i pkt. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Uzasadnienie:

Zastrzeżona we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5) . W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej było 5% wartości netto umowy.

W/w dane zmiany zezwolą Wykonawcom na złożenie prawidłowej oferty, spełniającej oczekiwania Zamawiającego oraz przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności. Zezwoli

to również na możliwość ubiegania się o jego udzielenie większej ilości wykonawców wg. Obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów lub zasad. **W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie swojej odpowiedzi.**

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu.**

3. (§ 7 ust. 5) Czy wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary tj. Łączna kwota kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.

Uzasadnienie: zgodnie z nową ustawą prawa zamówień publicznych , łączna kwota nie może być wyższa aniżeli 20%. **W przypadku braku zgody na powyższe, proszę o podanie podstaw prawnych wraz z uzasadnieniem swojej odpowiedzi.**

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu.**

4. (§ 7 ust. 1 pkt. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,5% wartości NETTO za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy?

Uzasadnienie: Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron.

(§ 7 ust. 1 pkt. d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,5% wartości NETTO za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji?

Uzasadnienie: Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku zwłoki w usunięciu wad. Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca karę umowną za każdy dzień zwłoki, a więc przerzucającej na wykonawcę odpowiedzialność za zdarzenia leżące poza jego kontrolą została wskazana za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca w sposób nadmierny równowagę stron .

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby dodania zapisu o proponowanej treści, gdyż przytoczone okoliczności stanowiąby zmianę o charakterze nieistotnym.**

6. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie oraz zbliżonych parametrach

jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: obecna sytuacja związana z koronawirusem, czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu.**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia: Poza zmianami umowy dopuszczonymi w ustawie Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.**

8. Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej (specyfikacje produktu) w formie elektronicznej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostarczania dokumentacji produktowej (specyfikacje produktu) w formie elektronicznej z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ**

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Odpowiedź:**

**Zmawiający informuje, że nie ma takiej możliwości.**

**Pytanie nr 2.**

**Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ (FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)**

**Część nr 1**

**a) Stół sekcyjny wentylowany z regulacją wysokości**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresem regulacji 750/1000mm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w natrysk ręczny na giętkim wężu z blokadą wypływu umieszczony na panelu bocznym, tuż przy nodze?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ**

3. Czy Zamawiający wyrazi dopuści główny blat roboczy złożony z 4 tac o gładkiej powierzchni w miejscach leżącego ciała oraz z perforacją na jego krawędziach służących do odciążenia przykrych zapachów z pola roboczego. Podłączenie o przekroju 250mm – wydajność wentylacji 1100m<sup>3</sup>/h. Pod głównym blatem roboczym (tacami) znajduje się wanna ściekowa z centralnym wyciągiem i odpływem w kierunku miski?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ**

4. Czy Zamawiający zaakceptuje stół wyposażony w układ wentylacji wywiewnej umieszczony w centralnym punkcie wanny ściekowej pod głównym blatem roboczym? Punkt wyciągowy zabezpieczony przed przedostaniem się do wentylacji wody i innych ścieków

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w 4 wkłady perforowane równej wielkości?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ**

**Odpowiedź:**

**b) Stół sekcyjny prosty mobilny**

1. Czy Zamawiający może wyjaśnić, co rozumie przez zapis, że wózek ma być wyposażony w „tacę z otworem ociekowym”? Czy jest to dodatkowe, poza blatem roboczym, wyposażenie stołu? Proszę o uszczegółowienie.

**Odpowiedź:** Taca pod blatem roboczym stołu umożliwiającą postawienie drobnych elementów (mały preparat, kuweta, narzędziownik). Taca posiada otwór ociekowy ułatwiający jej umycie.

c) Stół sekcyjny wentylowany ze stałą wysokością

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o wysokości 850mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w natrysk ręczny na giętkim wężu z blokadą wypływu umieszczony na panelu bocznym, tuż przy nodze?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ

3. Czy Zamawiający wyrazi dopuści główny blat roboczy złożony z 4 tac o gładkiej powierzchni w miejscach leżącego ciała oraz z perforacją na jego krawędziach służących do odciążu przykrych zapachów z pola roboczego. Podłączenie o przekroju 250mm – wydajność wentylacji 1100m<sup>3</sup>/h. Pod głównym blatem roboczym (tacami) znajduje się wanna ściekowa z centralnym wyciągiem i odpływem w kierunku miski?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ

4. Czy Zamawiający zaakceptuje stół wyposażony w układ wentylacji wywiewnej umieszczony w centralnym punkcie wanny ściekowej pod głównym blatem roboczym? Punkt wyciągowy zabezpieczony przed przedostaniem się do wentylacji wody i innych ścieków

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w 4 wkłady perforowane równej wielkości?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ

**Pytanie nr3.**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ (FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

Część nr 2

a) Basen formalinowy 4-miejscowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie basenu o parametrach opisanych w poniższej tabeli. Oferowane rozwiązanie jest nowoczesne i równoważne do opisanego w SIWZ.

Lp.	PARAMETR/ WARUNEK	Spełnienie wymaganego parametru/warun ku (zaznaczyć tak/nie)	Opis oferowanych parametrów
<b>I.</b>	<b>Parametry techniczne</b>		
1.	Specjalistyczny basen do długotrwałego przechowywania preparatów anatomicznych w roztworach konserwujących	TAK	
2.	Elementy konstrukcyjne zasobnika zanurzone w formalinie wykonane ze stali nierdzewnej min. ANSI 316, pozostałe elementy wykonane ze stali 304.	TAK	Zamawiający <b>podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach. Zamawiający nie zna skali „ANSI”. Porównując skalę AISI wynika, że odpowiednikiem stali 1.4404 to powinna być stal AISI 316L</b>
3.	Wysokość zbiornika na formalinę max 1000 mm.		Zamawiający <b>podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.</b>
4.	Konstrukcja dwupoziomowa (każdy poziom umożliwia przechowywanie 2 - 3 ciał)	TAK	Zamawiający <b>podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach. Dolny poziom w postaci jednego dużego sita, natomiast górny poziom w postaci 2 tac/sit</b>
5.	Zwór spustowy formaliny; zawór kulowy 50/60 wykonany ze stali kwasoodpornej usytuowany na krótszym boku	TAK	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne.
6.	Tace stałe	TAK	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne.
7.	Powierzchnie tac perforowane bez rantu.	TAK	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne.
8.	Półki wysuwane za pomocą 2 siłowników hydraulicznych do poziomu umożliwiającego załadunek/rozładunek ciał na wózek do przewożenia zwłok	TAK	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne.

9.	Konstrukcja umożliwiająca łatwy załadunek i rozładunek basenu przez jedną osobę	TAK	
10.	Konstrukcja stelażowa, oparta na dwóch siłownikach hydraulicznych umieszczonych po przeciwległych stronach zasobnika (na krótszej ścianie)	TAK	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne.
11.	Ściany i dno basenu wzmocnione hermetyczne. Pokrywa wzmocniona hermetyczna, automatycznie podnoszona za pomocą siłowników hydraulicznych	TAK	
12.	Uszczelnienie hermetyczne pokrywy i basenu odporne na formalinę.	TAK	
13.	System automatycznego podnoszenia preparatów z formaliny do wysokości brzegu basenu	TAK	
14.	Sterowanie system podnoszenia z panelu sterującego zainstalowanego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	<b>Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.</b>
15.	Możliwość zatrzymania stelażu z preparatami w dowolnym momencie podnoszenia	TAK	
16.	Zintegrowany układ sterowania z jedną pompą zasilającą	TAK	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne.
17.	Elementy sterujące beziskrowe	TAK	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne.
18.	System wyposażony w zabezpieczenia przeciwwybuchowe	TAK	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne.
19.	Silnik i pompa napędzające system podnoszenia umieszczone w osobnym pomieszczeniu w celu wyeliminowania urządzeń elektryczny ze strefy wybuchowej	TAK	Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach (jako rozwiązanie alternatywne) z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ. Dodatkowo należy uwzględnić możliwości lokalowe.

20.	System z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi uszkodzenie kończyn obsługującego	TAK	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne.
21.	Odległość między poziomami min. 380 mm	TAK	<b>Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.</b>
22.	Załadunek ciał odbywa się od strony dłuższego boku basenu	TAK	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne.
23.	Minimalna powierzchnia tacy załadunkowej 1260x2000 mm	TAK	<b>Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.</b>
24.	Minimalna nośność jednego stanowiska 250 kg	TAK (podać)	<b>Dolna duża półka/stanowisko: nośność min. 400 kg</b>
25.	Dodatkowo na wyposażeniu komplet 6 perforowanych koszy o pojemności min 4 litrów – na preparaty drobne	Tak	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne.
26.	Wymiary: min. 2400x1600x2080mm	TAK (podać)	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne.
<b>II.</b>	<b>Pozostałe warunki</b>		
1.	Gwarancja min. 24 miesiące.	TAK (podać)	
2.	Elementy sterujące znajdujące się w obrębie basenu zawierają zabezpieczenia przeciwwybuchowe (na potwierdzenie powyższego) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego certyfikat ATEX na urządzenia elektryczne pracujące w obrębie basenu)	Tak	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne.

**b) Komora chłodnicza na 8 miejsc (2 przedziały po 4 miejsca na tacach)**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory, w której po wyjęciu tac na preparaty jest swobodny dostęp do wnętrza komory, ale w konstrukcji wnętrza występują poprzeczne elementy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory wyposażonej w drzwi o wymiarach w świetle: h=1740mm, szerokość 770mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.**



3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory wyposażonej w drzwi ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301?

**Odpowiedź: Komora w całości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz ma zostać wykonana ze stali kwasoodpornej min. 1.4301 EN. Tak więc drzwi stanowiące jeden z elementów komory mają być również wykonane z tej stali.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory o wysokości 2400mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie alternatywne. Jednak należy uwzględnić warunki lokalowe pomieszczenia, w którym ma zostać zamontowana komora (sufit podwieszany o różnej wysokości).**

5. Czy w przypadku niedużych szczelin technologicznych powstałych przy montażu chłodni, Zamawiający dopuści zabezpieczenie silikonem?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach. Komora ma pasować do kształtu pomieszczenia, w którym zostanie zamontowana.**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory, która nie jest wyposażona w cyfrowy przenośny rejestrator?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Alternatywą może być wbudowany cyfrowy rejestrator o takich samych parametrach jak przedstawiony w SWZ.**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory bez systemu do dekontaminacji ozonem?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ nie wyrażając zgody na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.**

#### c) wózek – stół – przenośnik hydrauliczny

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, z możliwością sterowania za pomocą przycisków nożnych?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ nie wyrażając zgody na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.**

2. Czy Zamawiający zaakceptuje przycisk awaryjnego zatrzymania podnoszenia, który umieszczony jest w dolnej części wózka i uruchamiany nożnie?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ nie wyrażając zgody na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach: długość 2400mm, szerokość 870mm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ nie wyrażając zgody na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.**

#### **Pytanie nr 4.**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ (FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

#### Część nr 3


#### Lampa bezcieniowa zabiegowa

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z natężeniem 60 000 lux?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaferowanie asortymentu o powyższych parametrach.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy z regulacją natężenia 5-100% oraz włączaniem i wyłączeniem lampy przy pomocy panelu umieszczonego tuż przy czaszy, zgodnie z wizualizacją?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

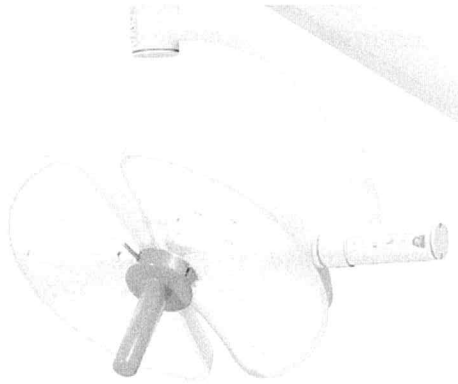

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy z temperaturą barwową o wartości 4300K?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaferowanie asortymentu o powyższych parametrach.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy z temperaturą barwową o wartości 4800K?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaferowanie asortymentu o powyższych parametrach.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy ze stałą średnicą pola 240mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaferowanie asortymentu o powyższych parametrach.**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy z głębokością oświetlenia 140cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

#### **Pytanie nr 5.**

**Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ (FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY)**

**Część nr 4 - Zlewy**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stołów, których nóżki zakończone są stopkami z tworzywa z możliwością regulacji do 20mm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

**Pytanie nr 6.**

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ (FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY)

Część nr 5 – Szafa medyczna

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szaf wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), z frontem malowanym proszkowo RAL?


**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie szaf z przeszkleniem bezpiecznym (niehartowanym)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**


3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zawiasów puszkowych typu Hettich, jak na poniższej wizualizacji?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

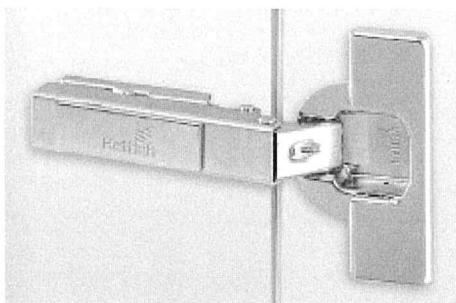

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy z drzwiami wyposażonymi w uchwyty typu C, jak na poniższej wizualizacji?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

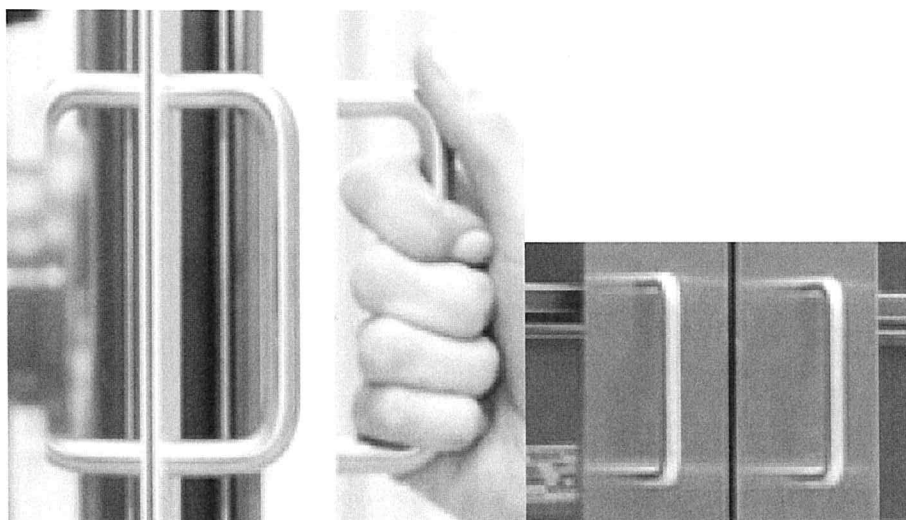

5. Czy Zamawiający dopuści szafy bez systemu rygli?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości zamknięcia szafy za pomocą klucza.**

6. Czy zamawiający dopuści wykonanie półek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

Z poważaniem,

KANCLERZ  
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządzili: dr hab. Michał Zatecki, mec. Adrian Horodecki, mgr Katarzyna Sądziej

SPECIALISTA  
mgr Katarzyna Sądziej