



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie*

Olsztyn, dnia 24.07.2020 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony „Dostawa sprzętu medycznego w ramach przeciwdziałania pandemii Covid 19”, nr sprawy ZPZ - 23/06/20

W związku z zapytaniami uczestników postępowania, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W przypadkach, gdzie Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania parametrów odmiennych niż pierwotnie umieszczone w SIWZ, zwracamy się z prośbą o dodanie w Formularzu Wymaganych Parametrów Technicznych, w stosownych pozycjach, dopisku „Dopuszczono odpowiedziami z dnia 24.07.2020 r.”.

Pytanie nr 1

**Zadanie 6 – Zestaw 6 pomp infuzyjnych – 2 zestawy
punkt 4.4**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania pompy z możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, µg, mg, g/ U, mU, mmol, mEq, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania pompy z możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, µg, mg, g/ U, mU, mmol, mEq, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę).

Pytanie nr 2

Zadanie 5 poz. I - Videolaryngoskop, 1.1-1.11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego videolaryngoskopu o następujących właściwościach:

-zasilany bateriami AAA (3 sztuki) zapewniającymi czas pracy ok 80 min, w zestawie 3 komplety baterii pozwalające na 4 h pracy, bez ładowarki sieciowej z uwagi na zasilanie bateryjne

Odpowiedź

Zamawiający dopuści video laryngoskop zasilany bateriami AAA (3 sztuki) zapewniającymi czas pracy ok 80 min, w zestawie 3 komplety baterii pozwalające na 4 h pracy, bez ładowarki sieciowej z uwagi na zasilanie bateryjne. Zamawiający modyfikuje odpowiednio pkt 1.2.

Pytanie nr 3

- zintegrowany z urządzeniem kolorowy wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości z przekątną 2.4 cala.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia z wyświetlaczem o przekątną 2.4 cala.

Pytanie nr 4

- wyświetlacz LCD ustawiony w stałej pozycji z maksymalnym kątem widzenia do 155 stopni

Odpowiedź

Zamawiający dopuści video laryngoskop w stałej pozycji z maksymalnym kątem widzenia do 155 stopni

Pytanie nr 5

- bez możliwości regulacji ustawienia pozycji monitora – monitor/wyświetlacz zintegrowany na stałe z rękojścią

Odpowiedź

Zamawiający dopuści video laryngoskop bez możliwości regulacji ustawienia pozycji monitora – monitor/wyświetlacz zintegrowany na stałe z rękojścią

Pytanie nr 6

- wskaźnik w postaci świecącej się diody informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o konieczności wymiany baterii,

Odpowiedź

Zamawiający dopuści video laryngoskop ze wskaźnikiem w postaci świecącej się diody informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o konieczności wymiany baterii

Pytanie nr 7

- zestaw łyżek jednorazowego użytku (skład zestawu: łyżka aBlade standardowa rozmiar 3 – 20 sztuk; łyżka aBlade z kanałem prowadzącym rozmiar 3 – 20 sztuk) – 2 opakowania na jeden videolaryngoskop, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?



Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia wyposażonego jedynie w łyżki jednorazowego użytku.

Zadanie 5 poz. I - Videolaryngoskop, 1.1-1.11

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny videolaryngoskop ze zintegrowanym z urządzeniem kolorowy wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości z przekątną 2.4 cala?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia z wyświetlaczem o przekątnej 2.4 cala.



Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny videolaryngoskop z monitorem/wyświetlaczem zintegrowanym na stałe z rękojeścią, wyświetlacz LCD ustawiony w stałej pozycji z maksymalnym kątem widzenia do 155 stopni?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści video laryngoskop w stałej pozycji z maksymalnym kątem widzenia do 155 stopni

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny videolaryngoskop z łyżkami jednorazowymi?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia wyposażonego jedynie w łyżki jednorazowego użytku.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia videolaryngoskopu wraz z zapasowymi akumulatorami w ilości 3 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga dostarczenia videolaryngoskopu wraz z zapasowymi akumulatorami w ilości 3 szt.

Zadanie 5 poz. II – Worek samorozprężalny, 2.1-2.15

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wymaga worek samorozprężalny z możliwością sterylizacji parowej wszystkich elementów worka samorozprężalnego włącznie z maską i rezerwuarem tlenu?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga worek samorozprężalny z możliwością sterylizacji parowej wszystkich elementów worka samorozprężalnego włącznie z maską i rezerwuarem tlenu

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wymaga worek samorozprężalny z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga worka samorozprężalnego z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wymaga worek samorozprężalny ze zintegrowanym z workiem paskiem zabezpieczającym przed wyślizgiwaniem się z dłoni?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga worek samorozprężalny ze zintegrowanym z workiem paskiem zabezpieczającym przed wyślizgiwaniem się z dłoni.

Pytanie nr 15

ZADANIE 5 – Zestaw do intubacji i wentylacji – 2 zestawy

1. Dot. pkt. 1.5. Czy Zamawiający dopuści aparat prezentujący na ekranie wskaźnik paskowy pozostałej objętości baterii w miejsce wymaganego czasu działania baterii?.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści aparat prezentujący na ekranie wskaźnik paskowy pozostałej objętości baterii w miejsce wymaganego czasu działania baterii

Pytanie nr 16

Dotyczy zadania 6

Dotyczy pkt. 1.5.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przystosowania pomp do użycia w karetkach pogotowia? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie odstąpi od wymogu przystosowania pomp do użycia w karetkach pogotowia

Pytanie nr 17

Dotyczy pkt. 1.6.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przystosowania urządzenia i jego akcesoriów do pracy w środowiskach elektromagnetycznych? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający usuwa pkt 1.6.

Pytanie nr 18

Dotyczy pkt. 2.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby waga oferowanej pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie nie przekraczała 2,8kg?

Odpowiedź

Zamawiający wyrazi zgodę, aby waga oferowanej pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie nie przekraczała 2,8kg

Pytanie nr 19

Dotyczy. pkt. 2.7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, w której uchwyt mocujący do stojaka lub szyny należy odłączyć przed włożeniem pompy do stacji dokującej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takiego rozwiązania

Pytanie nr 20

Dotyczy pkt. 4.12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp z 12 poziomami ustawienia ciśnienia okluzji?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp z 12 poziomami ustawienia ciśnienia okluzji

Pytanie nr 21

Dotyczy pkt. 5.6.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia pompy w możliwość dopasowania ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert.



Odpowiedź

Zamawiający nie odstąpi od wymogu wyposażenia pompy w możliwość dopasowania ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału

Pytanie nr 22

Dotyczy pkt. 5.7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z bazą 40 nazw leków, z możliwością rozszerzenia (przy użyciu dedykowanego oprogramowania) o listę leków użytkownika zawierającą protokoły infuzji?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pompy z bazą 40 nazw leków, z możliwością rozszerzenia (przy użyciu dedykowanego oprogramowania) o listę leków użytkownika zawierającą protokoły infuzji

Pytanie nr 23

Dotyczy pkt. 7.3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp, które można łączyć w moduły (pompy zasilane osobnymi przewodami)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp, które można łączyć w moduły (pompy zasilane osobnymi przewodami)

Pytanie nr 24

Dotyczy pkt. 8.8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stacji dokującej o masie max. 8,5kg?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stacji dokującej o masie max. 8,5kg.

Pytanie nr 25

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWIZ, Zadanie 2 – Aparat ultrasonograficzny

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWIZ wymaga podania oprócz producenta i modelu oferowanego systemu ultrasonograficznego również nr seryjnego.

Prosimy o doprecyzowanie czy poprzez zapis „Nr Seryjny:” Zamawiający rozumie Nr Katalogowy oferowanego aparatu ultrasonograficznego. Zwracamy uwagę na fakt, iż nr seryjny można podać po wyprodukowaniu aparatu ultrasonograficznego lub bezpośrednio po dostawie. Na etapie składania ofert nie jest możliwe podanie nr seryjnego oferowanego aparatu ultrasonograficznego a jest możliwe podanie jego nr katalogowego.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż pod wskazanym określeniem rozumie Nr Katalogowy oferowanego aparatu ultrasonograficznego. Dotyczy to również pozostałych zadań.

Pytanie nr 26

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWIZ, Zadanie 2 – Aparat ultrasonograficzny, pkt. 1.11

Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat Ultrasonograficzny wyposażony w pulpit sterowania z regulacją wysokości w zakresie góra/dół 18 cm dodatkowo z funkcją niezależnej od panelu

sterowania regulacji monitora w zakresie góra/dół ponad 20 cm co zapewnia wyjątkową ergonomię pracy. Prosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza aparat z regulacją wysokości w zakresie góra dół 18 cm dodatkowo z funkcją niezależnej od panelu sterowania regulacji monitora w zakresie góra/dół ponad 20 cm co zapewnia wyjątkową ergonomię pracy.

Pytanie nr 27

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 – Aparat ultrasonograficzny, pkt. 6.3

Zamawiający w niniejszym punkcie wymaga: „Integracja oferowanego systemu USG z systemem RIS/PACS funkcjonującym u Zamawiającego”.

W związku z powyższym wymogiem prosimy o doprecyzowanie:

czy Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami na podłączenie dostarczanego Ultrasonografu do systemu RIS/PACS funkcjonującego u Zamawiającego; prosimy o podanie z usług jakiego producenta (jakiej firmy, dane kontaktowe) w zakresie RIS/PACS korzysta Zamawiający;

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dysponuje wolną licencją na podłączenie aparatu USG do systemu PACS Sanapse firmy FujiFilm. W celu podłączenia aparatu USG do systemu PACS Sanapse i skonfigurowania worklisty konieczny jest kontakt z serwisem FujiFilm:

**Fujifilm Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa
Adres e-mail: medserwis@fujifilm.pl, tel.: 22 517 66 68.**

Pytanie nr 28

Dotyczy załącznika 1 do SIWZ, formularz oferty, dot. zadanie 2

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT oraz rodzaj asortymentu?

Odpowiedź

W przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT oraz rodzaj asortymentu

Pytanie nr 29

Dotyczy załącznika 6 do SIWZ, Wzór umowy, V. Gwarancja, § 5, ust.3, pkt. 9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu dotyczącego dostępności części w następujący sposób:

„Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od podpisania umowy. z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej modyfikacji do wzoru umowy.

Pytanie nr 30

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, wzór umowy, VI Zasady odpowiedzialności, § 6

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów,



przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w §14 wzoru umowy.
Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej modyfikacji do wzoru umowy. Zasadność ustalania kar umownych, ich dochodzenia lub ich wysokości w przypadku opóźnienia pozostającego w związku z COVID 19 reguluje art. 15 r ust 1 pkt.6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374,567,568).

Pytanie nr 31

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, Wzór umowy, II Termin dostawy, §2

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści §6 wzoru umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 32

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, tj wzór umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, tj. wzór umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,
 - (a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
 - (b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz
 - (c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugoda lub uniknięciem roszczenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie nr 34

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, tj, wzór umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie nr 35

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do końca lutego 2021 roku?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania .

Pytanie nr 43

Czy (w pkt. 1.21) Zamawiający dopuści panele sterujące od strony pacjenta oraz personelu z przyciskami podświetlenia leża bez alarmu akustycznego?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania .

Pytanie nr 44

Czy (w pkt. 1.23) Zamawiający dopuści blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych – selektywna blokada (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków i pokręteł, panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu poszczególnych funkcji?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiego rozwiązania.

Pytanie nr 45

Czy (w pkt. 1.24) Zamawiający dopuści segment podudzia regulowany za pomocą sprężyny gazowej? Jednocześnie prosimy o przyznanie 3 pkt. za ww. rozwiązanie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania i nie przyzna punktów.

Pytanie nr 46

Czy (w pkt. 1.28) Zamawiający dopuści górną powierzchnię poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystającą ponad płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

Pytanie nr 47

Czy (w pkt. 1.29) Zamawiający dopuści łóżko standardowo wyposażone w tworzywowe poręcze boczne o wysokości 430 mm nad najwyższy punktem lub krawędzią leża, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (także w części podudziowej), bez konieczności instalowania trzeciej pary poręczy bocznych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania .

Pytanie nr 48

Czy (w pkt. 1.32) Zamawiający dopuści segmenty oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami laminatowymi HPL przeziernymi dla promieni RTG, segment miednicy stały, stalowy, lakierowany proszkowo?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania .

Pytanie nr 49

Czy (w pkt. 1.40) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworzni wyrównania potencjału?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydłużenie terminu

Pytanie nr 36

§6 ust. 1.) umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,1%?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

Pytanie nr 37

Dotyczy: zadanie 3 - łóżka intensywnej opieki medycznej z materacem przeciwoleżynowym - 2 szt.

Czy (w pkt. 1.5) Zamawiający dopuści ręczny pilot przewodowy bez funkcji autokontur (w oferowanym łóżku funkcja autokontur będzie dostępna na centralnym panelu sterującym)?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiego rozwiązania.

Pytanie nr 38

Czy (w pkt. 1.8) Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka opartą na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju prostokątnym, bez możliwości monitorowania pacjenta ramieniem C?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania .

Pytanie nr 39

Czy (w pkt. 1.14) Zamawiający dopuści elektryczną regulację pozycji Trendelburga tylko z panelu centralnego (ze względów bezpieczeństwa) w zakresie 17°?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania .

Pytanie nr 40

Czy (w pkt. 1.15) Zamawiający dopuści elektryczną regulację pozycji anty-Trendelburga tylko z panelu centralnego (ze względów bezpieczeństwa) w zakresie 17°?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania .

Pytanie nr 41

Czy (w pkt. 1.19) Zamawiający dopuści pozycję Fowlera (obniżenie wysokości leża, uniesienie oparcia pleców i uda) za pomocą przycisków służących do regulacji segmentów leża znajdujących się na panelu centralnym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania .

Pytanie nr 42

Czy (w pkt. 1.20) Zamawiający dopuści sterowanie w barierkach bocznych bez funkcji autokontur i przechyłów wzdłużnych leża (w oferowanym łóżku funkcje te będą dostępne na centralnym panelu sterującym)?



Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiego rozwiązania.

Pytanie nr 50

Czy (w pkt. 1.40) Zamawiający dopuści bariery boczne posiadające wskaźniki kąta pochylenia segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych, zamiast poziomic?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiego rozwiązania.

Pytanie nr 51

Czy (w pkt. 1.40) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w listwy stalowe, lakierowane proszkowo do mocowania wyposażenia dodatkowego zamocowane tylko po bokach leża z ośmioma haczykami do zawieszenia np. woreczków na płyny fizjologiczne, po cztery haczyki z dwóch stron leża?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiego rozwiązania.

Pytanie nr 52

Czy (w pkt. 2.1) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących przepisów i norm:

- Dyrektywa Europejska 93/42/CE z 14. czerwca 1993 roku dotycząca wyrobów medycznych
- Dyrektywa Europejska 2006/42/CE z 17. maja 2006 roku dotycząca maszyn, zmieniająca Dyrektywę 95/16/CE
- Dyrektywa Europejska 2006/95/CE z 12. grudnia 2006 roku dotycząca uściślenia ustawodawstwa państw członkowskich w sprawie materiałów elektrycznych przeznaczonych do stosowania pod limitowanym napięciem
- Dyrektywa Europejska 2004/108/CE z 15. grudnia 2004 roku dotycząca uściślenia ustawodawstwa państw członkowskich w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
- Dyrektywa Europejska 2009/23/CE z 23. kwietnia 2009 roku dotycząca nieautomatycznych przyrządów ważenia
- Norma UNE - EN ISO 12100, "Bezpieczeństwo maszyn. Zasady ogólne dla oceny i redukcji ryzyka projektowania"
- Norma UNE - EN 20324, "Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy, kod IP". Równoważna normie IEC 60529
- Norma UNE - EN 60204-1, "Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Zasady ogólne"
- Norma UNE - EN 60601-1, "Medyczne urządzenia elektryczne. Część 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa"
- Norma UNE - EN 60601-1-2, "Medyczne urządzenia elektryczne. Część 2. Zasady ogólne bezpieczeństwa. Norma: kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania i badania"
- Norma UNE - EN 60601-2-52, "Medyczne urządzenia elektryczne. Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa elektrycznych łóżek medycznych"
- Norma EN 45501-95, metrologiczne aspekty nieautomatycznych przyrządów ważenia


Odpowiedź

Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania przepisów i norm wymienionych powyżej.

Pytanie nr 53

Czy (w pkt. 2.3) Zamawiający dopuści funkcje systemu ważącego:

- Automatyczne tarowanie
- Zapamiętywanie wagi pacjenta (np. poranny pomiar w stosunku do aktualnego wyniku - wyświetlany za pomocą jednego przycisku)
- Funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
- Automatyczne kalibrowanie wagi
- Funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta
- Alarm wyjścia pacjenta z łóżka
- Przechodzenie wagi w tryb czuwania po ok. 20 sekundach z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle”

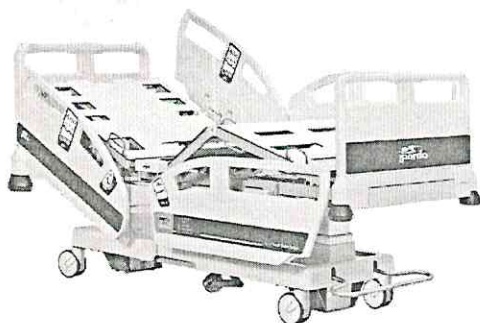

(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź

Zamawiający dopuści system ważący o przedstawionych wyżej cechach.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoodleżynowy o poniższych parametrach?

Materac powietrzny, dynamiczny, wyposażony w 20 niezależnych, wymiennych komór, ułożonych poprzecznie. Komory o wysokiej elastyczności i wytrzymałości (nylonowo – poliuretanowe) zamknięte hermetycznie. Komory umieszczone na powietrznej macie w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu pacjenta z łóżkiem

Odpowiedź

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 55

Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie (według EPUAP) u pacjentów z grupy wysokiego – najwyższego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona) u pacjentów o wadze do 270 kg

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 56

Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do łóżka

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 57

Rozmiar materaca – dedykowany do zaoferowanego łóżka

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 58

Maksymalna waga materaca 15 kg

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 59

Zawór CPR

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 60

Komory w części głowy pacjenta ułożone naprzemiennie zmniejszające ucisk i polepszające ukrwienie, w celu zapewnienia komfortu pacjenta

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 61

System wyposażony w zewnętrzną pompę posiadającą możliwość zawieszenia na łóżku pacjenta. Intuicyjny panel dotykowy, przyjazny w obsłudze. Możliwość blokady funkcji, w celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia lub zmiany wybranych parametrów przez personel medyczny

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 62

Materac wyposażony w mikrootwory redukujące nadmiar powietrza podczas włączania nowego z zachowaniem funkcji utrzymywania wymaganego ciśnienia. Funkcja gwarantuje utrzymanie świeżości powietrza wewnątrz komór materaca i wspomaga zapobieganie powstawania odleżyn

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 63

System przeciwoleżynowy niskociśnieniowy wyposażony w system napełniania komór w trybie 3:1 oraz niskociśnieniowy tryb statyczny

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 64

4 tryby pracy:

- Tryb zmiennociśnieniowy - komory są napełniane naprzemiennie w parach. Terapia trwa w cyklach czasowych 3-20 minut
- Tryb statyczny - zapewnia stały poziom ciśnienia we wszystkich komorach. Funkcja ustawiana przez personel w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta
- Tryb pulsacyjny - napełnia i opróżnia komory gwarantując pulsowanie, a tym samym zapobiega problemom związanym z oddychaniem. Terapia trwa w cyklach czasowych 3-20 minut

- Maksymalna twardość - materac jest napełniany równomiernie do poziomu 80 mmHg, maksymalnie przez 10 minut, a następnie zostają przywrócone automatycznie ustawienia pierwotne

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 65

Automatyczna funkcja Fowlera oraz siedząca. Materac wraz z pompą automatycznie wykrywają zmianę pozycji z leżącej na siedzącą / kardiologiczną lub Fowlera oraz odwrotnie i optymalnie dobierają ciśnienie gwarantujące odpowiednie dostosowanie twardości materaca w celu wyeliminowania ryzyka zwiększonego ucisku na tkanki podczas zmiany pozycji ułożenia ciała

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 66

W przypadku braku zasilania system utrzymuje maksymalne napełnienie przez min. 15 minut, w zależności od wagi pacjenta i stosowanej terapii

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 67

Wizualny i akustyczny alarm niskiego ciśnienia oraz alarm awarii zasilania

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 68

Poziom hałasu pompy zasilającej 23-40 dB

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 69

Materac posiadający poziomów twardości, wyposażony w system czujników pozwalających na automatyczne, optymalne rozprowadzenie ciśnienia wewnątrz materaca, zapewniając tym samym stały poziom komfortu pacjenta niezależnie od pozycji ułożenia i kształtu ciała

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 70

Stopień i typ ochrony: Typ B/ IP21

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 71

Maksymalna waga pompy 8,5 kg

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 72

Zakres poziomu ciśnienia: 20-80 mmHg

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 73

Czas napełniania materaca do maksymalnego poziomu ciśnienia: do 30 minut

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 74

Materac wyposażony w miękki, wysoce elastyczny, rozciągający się 4 kierunkach higieniczny pokrowiec. Pokrowiec materaca o obniżonym współczynniku tarcia, wodoodporny, oddychający, antyalergiczny, ognioodporny i nie zawierający lateksu

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 75

Pokrowiec wyposażony w kryty zamek błyskawiczny, w celu nieprzedostawania się cieczy, umieszczony z dala od krawędzi materaca, w celu zapobiegania urazom pacjenta. Pokrowiec łatwy do czyszczenia, przystosowany do dezynfekcji standardowymi środkami stosowanymi w jednostkach służby zdrowia i przystosowany do prania w pralce

Odpowiedź

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 76

Zadanie nr: 6 Zestaw 6 pomp infuzyjnych – 2 zestawy

Pkt. 2.1 Czy Zamawiający miał na myśli podłączenie pomp do szpitalnej sieci WiFi? Oferowane pompy strzykawkowe posiadające możliwość podłączenia bezprzewodowego do własnego systemu nadzorującego.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje pkt. 2.1. nadając mu brzmienie

2.1.	Pompa infuzyjna strzykawkowa do infuzji dożylniej lub podskórnej u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych, sterowana elektronicznie umożliwiającą współpracę z systemem centralnego zasilania	TAK	Bez punktacji	
------	---	-----	---------------	--

Pytanie nr 77

Pkt. 2.6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do statywów, pionowych kolumn oraz stacji dokującej przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb. Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

Pytanie nr 78

Pkt. 2.7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcane pompy strzykawkowe z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej po uprzednim odkręceniu uchwytu mocującego. Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

Pytanie nr 79

Pkt. 4.4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, µg, mg, mlU, IU, kIU, mlE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane parametry programowania infuzji.

Pytanie nr 80

Pkt. 4.12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z 12 poziomami ciśnienia okluzji ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

Pytanie nr 81

Pkt. 5.5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia ? Jest to funkcja wprowadzona tylko przez jednego producenta pomp, a dodatkowo taka opcja znajduje o wiele szersze zastosowanie podczas kontrolowania przepływów podczas podglądu centrali. Powołując się na zasadę konkurencyjności i nieograniczony rodzaj przetargu, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego punktu.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje wymagany parametr w następujący sposób:

5.5.	Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia	TAK/NIE	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	
------	--	---------	----------------------------	--

Pytanie nr 82

Pkt. 5.6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością wpisania nazwy oddziału w meny pompy jako możliwość dopasowania ekranu głównego oraz zawartości menu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 83

Pkt. 7.3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z opcjonalną możliwością połączenia dwóch pomp w moduł, realizowaną za pomocą opcjonalnej stacji dokującej umożliwiającej zasilanie jednym kablem?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 84

Pkt. 8.5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu stację dokującą z możliwością szybkiego mocowania pomp wraz z uchwytem transportowym przy użyciu elementu przykręcanego? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 85

Zadanie 5 – Zestaw do intubacji i wentylacji – 2 zestawy (laryngoskop+worek)

Zestaw do Intubacji:

poz. 2 Prosimy Zamawiającego o przyznanie dodatkowych punktów na czas pracy urządzenia z baterii po pełnym naładowaniu - 90 min.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie punktów za proponowany parametr.

Pytanie nr 86

poz. 7 - Czy Zamawiający wymaga urządzenie zasilane źródłem światła - podwójne UV/LED białe, tradycyjne białe światło LED oraz UV – pozwala to uzyskać doskonały obraz naturalnej barwy bez prześwietleń.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 87

poz. 9 - Czy Zamawiający wymaga łyżki wielokrotnego użytku typu MAC rozmiar opisany jak w przedmiocie zamówienia 2, 3 i 4 z systemem video oraz podwójnym źródłem światła LED i UV białe - 2 komplety na jeden wideolaryngoskop? łyżki z takim światłem mogą być używane zarówno w przypadku rutynowych, jak i trudnych procedur intubacji w różnych środowiskach.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga łyżek wielokrotnego użytku. Zamawiający nie wymaga podwójnego źródła światła LED i UV.

Pytanie nr 88

Zestaw do wentylacji:

Pytanie 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności worka samorozprężalny z zaworem ciśnieniowym, z dwiema maskami wykonany z silikonu do wentylacji mechanicznej pacjenta dorosłego


Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza worek samorozprężalny z zaworem ciśnieniowym z dwiema maskami z silikonu do wentylacji pacjenta o wadze ciała od 15 kg wzwyż.

Pytanie nr 89

poz. 15

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu „Komora worka otoczona zewnętrzną powłoką (konstrukcja dwuwarstwowa” i dopuszczenie worka bez dodatkowej zewnętrznej powłoki. Zdjęcie worka poniżej na zdjęciu - wysoka objętość 2500 ml.

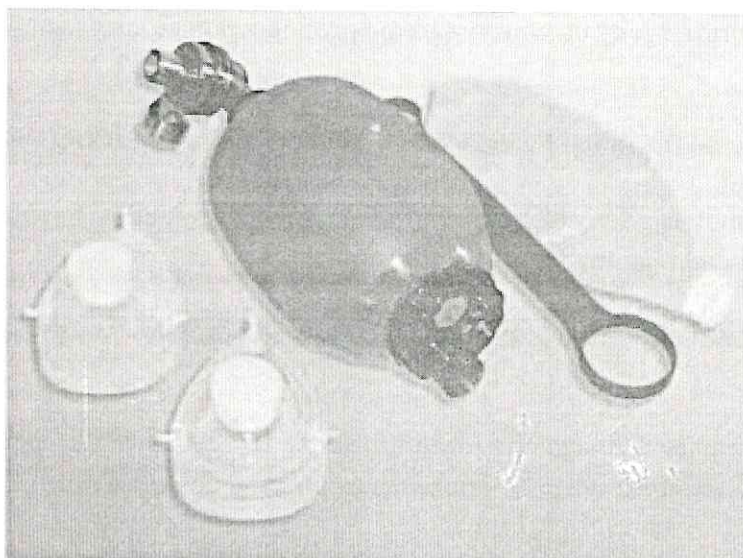

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 90

poz. 21

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wymagane są w zestawie dwie maski twarzowe do zestawu dla pacjenta dorosłego w rozmiarze 4,5. Wykonane z silikonu, nadające się do sterylizacji.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowania 2 masek na zestaw w rozmiarach 2 i 5

Pytanie nr 91

DOTYCZY: Zadanie 5 - Videolaryngoskop

Czy przy zachowaniu pozostałych parametrów Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dopuści videolaryngoskop z ekranem LCD o przekątnej 2,5 cala, czasie pracy na baterii wynoszącej

około 180 minut i wskaźnikiem rozładowującej się baterii w postaci pojawiającej się czerwonej ikony?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie videolaryngoskopu z ekranem o przekątnej 2,5 cala. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z pozostałymi wyszczególnionymi parametrami.

Pytanie nr 92

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy z pompą bez alarmu uszkodzenia panelu sterowania?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy z pompą bez alarmu uszkodzenia panelu sterowania

Pytanie nr 93

Zadanie 6 – Zestaw 6 pomp infuzyjnych – 2 zestawy

2. Wymagania podstawowe, Lp.2.1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp bez modułu WiFi.

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania pomp z modułem WiFi. Zamawiający modyfikuje warunek 2.1.

Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH
Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

mgr Magdalena Sapryka

