



**SZPITAL KLINICZNY**  
**IM. KAROLA JONSCHERA**  
Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego  
W POZNANIU



Nasz znak ZP 38/23

Poznań, dnia 19.09 2023 roku

## Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na Dostawa wraz z montażem uruchomieniem i przeszkoleniem urządzeń Łóżka szpitalne 4 szt. oraz wózek do transportu chorych 1 szt. .

I. Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej :

1.W załączniku nr 1 „Tabela nr 2- Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)” zmiana polega na wykreśleniu pkt.5 i 7 i zmianie punktacji w pkt. 1 i 2 zmianę zaznaczono pogrubioną czcionką.

**Jest:**

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

L.p.	Parametry oceniane	WYMOGI TAK/NIE	ODPOWIEŹ WYKONAWCY TAK/NIE	Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać)	Punktacja
1.	Łóżko posiada szczelne kolumny cylindryczne	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 5 pkt Nie – 0pkt
2.	Łóżko posiada wskaźnik informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 5 pkt Nie – 0pkt
3.	Stała odległość oparcia pleców od szczytu niezależnie od położenia segmentu	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 5pkt Nie – 0pkt
4.	Panel sterowania trwale wbudowany w konstrukcję łóżka od strony nóg	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 5 pkt Nie – 0pkt
5.	Centralna blokada kół uzyskiwana za pomocą pokrętła wbudowanego w górny blat szafki	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt

6.	Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o dodatkowe elementy takie jak uchwyt na tablet lub telefon komórkowy	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak - 1pkt Nie – 0pkt
7.	Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o zamek z kluczykiem do zamykania górnej szuflady	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt

## Po zmianach:

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

L.p.	Parametry oceniane	WYMOGI TAK/NIE	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE	Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać)	Punktacja
1	Łóżko posiada szczelne kolumny cylindryczne	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		<b>Tak – 6 pkt</b> Nie – 0pkt
2	Łóżko posiada wskaźnik informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		<b>Tak – 6 pkt</b> Nie – 0pkt
3	Stała odległość oparcia pleców od szczytu niezależnie od położenia segmentu	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 5pkt Nie – 0pkt
4	Panel sterowania trwale wbudowany w konstrukcję łóżka od strony nóg	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 5 pkt Nie – 0pkt
5	Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o dodatkowe elementy takie jak uchwyt na tablet lub telefon komórkowy	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak - 1pkt Nie – 0pkt

2.W załączniku nr 1 „Tabela nr 2A pkt.3 - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)” zmiana polega na poprawie omyłki pisarskiej podano w punktacji „Tak -5 pkt Nie-1 pkt „, powinno być „Tak 5 pkt Nie -0 pkt.” zmianę zaznaczono pogrubiona czcionką.



**Jest:**

**Tabela nr 2A - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)**

L.p.	Parametry oceniane	WYMOGI TAK/NIE	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE	Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać)	Punktacja
1.	Indykator wychylenia kąтового oparcia pleców z wyraźnym zaznaczeniem kąta położenia segmentu	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 5 pkt Nie – 0pkt
2.	Minimum 4 wyprofilowane uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone z obu dłuższych strony wózka	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 5pkt Nie – 0pkt
3.	Opuszczanie barierek bocznych wspomagane za pomocą sprężyny gazowej	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 5pkt Nie – 1pkt
4.	5 koło kierunkowe wspomagane za pomocą sprężyny gazowej	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 2 pkt Nie – 0pkt

**Po zmianach:**

**Tabela nr 2A - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)**

L.p.	Parametry oceniane	WYMOGI TAK/NIE	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE	Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać)	Punktacja
1.	Indykator wychylenia kąтового oparcia pleców z wyraźnym zaznaczeniem kąta położenia segmentu	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 5 pkt Nie – 0pkt
2.	Minimum 4 wyprofilowane uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone z obu dłuższych strony wózka	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 5pkt Nie – 0pkt
3.	Opuszczanie barierek bocznych wspomagane za pomocą sprężyny gazowej	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 5pkt <b>Nie – 0pkt</b>

4.	5 koło kierunkowe wspomagane za pomocą sprężyny gazowej	Tak/Nie	Podać ..... W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE		Tak – 2 pkt Nie – 0pkt
----	---	---------	---	--	---------------------------

**II. Ponadto informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:**

**Pytanie nr 1 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 230V zgodnie z PN bez diody informującej o podłączeniu do sieci?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 2 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w akumulator bez diodowej kontrolki informującej o stanie naładowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 3 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 1700 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 4 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość leża 1470 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 5 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże, który nie jest oparte na dwóch kolumnach, a podstawa nie jest osłonięta tworzywową pokrywą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 6 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 730 – 1010 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 7 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację barierki bocznych teleskopową z możliwością zablokowania na dwóch wysokościach (barierka opuszczona / barierka podniesiona), blokada zwalniana w dolnej części barierki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ



**Pytanie nr 8 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże wypełnione płytami z tworzywa ABS z otworami, bez systemu odprowadzania cieczy pod leże?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 9 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/-12 stopni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 10 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-75 stopni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 11 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego odległość górnej krawędzi segmentu pleców od szczytu głowy w każdym położeniu, również w trakcie podnoszenia o parametrze zapewniającym bezpieczeństwo dziecka bez konieczności podawania konkretnego parametru w cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 12 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez funkcji autoregresji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 13 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel sterowania posiadający specjalny przycisk bezpieczeństwa aktywujący w sposób świadomy funkcje sterowania; panel posiadający możliwość zablokowania funkcji (segmentu oparcia pleców, wysokości leża, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga) oraz wyposażony w diody LED informujące o zablokowanej funkcji; przyciski oznaczone w wyraźny, czytelny sposób, w celu szybkiej ich identyfikacji w chwili zagrożenia życia pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 14 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel sterowania nie wyposażony w diodową kontrolkę podłączenia do sieci oraz diodową kontrolkę stanu naładowania akumulatora?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 15 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego cztery koła o średnicy 125 mm z centralną blokadą, bez koła kierunkowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 16 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka i materaca, które nie są wyprodukowane przez jednego producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.



**Pytanie nr 17 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w zamocowany pod leżem (nie wysuwany) kosz na pościel i akcesoria do pielęgnacji dzieci, głębokość kosza min. 10 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 18 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez listwy z obu stron łóżka?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka).

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie nr 19 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci - 4 szt.**

Prosimy o potwierdzenie, że w Tabeli nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych) zapisy w pkt. 5 „Centralna blokada kół uzyskiwana za pomocą pokrętła wbudowanego w górny blat szafki” oraz w pkt. 7 „Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o zamek z kluczykiem do zamykania górnej szuflady” są omyłkowe i nie dotyczą łóżka szpitalnego dla dzieci.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I.

**Pytanie nr 20 dot. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt.**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wymiary zewnętrzne 2100 x 810 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 21 dot. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt.**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację przechyłów wzdłużnych nożną hydrauliczną Trendelenburga 15° i anty-Trendelenburga 14° dźwigniami umieszczonymi z obu dłuższych boków wózka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 22 dot. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt.**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego leże przeziernie dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz ramieniem C, pod blatem prowadnice na kasetę na całej długości z możliwością zintegrowania tacy na kasetę RTG z segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej; boki wózka wyposażone w listwę pełniącą funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa sztucznego; wózek wyposażony w uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy i nóg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.



**Pytanie nr 23 dot. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt.**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację segmentu pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0° - 75°, dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców, dostępna w obu narożnikach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 24 dot. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt.**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego koła o średnicy 200 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego; wózek dodatkowo wyposażony w 5 koło ułatwiające manewrowanie wózkiem i precyzyjną jazdę, wyposażone w sprężynę dociskającą koło do podłoża?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 25 dot. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt.**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego w standardzie cztery koła, w tym jedno kierunkowe oraz wózka wyposażonego w dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, wyposażone w sprężynę dociskającą koło do podłoża?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 26 dot. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt.**

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego materac stabilizowany na wózku za pomocą specjalnych pasków do otworów znajdujących się w leżu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 27 dot. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt.**

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego barierki boczne metalowe zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża; dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta, barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych poziomą poprzeczką, kolorystyka wózka szara?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 28 dot. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt.**

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyty do prowadzenia, od strony głowy składane uchwyty, od strony nóg uchwyt w kształcie pałaka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

**Pytanie nr 29 dot. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt.**

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 2 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

**Pytanie nr 30 dot. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt.**

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie posiadającego metalowego relingu po obu bokach wózka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 31 dot. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt.**


Czy (w pkt. 21) Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w dwa wieszaki kroplówki tj. jeden umieszczony z lewej strony głowy pacjenta i drugi umieszczony z prawej strony głowy pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**Pytanie nr 32 dot. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt.**

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego wieszak kroplówki, który nie służy jako uchwyty transportowe?

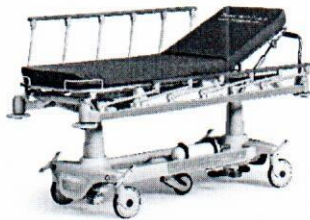

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

**Pytanie nr 33 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci-4szt.**

Dot. Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka 830 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

**Pytanie nr 34 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci-4szt.**

Dot. Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 614-864mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

**Pytanie nr 35 dot. Łóżko szpitalne dla dzieci-4szt.**

Dot. Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-41stopni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

**UWAGA :**

**1. Zmiana Terminu składania , otwarcia i związania ofertą.**

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z zmianami i przygotowania oferty.

**CZĘŚĆ IX Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:**

**Termin składania ofert:**

1. Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump) do dnia **02.10.2023 r. godz. 7:30**

**zmienia się na:**

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump) do dnia **16.10.2023 r. godz. 8:30**



## Część IX Rozdział II pkt.1 SWZ o treści:

### Termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.10.2023 r. o godzinie 08:00., na profilu Zamawiającego na [platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](http://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump) zmienia się na:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.10.2023 r. o godzinie 09:00., na profilu Zamawiającego na [platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](http://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump)

## Część VII Rozdział I pkt SWZ o treści:

### Rozdział I : Wniesienie wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, przed upływem terminu składania ofert, tj. do 02.10.2023r. godz. 07.30 i utrzymania wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2

### zmienia się na:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, przed upływem terminu składania ofert, tj. do 16.10.2023r. godz. 08.30 i utrzymania wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2

## Część VIII Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

### Rozdział I - Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.12 2023r. (nie dłużej niż 90 dni).

### zmienia się na:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13.01 2024r. (nie dłużej niż 90 dni).

Stosownie do treści art. 90 ust 1 ustawy Zamawiający udostępnia publikacje ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu realizacji, terminu składania, otwarcia i związania ofertą – w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  
p. o. Kierownik  
Biura Eksploatacji i Inwestycji  
inż. Piotr Szymański  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR  
SZPITALA KLINICZNEGO  
im. K. Jonschera UM w Poznaniu  
  
dr n. med. Paweł Daszkiewicz

Opracowała : Beata Zoellner

Dział Zamówień Publicznych  
tel.: 061- 84913-75  
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl  
www.skp.ump.edu.



PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem