

FZP.I-241/39/21

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą: „**ZAKUP MEDYCZNEGO SPRZĘTU BARIATRYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU „DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA” DLA POTRZEB SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129), udziela wyjaśnień do treści SWZ:

**1) Pytanie**

Dotyczy zapisów SWZ w zakresie zadania nr 1 – Stół operacyjny bariatryczny wraz z wyposażeniem  
Opis stołu wskazuje na konkretny model lub wykonawcę. Zamawiający wyznaczył przy tym bardzo krótki czas realizacji zadania, tj. 30 dni od dnia podpisania umowy, uniemożliwiając złożenie ofert konkurencyjnych przez innych wykonawców.

Przedmiotem postępowania jest zaawansowany, bardzo drogi stół operacyjny bariatryczny wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. W zasadzie, aby odpowiedzialnie złożyć ofertę w postępowaniu, w którym wyznaczono tak krótki termin realizacji, wykonawca musiałby posiadać taki stół fabrycznie nowy na stanie magazynowym, lub w toku zamówienia produkcyjnego. Także producenci realizują swoje plany wykonawcze i konfigurują urządzenia w oparciu o konkretne zamówienia od swoich dystrybutorów, na podstawie specyfikacji przetargowych.

Cykl realizacji zamówień w tego typu urządzeniach waha się w granicach 5-8 tygodni od chwili złożenia zamówienia przez dystrybutora. Ponadto dystrybutorzy, producenci i firmy spedycyjne pracują w rzeczywistości ogólnoświatowej pandemii, co ma zasadniczy wpływ na dostęp do surowców, czas produkcji i montażu oraz transport.

Czy zatem, aby umożliwić złożenie konkurencyjnych ofert przez innych wykonawców Zamawiający wydłużył termin realizacji zadania do 8 tygodni od chwili podpisania umowy? Jeśli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie terminu realizacji zgodzi się Zamawiający?

**Odpowiedź: Zamawiający wydłużył czas realizacji zadania do 40 dni.**

**2) Pytanie**


**Dotyczy zapisów opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 – Stół operacyjny bariatryczny wraz z wyposażeniem**

*Chcielibyśmy zaoferować zaawansowany stół operacyjny bariatryczny (o nośności powyżej 450 kg) z blatem modułowym, który można niemal dowolnie konfigurować, skracać lub wydłużać dla potrzeb konkretnej operacji, a także rozbudowywać w przyszłości o inne elementy i segmenty specjalistyczne. Oferowany przez nas stół wydaje się być podobny do opisanego w załączniku 2A do SWZ, posiada jednak pewne różnice, nie wpływające ujemnie na wymagania co do funkcjonalności. Prosimy zatem o odpowiedzi na poniższe pytania:*

1. *W zakresie pkt. 4 – Zamawiający wymaga, aby konstrukcja podstawy i kolumny wykonana była ze stali nierdzewnej polerowanej z ewentualnymi elementami z aluminium. Chcemy zaoferować stół o takiej właśnie konstrukcji. Czy jednak Zamawiający dopuszcza aby kolumna posiadała także element z tworzywa lub gumy, osłaniający ruchome elementy łączące kolumnę z blatem (siłowniki, przewody, mechanizmy ruchome)?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie**

2. W zakresie pkt. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie innego kształtu podstawy stołu, tj. równoległoboku, wąskiego przy kolumnie. Rozwiązanie zapewnia taką samą lub lepszą stabilność jak opisane w zestawieniu parametrów wymaganych (podstawa profilowana), ponadto umożliwi dojście operującego maksymalnie blisko do kolumny i blatu stołu. Jest to zatem rozwiązanie co najmniej równoważne. Poniżej rysunek poglądowy oferowanej podstawy stołu:

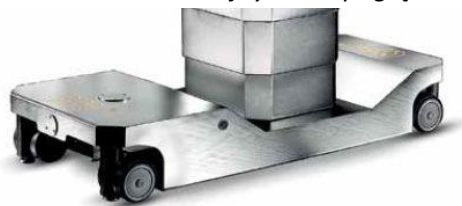

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

3. W zakresie pkt. 7: W związku z tym, że Zamawiający wymaga w dalszych wierszach, tj. pkt 9 podglówka z podwójną regulacją, prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stołu z blatem przeziernym dla promieni X w pozycji AP na całej długości, bez poprzecznych wzmocnień, poza segmentem podglówka, który to segment jest częściowo nieprzezierny ze względu na umiejscowienie w nim mechanizmu podwójnej artykulacji. Pole tejże nieprzezierności to zaledwie pas o szerokości 4 cm umiejscowiony na samym szczycie podglówka. Nie ma to zatem większego znaczenia dla funkcjonalności całego blatu podczas monitorowania pacjenta ramieniem C, gdyż głowa pacjenta i tak spoczywa niemal w całości w polu przeziernym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

4. W zakresie pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z leżem o szerokości 530 mm, co odbiega od wymagań zaledwie o 10 mm i nie wpływa na funkcjonalność stołu? Szerokość blatu oferowanego stołu wraz z listwami akcesoryjnymi – pozostaje przy tym zgodna z wymogami SWZ (tj. 590 mm)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

5. W zakresie pt. 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania segment głowy przezierny dla promieni RTG na całej długości, z pojedynczą regulacją?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

6. W zakresie pkt. 11: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyzna 10 pkt. dla rozwiązania, w którym przy obciążeniu min. 450 kg będzie dostępna pełna funkcjonalność, a zatem wszystkie funkcje stołu będą możliwe do realizacji w pełnym ich zakresie. Prosimy o rzetelną analizę tego parametru, gdyż jest on związany z bezpieczeństwem pacjenta. Z naszego doświadczenia wynika, że na rynku nie ma stołu operacyjnego, który spełniłby taki warunek. Przykładem może być sytuacja: odwrócona orientacja pacjenta z maksymalnym wysunięciem wzdłużnym blatu i przechyłem Trendelenburga. Trudno wyobrazić sobie stół lub blat, który przy zbiegu tych funkcji byłby w stanie bezpiecznie utrzymać obciążenie 450 kg, a zatem niemal pół tony, a na dodatek wykonywać przy tym przechyły czy przesuw w pełnym ich zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Dostępna pełna funkcjonalność stołu w pełnym zakresie pozycjonowania przy zachowaniu max udźwigu min. 450 kg otrzyma 10 pkt.**

7. W zakresie pkt. 11: Czy Zamawiający będzie wymagał od oferenta, aby przedstawił wiarygodne dokumenty (np. oświadczenie producenta lub dokumenty z badań) świadczące, że zaoferowany stół posiada pełną funkcjonalność w pełnym zakresie pozycjonowania przy udźwigu 450 kg? Parametr ten jest kluczowy dla bezpieczeństwa pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: materiały informacyjne uwiarygodniające podane informacje techniczne (katalogi, opisy, foldery itp.) w języku polskim, na podstawie, których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi.**

8. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z dodatkowym panelem sterującym na kolumnie, płaskim, którego powierzchnia i ramka wystaje ponad powierzchnię kolumny ok. 6 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

9. W zakresie pkt. 22: Czy Zamawiający określając parametr „Zakres regulacji segmentu pleców w zakresie min. -35 / +50” miał na myśli górnny segment oparcia pleców?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie**

10. W zakresie pkt. 30: Czy Zamawiający wymagając „Ręczna regulacja segmentu głowy w zakresie min. -45/+4” miał na myśli „min. -45 / +45 stopni”?

**Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne wymagania, zaproponowane parametry są lepsze od wymogów zamawiającego, więc zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

11. W zakresie pkt. 35: Czy nie doszło do omyłki w opisie: „materace stołu profilowane z tzw. pamięcią kształtu”? Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materacy przeciwodleżynowych, z tzw. pamięcią kształtu, o grubości 80 mm, o płaskiej powierzchni na której spoczywa pacjent, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

12. W zakresie pkt. 36: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania segment podgłówek z szynami akcesoryjnymi z dwóch stron?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

13. W zakresie pkt. 37 – wyposażenie – przystawka do operacji neurochirurgicznych. Chcielibyśmy zaoferować kompletną przystawkę do operacji neurochirurgicznych, która wydaje się zgodna z oczekiwaniem Zamawiającego. Prosimy jednak o potwierdzenie, że taki właśnie zestaw zaakceptuje Zamawiający (wg kolejności montażu elementów):  
- jednostka bazowa 1 – adaptor z klamrami montowany w miejsce podgłówek standardowego:



- jednostka bazowa 2 - łącznik aluminiowy z regulacją wielozakresową montowany do adaptora, tj. do jednostki bazowej 1:



- łącznik aluminiowy z regulacją 360° do połączenia jednostki bazowej 2 z uchwytem czaszki:



- aluminiowy uchwyt czaszki 3-punktowy:



- piny stalowe dla dorosłych (kpl. 3 szt.) – 2 kpl.:



Przykładowe pozycjonowanie pacjenta z zastosowaniem powyższego zestawu obrazuje poniższa fotografia:



**Odpowiedź: Przedstawiony opis i zdjęcia są na tyle mało precyzyjne, że zamawiający zaproponowane rozwiązanie nie może uznać za zgodne z oczekiwaniami zamawiającego.**

**3) Pytanie**

Czy Zamawiający w pakietach 2 oraz 3 zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy z 40 na 45 dni? Wydłużenie terminu pozwoliło by na pewną dostawę asortymentu bez ryzyka wysokich kar umownych

**Odpowiedź: Zamawiający ustalił termin dostawy na 40 dni.**

**4) Pytanie**

Dot. Pakietu 2 Pionizator pacjenta - zmotoryzowany szt. 2. Pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pionizator pacjenta, w którym promień zawracania w pozycji krzesła wynosi 1840mm co tylko nieznacznie różni się od parametru wymaganego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**5) Pytanie**

Dot. Pakietu 2 Pionizator pacjenta - zmotoryzowany szt. 2 Warunki Gwarancji

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w punkcie 48 tj. „Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 5” ?

**Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli max 5 dni czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym**

**6) Pytanie**

Dotyczy pakietu 3. BARIATRYCZNY PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY – 3szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości podnośnik nieposiadający sygnału dźwiękowego informującego o konieczności naładowania akumulatora?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**7) Pytanie**

Dotyczy pakietu 3. BARIATRYCZNY PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY – 3szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości podnośnik bez wyświetlacza LCD?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**8) Pytanie**

Dotyczy pakietu 3. BARIATRYCZNY PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY – 3szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości podnośnik, którego wysokość podnoszenia regulowana jest do 177,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**9) Pytanie**

Dotyczy pakietu 3. BARIATRYCZNY PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY – 3szt. Pkt. 20.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości podnośnik, którego rozstaw podstawy regulowany jest elektrycznie w zakresie: od 69cm do 106,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**10) Pytanie**

Dot. Pakietu 2 C BARIATRYCZNY PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY szt. 3 Warunki Gwarancji

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w punkcie 37 tj. „Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 5” ?

**Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli max 5 dni czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym**

**11) Pytanie**

Zadanie nr 3 - Bariatryczny podnośnik elektryczny -3 sztuki

• Czy w rozumieniu pkt 7 Zamawiający dopuści pilot magnetyczny do przymocowania w dowolnym miejscu podnośnika?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**12) Pytanie**

Zadanie nr 3 - Bariatryczny podnośnik elektryczny -3 sztuki Czy w rozumieniu pkt 12 Zamawiający dopuści brak wyświetlacza LCD na panelu sterowania? O konieczności naładowania akumulatora informuje sygnał dźwiękowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**13) Pytanie**

Zadanie nr 3 - Bariatryczny podnośnik elektryczny -3 sztuki Czy w rozumieniu pkt 15 Zamawiający dopuści bariatryczny podnośnik elektryczny z wysokością podstawy jezdnej 130 mm? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**14) Pytanie**

Zadanie nr 3 - Bariatryczny podnośnik elektryczny -3 sztuki

Czy w rozumieniu pkt 20 Zamawiający dopuści bariatryczny podnośnik elektryczny regulowaną szerokością zewnętrznej podstawy jezdnej 650-1230 mm? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**15) Pytanie**

Czy Zamawiający wymaga aby stół był fabrycznie nowy rok produkcji 2021?

**Odpowiedź: Tak**

**16) Pytanie**

pkt 4 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elementami konstrukcji podstawy wykonanymi z żeliwa?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**17) Pytanie**

pkt 11 Co Zamawiający rozumie poprzez pełną funkcjonalność stołu przy zachowaniu max udźwigu min 450kg? Czy Zamawiający uzna i przyzna 10 pkt następującym funkcjonalnością sterowanymi z pilota przy max wadze pacjenta 454kg : przechyły boczne 20 stopni , regulacja trendelenburga 25 stopni i antytrendelenburga 35 stopni, regulacja płyty plecowej min -40/ + 70 stopni , regulacja wysokości do max 800mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie uzna i nie przyzna 10 pkt za przedstawioną funkcjonalność**

**18) Pytanie**

Czy Zamawiający będzie wymagał oryginalnej dokumentacji producenta na poświadczenie spełnienia wymogu w pkt 11 „Dostępna pełna funkcjonalność stołu w pełnym zakresie pozycjonowania przy zachowaniu max udźwigu min. 450 kg „ w instrukcji obsługi stołu operacyjnego ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: materiały informacyjne uwiarygodniające podane informacje techniczne (katalogi, opisy, foldery itp.) w języku polskim, na podstawie, których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi.**

**19) Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z funkcją blokowania i odblokowywania stołu za pomocą dźwigni nożnej z jednoczesną wizualizacją na pilocie funkcji czy stół jest zablokowany czy odblokowany?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**20) Pytanie**

pkt 31 Czy Zamawiający ze względu na zastosowanie stołu do bariatryki przy przyjęciu ,że na stole będą operowani pacjenci o wadze 300-400kg a tym samym jedna noga takiego pacjenta będzie ważyć ponad 70 kg ,będzie wymagał aby stół miał funkcję sterowania segmentu nóg elektrycznie z pilota? Trudno sobie wyobrazić aby personel musiał wykonywać podnoszenie nogi pacjenta bariatrycznego o wadze ponad 70 kg ręcznie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**



**21) Pytanie**

Umowa: Par.3.ust 7 – prosimy o zapis o informowaniu tylko mailem za potwierdzeniem odbioru żadnych powiadomień telefonicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza danego zapisu**

**22) Pytanie**

Umowa: par. 7 – Prosimy o zmianę zapisu. Zapewniamy szkolenie z konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi. Naprawy robą przeszkoleni inżynierowie posiadający certyfikat zdobyty u producenta, nie możemy szkolić innych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza danego zapisu**

**23) Pytanie**

Umowa: par 8, pkt 3, 2) – prosimy o wykreślenie - tego typu postanowienia są skrajnie niekorzystne oraz obciążone wysokim ryzykiem kontraktowym.

**Odpowiedź: Zamawiająca nie zmienia zapisów w projekcie umowy w par. 8**

**24) Pytanie**

Umowa – par. 12. Pkt 1 - czy Zamawiający potwierdzi, że każdorazowo nabędzie prawo odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń o których mowa §12 ust. 1, wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**25) Pytanie**

STÓŁ OPERACYJNY BARIATRYCZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z napędem elektromechanicznym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**26) Pytanie**

STÓŁ OPERACYJNY BARIATRYCZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z funkcją programowania najczęściej stosowanych pozycji min.2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**27) Pytanie**

STÓŁ OPERACYJNY BARIATRYCZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM dot. pkt. 15

Czy Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z funkcją automatycznej deaktywacji /aktywacji pilota ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**28) Pytanie**

STÓŁ OPERACYJNY BARIATRYCZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM dot. pkt. 17

Czy Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z funkcją informacji poziomu naładowania akumulatorów w 2 kolorach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**29) Pytanie**

STÓŁ OPERACYJNY BARIATRYCZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM dot. pkt. 36

Czy Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z podgłówkiem z szynami umiejscowionymi z 2 stron

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**30) Pytanie**

STÓŁ OPERACYJNY BARIATRYCZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM dot. pkt. 43

Czy Zamawiający dopuszcza termin dostawy i instalacji max. 50 dni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający ustalił termin dostawy na 40 dni**

**31) Pytanie**

Zadanie nr 3 pkt. 20 dopuszczenie zakresu regulacji podstawy od 730 mm do 1050 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**32) Pytanie**

Zadanie 1 - STÓŁ OPERACYJNY BARIATRYCZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM (1 SZTUKA) Czy zamawiający dopuści w punkcie 2, podpunkt 4 : Konstrukcję podstawy i kolumny wykonanej z tworzywa sztucznego (w płaszczyznach pionowych) i ze stal nierdzewnej polerowanej (w płaszczyźnie poziomej) zapewniającej stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**33) Pytanie**

Zadanie 1 - STÓŁ OPERACYJNY BARIATRYCZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM (1 SZTUKA) Czy zamawiający dopuści w punkcie 2, podpunkt 12: Funkcje sterowane za pomocą pilota z kolorowym wyświetlaczem

- góra/dół,
- przechyty boczne,
- pozycja anty i Trendelenburga,
- pozycja „flex” i „reflex”,
- segment plecowy
- graficzne przypomnienie o konieczności manualnego zablokowania stołu, celem aktywacji funkcji pilota
- przesuw wzdłużny

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**34) Pytanie**

Zadanie 1 - STÓŁ OPERACYJNY BARIATRYCZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM (1 SZTUKA) Czy zamawiający dopuści w punkcie 2, podpunkt 13: Czytelna informacja o stanie naładowania baterii w postaci wyskalowanego obrazu graficznego wskazującego poziom naładowania baterii?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**35) Pytanie**

Zadanie 1 - STÓŁ OPERACYJNY BARIATRYCZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM (1 SZTUKA) Czy zamawiający dopuści w punkcie 2, podpunkt 22: Zakres regulacji segmentu pleców w zakresie min.  $-40^{\circ}$  /  $0^{\circ}$

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**36) Pytanie**

Zadanie 1 - STÓŁ OPERACYJNY BARIATRYCZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM (1 SZTUKA) Czy zamawiający dopuści w punkcie 2, podpunkt 28: Zakres elektrycznej regulacji pozycji flex/reflex z zakresie  $220^{\circ}$  /  $110^{\circ}$

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**37) Pytanie**

Zadanie 1 - STÓŁ OPERACYJNY BARIATRYCZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM (1 SZTUKA) Czy zamawiający dopuści w punkcie 2, podpunkt 32: Ręczna regulacja odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie  $120^{\circ}$

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**38) Pytanie**

Dotyczy: Zadanie nr 3 Bariatryczny podnośnik elektryczny Czy zamawiający dopuści maksymalny udźwig wynoszący 230 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**39) Pytanie**

Dotyczy: Zadanie nr 3 Bariatryczny podnośnik elektryczny Ile i jakiego rodzaju podwieszki zamawiający planuje zamówić?

**Odpowiedź: 4 rozmiary po 1 szt. (zgodnie z pkt. 24)**



**40) Pytanie**

Dotyczy: Zadanie nr 2 Pionizator pacjenta zmotoryzowany

Czy zamawiający przewiduje zakup pasów do pionizacji? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości oraz rozmiarów pasa (S,M,L).

**Odpowiedź: Po 1 szt. w rozmiarze S, M, L**