



WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: **Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **TP 9/2024**

- I. Działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 oraz art. 286 ust.1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.1605 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

Część 1

W związku z oferowanym asortymentem w pojedynczych opakowaniach (poza zestawem do krwi kontrolnej), prosimy o modyfikację nazw kolumn i zmianę nazewnictwa z „zestawu” na „opakowanie”.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zmienia treść SWZ w opisanym zakresie, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień - Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty_ZMIANA

Pytanie 2

Część 1 tabela, pkt. 37

Prosimy o doprecyzowanie, iż poprzez „czas reakcji serwisu do 2h” Zamawiający rozumie również kontakt telefoniczny z inżynierem.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, iż poprzez zwrot „czas reakcji serwisu do 2h” rozumie również kontakt telefoniczny z inżynierem, zgodnie z treścią załącznika do niniejszych wyjaśnień - Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty_ZMIANA

Pytanie 3

Część 1 tabela, pkt. 38:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, by w przypadku istotnej awarii Wykonawca miał możliwość zaoferowania tożsamego analizatora, sprawnego i w pełni funkcjonującego, zgodnego z tym, który będzie oferowany w tym postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyraża zgodę oraz zmienia treść SWZ w opisanym zakresie, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień - Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty_ZMIANA

Pytanie 4

Część 1 pkt 41

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem:

Odpowiedź na pytanie nr 4

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty_ZMIANA

Pytanie 5

Część 1

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1.1 do Formularza oferty, pkt. 27 – termin dostawy odczynników wynosi 3 dni robocze?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający zmienia treść SWZ w opisanym zakresie, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień - Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty_ZMIANA

Pytanie 6

Projekt Umowy

Uprzejmie prosimy również o odpowiednią modyfikację w Tomie II SWZ – Projekcie umowy §3 ust. 4 i zastąpienie wyrażenia „do 48 godzin od złożenia zamówienia, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.” zwrotem „3 dni robocze od daty zamówienia”

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w opisanym zakresie bez zmian.

Pytanie 7

Projekt umowy §3 ust. 1

Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznie” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nieodpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej te zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez wykreślenie zwrotu „telefonicznie” zmienia, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień - Tom II Projekt umowy _ZMIANA

Pytanie 8

Projekt umowy §4 ust. 2

Prosimy o uzupełnienie zapisu dla Części 1 poprzez dodanie po wyrażeniu „minimalny okres ważności materiałów wzorcujących i kontrolnych” zwrotu: „w przypadku, gdy będzie rozdysponowywany wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”. Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający zmienia treść SWZ w opisanym zakresie, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień - Tom II Projekt umowy _ZMIANA

Pytanie 9

Projekt umowy §6 ust. 3:

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż zapis dotyczący dostarczenia pakietu startowego odczynników nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca zaoferuje jako przedmiot dzierżawy analizator aktualnie znajdujący się u Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający potwierdza, iż zapis dotyczący dostarczenia pakietu startowego odczynników nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca zaoferuje jako przedmiot dzierżawy analizator aktualnie znajdujący się u Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień - Tom II Projekt umowy _ZMIANA

Pytanie 10

Projekt umowy §7 ust. 4

W celu ujednoczenia zapisu z Załącznikiem nr 1.1 do Formularza oferty, pkt. 24 uprzejmie prosimy o dodanie po wyrażeniu „Przez reakcję serwisu należy rozumieć fizyczne” zwrotu „lub zdalne”.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający zmienia treść SWZ w opisanym zakresie, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień - Tom II Projekt umowy _ZMIANA

Pytanie 11

Projekt umowy §14 ust. 1 pkt 1.1 lit. d):

Prosimy zastąpienie słowa: „opóźnienia” na „zwłoki”. Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 1) oraz 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający zmienia treść SWZ w opisanym zakresie, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień - Tom II Projekt umowy _ZMIANA

Pytanie 12

Projekt umowy §14 ust. 1 pkt 1.1. lit. e):

Uprzejmie prosimy o zastąpienie wyrażenia „za każdą godzinę” zwrotem „za każdy dzień”. Zastrzeżenie kary nielicznej za każdą godzinę przekroczenia terminu reakcji serwisu ma charakter zawyżony, np. w przypadku drobnego naruszenia nie skutkującego żadną szkodą dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający pozostawia zapisy treści umowy w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 13

Projekt umowy §19 ust. 3 i 4:

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych (informowanie o potencjalnych zagrożeniach) i w sprawach dotyczących działań logistycznych, na wskazany w §19 ust. 3 adres e-mail w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający dopuszcza kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych i w sprawach dotyczących działań logistycznych.

Pytanie 14

Projekt umowy

Uprzejmie prosimy również o doprecyzowanie czy osoby wskazane w §19 ust. 3 są osobami wyłącznie odpowiedzialnymi za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie przez te osoby mają być realizowane?

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcia sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający informuje, iż do składania zamówień upoważnionych będzie więcej osób niżeli jedna.

Pytanie 15

Część 1 Dot. Pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym ilość odczynników roboczych koniecznych do wykonania pełnego badania w trybie wynosi 6?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie dopuszcza ilość 6 odczynników roboczych koniecznych do wykonania pełnego badania ze względu na wyższe koszty eksploracji i wzrost kosztu badania.

Pytanie 16

Część Dot. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym objętość aspirowanego materiału do wykonania pełnego badania morfologii krwi wynisi 80 µl oraz 85 µl dla płynów z jam ciała?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający dopuszcza analizator, w którym objętość aspirowanego materiału do wykonania pełnego badania morfologii krwi wynosi 80 µl oraz 85 µl dla płynów z jam ciała.

Pytanie 17

Część 1 Dot.Pkt.32

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym czas uruchomienia analizatora z pozycji czuwaj do podjęcia pracy trwa 10 minut?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający dopuszcza analizator, w którym czas uruchomienia analizatora z pozycji czuwaj do podjęcia pracy trwa 10 minut.

Pytanie 18

Część 1 Dot. Pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym jest możliwość zdalnego dostępu przez inżyniera serwisowego do aplikacji na komputerze zewnętrznym?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający dopuszcza analizator, w którym jest możliwość zdalnego dostępu przez inżyniera serwisowego do aplikacji na komputerze zewnętrznym.

Pytanie 19

Część 2

Czy zamawiający zgodzi się na możliwość złożenia oferty na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej przez okres 24 miesięcy ?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej przez okres 24 miesięcy. Zamawiający zmienia treść SWZ zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty_ZMIANA

Pytanie 20

Część 2 pkt 19

Czy zamawiający dopuści objętość próbki krwi dla wszystkich parametrów (BG - ISE - MSS - COOX) maximum 210 µl?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający dopuszcza objętość próbki krwi dla wszystkich parametrów (BG - ISE - MSS - COOX) maximum 210 µl.

Pytanie 21

Część 2 pkt 20

Czy zamawiający dopuści zakresy pomiarowy dla PO₂ parcjale ciśnienie tlenu – 0,0 – 800 mmHg?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający dopuszcza zakresy pomiarowy dla pO₂ parcjale ciśnienie tlenu – 0,0 – 800 mmHg

Pytanie 22

Wnioskujemy od odstąpienie od wymogu dostarczania dokumentów potwierdzających udostępnienie wyrobu na rynku tj. przedstawienia potwierdzenia dokonania notyfikacji w URPL.


Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) dokonywanie notyfikacji w formie papierowej zostało zastąpione dokonywaniem rejestru w systemie informatycznym "wykaz dystrybutorów", w którym dystrybutor obowiązkowo dokonuje wpisu o każdym sprowadzonym po raz pierwszy wyrobie, systemie lub zestawie zabiegowym. Dane gromadzone w powyższy systemie informatycznym dostępne są dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający odstępuje od wymogu opisanego w pytaniu.

Pytanie 23

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ? Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

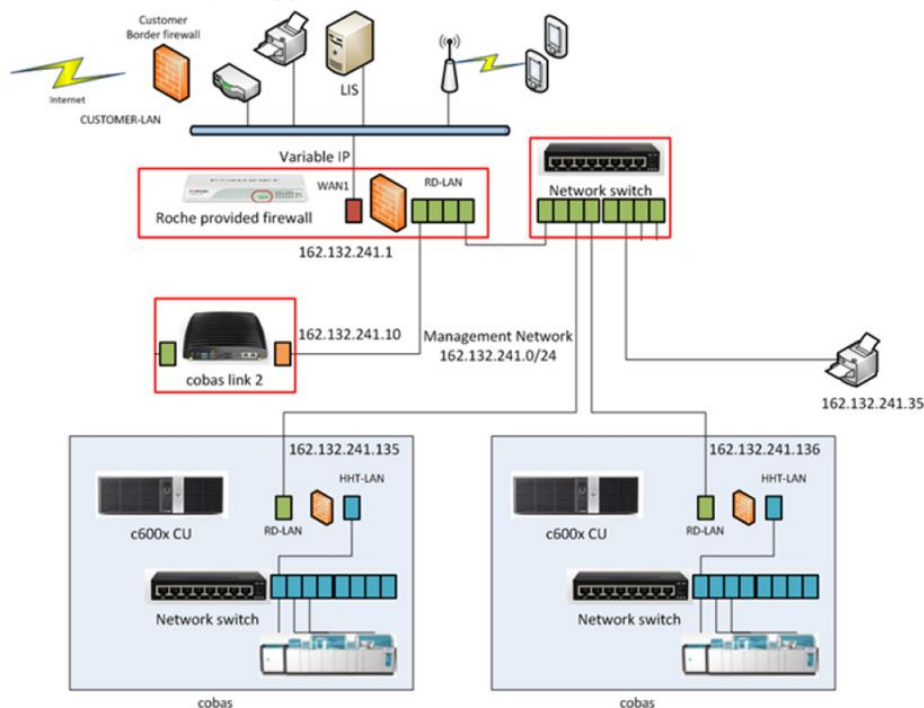

URL	IP	Port	Typ	Opis
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Główne połączenia umożliwiające usługi zdalne
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Bezpośrednie	Dedykowane połączenia umożliwiające wsparcie zdalne
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Bezpośrednie	Dedykowane połączenia umożliwiające wsparcie zdalne
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Bezpośrednie	Dedykowane połączenia umożliwiające wsparcie zdalne
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Bezpośrednie	Dedykowane połączenia umożliwiające wsparcie zdalne
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Bezpośrednie	Dedykowane połączenia umożliwiające wsparcie zdalne
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Bezpośrednie	Dedykowane połączenia umożliwiające wsparcie zdalne
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Bezpośrednie	Dedykowane połączenia umożliwiające wsparcie zdalne
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Bezpośrednie	Dedykowane połączenia umożliwiające wsparcie zdalne
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Bezpośrednie	Dedykowane połączenia umożliwiające zarządzanie FortiGate

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający zapewni dostęp do sieci lokalnej.

- II. Zamawiający w oparciu o art. 286 ust. 3 i 284 ust. 3 ustawy Pzp zmienia terminy składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Nowy termin składania ofert: 12.07.2024 r. godz.10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 12.07.2023 r. godz.11:00

Skutkiem powyższej zmiany, zmianie ulega brzmienie pkt 11.1. TOM I SWZ, który przyjmuje następujące brzmienie:

„11.1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.08.2024 r.”

- III. Mając na względzie udzielone odpowiedzi skutkujące zmianą treści SWZ, Zamawiający zamieszcza w dokumentacji postępowania na Platformie Zakupowej **Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty ZMIANA, Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty ZMIANA oraz Tom II Projekt umowy ZMIANA** uwzględniający dokonane zmiany.

- IV. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu
Tamara Gronicz-Mleczeko