

Toruń, dnia 05-01-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-131/23

dotyczy: postępowania na **dostawę odczynników immunohistochemicznych oraz zestawów do diagnostyki RT PCR wraz z dzierżawą analizatorów.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie Nr 1:

Dotyczy Załącznika Nr 2/1b do SWZ, pkt. V ppkt. 9

Czy Zamawiający udostępni w swoich zasobach zgodnie z poniższymi parametrami serwer wirtualny (maszynę wirtualną) w celu instalacji systemu IT do integracji systemu barwiącego a posiadanym przez zamawiającego systemem LIS ?

OS: Win 10 / Win Srv 2016 / 2019 64-bit

CPU: 2 cores - 2-3 GHz

RAM: min 8 GB

HDD: min 150 GB

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający udostępni maszynę wirtualną ze swoich zasobów.

Pytanie Nr 2:

Czy zamawiający w celu zapewnienia serwisu zdalnego udostępni w swoich zasobach sieciowych dostęp do internetu dla serwera / maszyny wirtualnej systemu IT do integracji systemu barwiącego a posiadanym przez zamawiającego systemem LIS ? Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach.

URL	IP	Port
*. navify.com	193.58.155.0/24	443
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443
remoteserivce-dr.roche.com	209.202.167.21	443
teleservice.roche.com	196.3.50.39	80 + SOAP
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443
rln-cm-**.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541


Odpowiedź:

TAK

Pytanie Nr 3:

Dotyczy Załącznika Nr 2/2b do SWZ, pkt. A ppkt. 22

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczytnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu? Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

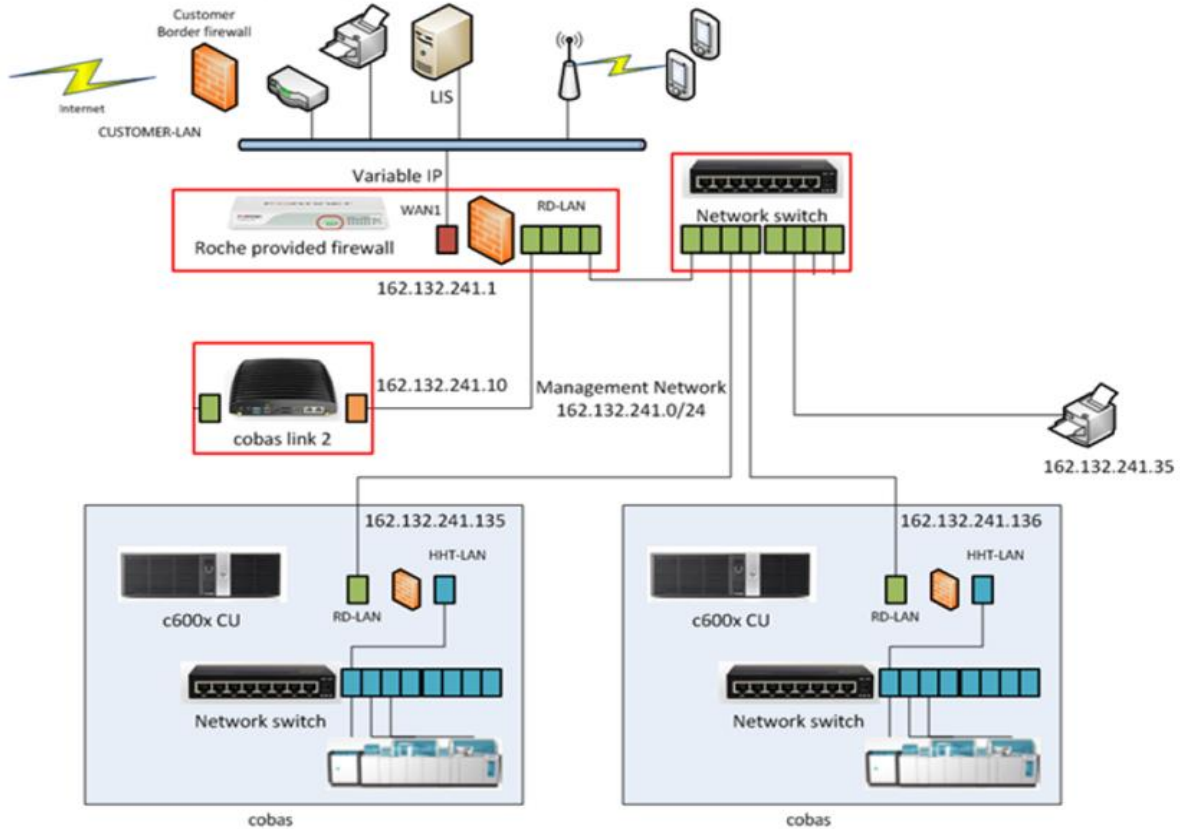

URL	IP	Port
*.navify.com	193.58.155.0/24	443
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443
teleservice.roche.com	196.3.50.39	80 + SOAP
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541

Odpowiedź:

TAK

Pytanie Nr 4:

Dotyczy Załącznika Nr 2/2 do SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie w Załączniku Nr 2/2 do SWZ w punkcie I.1 tabeli "Zestaw do diagnostyki RT PCR 480 ozn. w zestawie IVD" jakie oznaczenie ma zostać wycenione.

Odpowiedź:

Genotypowanie wysokoonkogennych wirusów HPV.

Pytanie Nr 5:

Dotyczy Załącznika Nr 2/2b do SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie dostawcy LIS Zamawiającego w związku z wymogiem punktu 22 tabeli "Pełna Integracja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym po stronie i na koszt Wykonawcy"

Odpowiedź:

Infomedica LIS, producent Asseco Poland S.A.

Pytanie Nr 6:

Dotyczy Załącznika Nr 2/2b do SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w punkcie 14 tabeli "Analizator do automatycznej izolacji, amplifikacji i detekcji kwasów nukleinowych w technologii RT-PCR – 1 szt." aparatu wyposażonego w czytnik RFID (Radio-Frequency IDentification) umożliwiający identyfikację i monitorowanie statusu odczynników drogą radiową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7:

Dotyczy Załącznika Nr 2/1b do SWZ - VII Serwis i warunki gwarancji

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu "Możliwość wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni" na "Możliwość wykonania badań w innym ośrodku na koszt Wykonawcy w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pod warunkiem, że Zamawiający wskaże miejsce wykonania oznaczeń.

Pytanie Nr 8:

Dotyczy Załącznik Nr 2/2b do SWZ - II Serwis i warunki gwarancji

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu "Możliwość wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni" na "Możliwość wykonania badań w innym ośrodku na koszt Wykonawcy w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pod warunkiem, że Zamawiający wskaże miejsce wykonania oznaczeń.

Pytanie Nr 9:

Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w pozycji 27 przeciwciała CD8 klon SP239.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 10:

Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie pozycji 58 anti-CD14 (EPR3653), ponieważ nie posiadamy tego testu w sprzedaży.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji 58 anti-CD14 (EPR3653) z Załącznika Nr 2/1 do SWZ. Aktualny Załącznik Nr 2/1 do SWZ zostaje umieszczony na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego - https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun.

Pytanie Nr 11:

Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ

Ze względu na wyszczególnienie takiego samego przeciwciała w pozycji 41 oraz 67 anti-Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (polyclonal) zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość wyszczególnienia przeciwciała tylko w jednej pozycji z odpowiednim przeliczeniem sumarycznej ilości szacunkowej zamawianej ilości testów w skali 24 m-cy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. *Aktualny Załącznik Nr 2/1 do SWZ zostaje umieszczony na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego - https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun.*

Pytanie Nr 12:

Dotyczy Załącznika Nr 2/1 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyszczególnienie całej detekcji niezbędnej do wykonania 24 000 oznaczeń w części III. Materiały eksploatacyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 13:

Dotyczy Załącznika Nr 2/1b i Nr 2/2b do SWZ

Czy w kolumnie "Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE będzie wystarczające wpisanie słowa TAK jako potwierdzenie warunku oferowanego?"

Odpowiedź:

TAK

Pytanie Nr 14:

Dotyczy Załącznika Nr 2/2b do SWZ, pkt 1, podpunkt 2:

W związku z wymogiem zapewnienia wyposażenia dodatkowego, prosimy Zamawiającego o wskazanie preferowanego modelu szafy chłodniczej i/lub parametrów tj. pojemność w litrach, zakres temperatury chłodzenia, wymiary w cm (dł x szer x wys)

Odpowiedź:

- Pojemność komory chłodniczej: ok. 320 litrów
- Zakres temperatury chłodzenia 1-10° C
- Wymiary (GxSxW): ok. 60 x 60 x 173 cm

Pytanie Nr 15:

Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Umowa dostawy (par. 4 ust. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Obecny zapis dopuszcza możliwość naliczenia kary również od części umowy, wobec której nastąpiło odstąpienie.

Pytanie Nr 16:

Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Umowa dostawy (par. 4 ust. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 17:

Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Umowa dostawy (par. 4 ust. 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 18:

Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Umowa dostawy (par. 4 ust. 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5-dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 19:

Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Umowa dostawy (par. 4 ust. 6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 20:

Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Umowa dostawy (par. 4 ust. 7)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 21:

Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Umowa dostawy (par. 6 ust. 1 pkt 1)

Zwracamy się z prośbą o zmianę 15% na 25% zgodnie z brzmieniem par. 5 ust. 11.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 22:

Dotyczy Załącznika Nr 5/1 do SWZ - Umowa dzierżawy (par. 1 ust. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie informuje, że zapis w Rozdz. VI pkt. 2.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„2.1 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot dzierżawy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w terminie 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy.”

Natomiast zapis § 1 ust. 3 i 4 wzoru umowy dzierżawy otrzymuje brzmienie:

„3. Wyzierżawiający przekaze sprzęt Dzierżawcy w ciągu 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w formie papierowej.

4. Wyzierżawiający zobowiązany jest w cenie oferty dostarczyć i uruchomić przedmiot dzierżawy w terminie 7 dni licząc od dnia dostawy i przeszkolić pracowników Dzierżawcy z zakresu jego obsługi.”

Pytanie Nr 23:

Dotyczy Załącznika Nr 5/1 do SWZ - Umowa dzierżawy (par. 5 ust. 1 pkt 1.2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 24:

Dotyczy Załącznika Nr 5/1 do SWZ - Umowa dzierżawy (par. 5 ust. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana zapisu zgodnie z odpowiedzią na Pytanie Nr 7 i Nr 8.

Pytanie Nr 25:

Dotyczy Załącznika Nr 5/1 do SWZ - Umowa dzierżawy (par. 5 ust. 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wg załączonego wzoru?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 26:

Dotyczy Załącznika Nr 5/1 do SWZ - Umowa dzierżawy (par. 7 ust. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis nie dotyczy dostaw towaru, ale nienależytego wykonania umowy dzierżawy i Zamawiający podtrzymuje jego treść.

Pytanie Nr 27:

Dotyczy Załącznika Nr 5/1 do SWZ - Umowa dzierżawy (par. 7 ust. 5 par. 4 ust. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis nie dotyczy dostaw towaru, ale nienależytego wykonania umowy dzierżawy i Zamawiający podtrzymuje jego treść.

Pytanie Nr 28:

Dotyczy Załącznika Nr 5/1 do SWZ - Umowa dzierżawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem