



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 3001 /2022

Data: 19.07.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. wraz z montażem, instalacją i jego uruchomieniem” Znak Sprawy 1665/ 2022

„Zakup cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. wraz z montażem, instalacją i jego uruchomieniem” dofinansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Dotyczy SWZ, Rozdział VI, pkt 1 oraz wzór umowy, par. 4 ust. 1

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy. Obecnie z uwagi na panującą pandemię Covid-19 oraz związaną z tym zwiększoną ilość zamówień urzędów medycznych, w tym urzędów do diagnostyki obrazowej, terminy ich produkcji są wydłużone w stosunku do okresu przed rozpoczęciem pandemii. Dodatkowo na rynku obserwuje się kryzys, jeśli chodzi o dostępność układów elektronicznych, niezbędnych do produkcji szerokiej gamy urządzeń, w tym aparatów medycznych. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 2

Dotyczy SWZ, Rozdział VI, pkt 1 oraz wzór umowy, par. 4 ust. 1

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, GENERATOR, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający generator wysokiej częstotliwości kluczkowania napięcia o wartości maksymalnej 70 kHz?

Parametr ten jest ściśle związany ze specyfikacją techniczną generatora i nie ma wpływu na kliniczne działanie systemu. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, GENERATOR, pkt. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego maksymalną wartość $mAs \geq 630$ [mAs]. Aparat został zaprojektowany z myślą o najwyższej jakości obrazowania przy jak najmniejszej dawce – stąd brak konieczności wyższych nastawów mAs. Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy



system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 4

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG ZMOTORYZOWANE, pkt. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu o zakresie obrotu lampy wokół osi pionowej (od pozycji środkowej) $+135^{\circ}/-180^{\circ}$, niebędącego wyposażonym w motoryzację obrotu wokół osi pionowej. Jest to jedyna oś ruchu zawieszenia sufitowego nieposiadająca motoryzacji. Jest ona również najrzadziej wykorzystywana klinicznie. Pozostałe osie ruchów zawieszenia sufitowego są zmotoryzowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 5

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG ZMOTORYZOWANE, pkt. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu z zakresem zmotoryzowanego ruchu poprzecznego lampy wynoszącym ≥ 190 cm. Zakres ten pozwala na swobodne korzystanie z zakresu ruchu lampy poza obszarem stołu RTG (ekspozycje pacjentów na łóżkach).

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 6

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, LAMPY RTG i KOLIMATOR, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający lampę RTG o rozmiarze ogniska dużego $\leq 1,3$ (Zgodnie z IEC 60336)? Aparat dzięki wyposażeniu w detektory cyfrowe o bardzo wysokich parametrach obrazowania zapewnia wzrost wykrywalności drobnych struktur anatomicznych do 40%.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 7

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, LAMPY RTG i KOLIMATOR, pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający pojemność cieplną anody ≥ 350 kWh?

Aparat został zaprojektowany z myślą o najwyższej jakości obrazowania przy jak najmniejszej dawce dzięki czemu anoda lampy nie jest narażona na konieczność absorpcji dużych energii.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE nr 8

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, LAMPY RTG i KOLIMATOR, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający lampę RTG o pojemności cieplnej kołpaka lampy $\geq 1,5$ MHU?

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE nr 9

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, LAMPA RTG i KOLIMATOR, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający lampę RTG o szybkości chłodzenia anody ≥ 75 kHu/min? Różnica pomiędzy parametrem oferowanym a wymaganym nie jest znacząca.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 10

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, LAMPA RTG i KOLIMATOR, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający lampę RTG mocy ogniska małego ≥ 32 kW?

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 11

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, LAMPA RTG i KOLIMATOR, pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający lampę RTG mocy ogniska dużego ≥ 96 kW? Różnica pomiędzy parametrem oferowanym a wymaganym jest znikoma.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 12

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, LAMPA RTG i KOLIMATOR, pkt. 17

Prosimy o potwierdzenie, że przez automatyczną korekcję lampy do ustawienia pacjenta za pomocą kamery, Zamawiający miał na myśli wyposażenie kamery w dodatkowe funkcjonalności 3D, pozwalające m.in na pomiar grubości fizycznej pacjenta w celu lepszego doboru parametrów ekspozycji.

W przypadku braku potwierdzenia prosimy o rezygnację z tej funkcjonalności lub doprecyzowanie tego wymogu oraz wymaganie wariantowe TAK/NIE wraz z ewentualnym wprowadzeniem punktacji dodatkowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza i pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 13

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, STÓŁ PACJENTA, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający automatyczne podążanie detektora za lampą RTG przy jej przesuwie w osi długiej stołu w zakresie min. 35.5 cm?.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 14

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, STÓŁ PACJENTA, pkt. 2

Zwracamy uwagę Zamawiającego, na brak sformułowania w tym wymaganiu konieczności podążania detektora w stole za lampą RTG przy jej obrocie wokół osi poziomej co ma kluczowe znaczenie na przykład przy obrazowaniu miednicy.

Proponujemy zatem modyfikację tego punktu wymagań:

„Automatyczne podążanie detektora w stole za lampą RTG przy jej przesuwie w osi długiej stołu oraz obrocie wokół osi poziomej w zakresie min 35.5 cm.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 15

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, STÓŁ PACJENTA, pkt. 4



Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający stół diagnostyczny o minimalnej odległości blatu od podłogi $\leq 58\text{cm}$? Różnica między parametrem oferowanym a wymaganym jest znikoma.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 16

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, STÓŁ PACJENTA, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający stół diagnostyczny o przesuwie wzdłużnym blatu $\geq 111\text{ cm}$? Różnica między parametrem oferowanym a wymaganym jest znikoma w porównaniu do dostępnego zakresu ruchu. Dodatkowo stół dzięki dużemu rozmiarowi blatu posiada pokrycie pacjenta na poziomie 184x61 cm co jest wartością klinicznie wystarczającą.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 17

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, STÓŁ PACJENTA, pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający stół diagnostyczny o przesuwie poprzeczny blatu $\geq 22\text{ cm}$? Stół dzięki dużemu rozmiarowi blatu posiada pokrycie pacjenta na poziomie 184x61 cm co jest wartością klinicznie wystarczającą.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 18

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, STÓŁ PACJENTA, pkt. 14

Wnoskujemy o modyfikację tego punktu Wymagań jako niemającego zastosowania klinicznego. W praktyce Techniki RTG przygotowując badanie do wykonania, steruje wysokością stołu w celu ułatwienia pozycjonowania pacjenta, a lampa RTG automatycznie utrzymuje odległość SID. Automatyczna nadażność odwrotna, czyli ruch stołu występujący bez kontroli Technika może powodować dyskomfort pacjenta.

Zatem proponujemy:

„Nadażanie lampy za zmianą wysokości detektora w stole”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 19

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, STÓŁ PACJENTA, pkt. 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich wyłącznie na statywie do zdjęć odległościowych po zaznaczeniu punktu początkowego i końcowego wykonywane za pomocą skręcania lampy RTG przy zachowaniu jej położenia wysokościowego.

Wykonywanie zdjęć kości długich na stole diagnostycznym jest rzadko wykorzystywane klinicznie ze względu na konieczność wystąpienia fizjologicznego obciążenia elementów anatomicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 20

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, RUCHOMY ZMOTORYZOWANY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH, pkt. 2

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że funkcjonalność zmotoryzowanego przesuwu stojaka z detektorem Bucky w poziomie jest, podobnie jak punkty 3 i 4 Wymagań, bezpośrednio związana z technicznym rozwiązaniem jego konstrukcji (statyw jezdny). W punkcie 3 i 4 Zamawiający wprowadza wariantowość takiego rozwiązania – wnoskujemy o analogiczną wariantowość w punkcie 2.

Wnoskujemy o możliwość zaoferowania rozwiązania wyposażonego w statyw do zdjęć odległościowych z



motoryzacją ruchu góra – dół oraz zmotoryzowanym ruchem pochylenia. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 21

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, BEZPRZEWODOWE DETEKTORY CYFROWE, pkt. 4

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że parametr wartości rozdzielczości detektora ma decydujące znaczenie dla wydajności i dokładności obrazowania. Wartości parametrów DQE, MTF oraz rozdzielczości mają bezpośredni wpływ na jakość obrazowania niewielkich obiektów i struktur. Proponujemy zatem wprowadzenie punktacji dla tej wartości wymagań technicznych:

Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln)	$\geq 9,00$ Mp, podać	≥ 15 mln – 5 pkt Pozostałe – 0 pkt
---	-----------------------	--

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 22

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, BEZPRZEWODOWE DETEKTORY CYFROWE, pkt. 5

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że rozmiar pojedynczego piksela detektora ma decydujące znaczenie dla wydajności i dokładności obrazowania. Wartości parametrów DQE, MTF oraz rozmiaru pojedynczego piksela mają bezpośredni wpływ na jakość obrazowania niewielkich obiektów i struktur. Proponujemy zatem wprowadzenie punktacji dla tej wartości wymagań technicznych:

Rozmiary piksela	≤ 140 μm , podać	≤ 100 μm - 5 pkt Pozostałe – 0 pkt
------------------	----------------------------------	---

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 23

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, BEZPRZEWODOWE DETEKTORY CYFROWE, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający detektor cyfrowy o ilości ekspozycji na naładowanym akumulatorze poza Bucky ≥ 210 ? Detektory są ładowane zarówno w stole jak i w statywie i niebezpieczeństwo wyładowania akumulatora podczas badań z wolnej kasety praktycznie nie występuje.

Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie, czy wymaganie dotyczy wszystkich detektorów (również detektora 25x30 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wymaganie dotyczy tylko detektorów 43x43.

PYTANIE nr 24

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, BEZPRZEWODOWE DETEKTORY CYFROWE, pkt. 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego detektor o ochronie przed zalaniem min. IPX4. Wartość ta zabezpiecza detektor przed uszkodzeniem związanym z rozbryzaniem cieczy co wystarcza podczas zastosowań klinicznych i dezynfekcji.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE nr 25

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, BEZPRZEWODOWE DETEKTORY CYFROWE, pkt. 24

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego detektor o ochronie przed zalaniem min. IPX4. Wartość ta zabezpiecza detektor przed uszkodzeniem związanym z rozbryzaniem cieczy co wystarcza podczas zastosowań klinicznych i dezynfekcji.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 26

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, KONSOLA TECHNIKA, pkt. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego oprogramowanie konsoli operatora w języku angielskim, menu wyposażone w czytelne, graficzne piktogramy sterujące poszczególnymi funkcjami, dostępną z poziomu konsoli aparatu instrukcję obsługi w języku polskim oraz nazwy programów anatomicznych w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 27

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”, KONSOLA TECHNIKA, pkt. 19

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione i dopuści do postępowania aparat posiadający dedykowane, pediatryczne programy anatomiczne oraz pięć dedykowanych możliwości wyboru wielkości pacjentów pediatrycznych jako standardowe wyposażenie aparatu i funkcjonalność oprogramowania postprocessingowego, nieposiadającego oddzielnej nazwy handlowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 28

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ Punkt H.24 - Prosimy o podanie nazwy dostawcy systemu RIS/PACS.

Odpowiedź: Dostawcą obecnie użytkowanego systemu PACS jest firma IMS Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

PYTANIE nr 29

Dotyczy „Załącznik numer 4 do SWZ Punkt I.3

- a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- b) W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający posiada łącze internetowe o przepustowości min. 2Mbps (upload/download) ze stałym publicznym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec i może zestawzić połączenie w celu uruchomienia zdalnej diagnostyki.

PYTANIE nr 30

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §2 ust. 7 pkt 2), pkt 16), 17) - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wykreśli z §2 ust. 7 pkt 2), pkt 16), 17) wzoru umowy słowo „Dyrektyw”? Dyrektywy skierowane są do zasady do państw członkowskich UE, które



są zobowiązane do ich implementacji (wdrożenia) do prawa krajowego w określonym terminie, a nie podmiotów prywatnych. Podane wyszczególnienie nakłada zatem na Wykonawcę obowiązek niewynikający z zasad stosowania prawa UE.

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 2 z dn. 19.07.2022 r. Załącznika nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.*

PYTANIE nr 31

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §2 ust. 7 pkt 3) - Prosimy o wyjaśnienie, w jakim terminie Zamawiający dokona wyrażenia i przedstawienia (doręczenia) Wykonawcy zgody, o której mowa w §2 ust. 7 pkt 3) wzoru umowy?

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 2 z dn. 19.07.2022 r. Załącznika nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.*

PYTANIE nr 32

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §2 ust. 7 pkt 13) - W związku z tym, że instalacja sprzętu będzie odbywała się w istniejącym budynku, a Wykonawca nie odpowiada za jego stan techniczny i rzetelność dokumentacji inwentaryzacyjnej posiadanej przez Zamawiającego, prosimy o zmianę §2 ust. 7 pkt 13) wzoru umowy stosownie do okoliczności - poprzez wskazanie, iż zapewnienie, o którym mowa w tym postanowieniu nie dotyczy sytuacji niezależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.*

PYTANIE nr 33

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §2 ust. 13 - W §2 ust. 13 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł, iż:

„Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.”

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób i w jakim zakresie w związku z powyższym zapisem Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zabezpieczenia Wykonawcy jego mienia w budynku Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia montażu urządzenia?

Odpowiedź: *Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie zamknięte na klucz.*

PYTANIE nr 34

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §4 ust. 16 pkt 7) - W §4 ust. 16 pkt 7) wzoru umowy Zamawiający zastrzegł obowiązek dostarczenia kart gwarancyjnych. W związku z tym, że w przypadku umów z zamawiającymi każdorazowe warunki gwarancji wynikają z wzoru umowy oraz indywidualnych oczekiwań zamawiającego - czy Zamawiający zgodzi się wykreślić wskazany zapis?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.*

PYTANIE nr 35

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §4 ust. 19 - Czy Zamawiający zgodzi się uzupełnić §4 ust. 19 wzoru umowy o wskazanie, iż termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń powinien być uzasadniony okolicznościami i możliwościami technologicznymi lub technicznymi?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.*

PYTANIE nr 36

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §5 ust. 7 Prosimy o zmianę o zmianę treści ust. 7 i nadanie mu brzmienia:

„Każda naprawa gwarancyjna przedmiotu umowy przedłuża okres gwarancji o czas naprawy usterki



uniemożliwiającej wykonywanie badań”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 37

Dotyczy wzoru umowy:

5 ust. 9 oraz załącznik nr 4 do SWZ, punkt I.5 oraz I.6 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 5 dni. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 3 dni roboczych w przypadku awarii niewymagającej użycia części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 2 z dn. 19.07.2022 r. Załącznika nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy oraz Modyfikacji nr 1 z dn. 19.07.2022 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 38

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §5 ust. 16 Przedmiotem oferty są wyroby medyczne, za poprawne działanie których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za produkt zarówno wobec użytkownika, jak i pacjentów. W wyniku nieprawidłowej obsługi urządzenia może dojść do poważnych obrażeń, dlatego na urządzeniach obowiązują pewne ograniczenia w dostępie do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych. Niewłaściwa obsługa, taka jak naprawa lub ingerencja w konfigurację urządzenia, również może mieć negatywny wpływ na jakość diagnostyczną. Z tego powodu producent wprowadził odpowiednie instrukcje serwisowe i kody serwisowe, które są udostępniane przez producenta w odrębnej procedurze i umożliwiają korzystanie z oprogramowania serwisowego. Prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego możliwe jest w drodze udostępnienia kodów serwisowych, które producent udostępnia użytkownikom i niezależnym dostawcą usług serwisowych (tj. innym niż autoryzowany dostawca usług) w formie licencji na niedyskryminacyjnych zasadach i które umożliwiają pełną obsługę techniczną urządzenia i przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności. Są dostępne za opłatą licencyjną. Jeżeli Zamawiający chce uwzględnienia takich licencji na kody serwisowych w niniejszym postępowaniu, może to znacząco wpłynąć na cenę sprzętu, niepotrzebnie zwiększając ją dla Zamawiającego.

Zwracamy również uwagę, że z naszego doświadczenia wynika, że posiadanie licencji na klucze z góry nie gwarantuje, że koszt usługi serwisowej będzie niższy w przyszłości. Dodatkowo, zwracamy uwagę, że w takim przypadku Zamawiający niepotrzebnie ponosi koszty z góry. Koszt kodu usługi powinien w przyszłości ponosić usługodawcy (jako koszt ich koszty operacyjne), a nawet, jeśli tacy usługodawcy zdecydują się przenieść koszty kodów usług na Zamawiającego w ramach ich opłaty za usługę, koszt ten będzie nadal rozłożony w czasie, co daje Zamawiającemu lepszą kontrolę kosztów i umożliwia rozłożenie ich w czasie. Zwracamy również uwagę, że sprzęty tego rodzaju posiadają blokady uniemożliwiające dostęp do know-how producenta, a jednocześnie nie są wymagane do prowadzenia serwisu pogwarancyjnego.

W związku z tym proponujemy modyfikację postanowień wzoru umowy i usunięcie par. 5 ust. 18 lub alternatywnie zobowiązanie Wykonawcy do udostępnienia takich kodów serwisowych, które potrzebne są do świadczenia serwisu sprzętu, na żądanie Zamawiającego (po cenie cennikowej z uwzględnieniem 10% rabatu).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 39

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §5 ust. 17 Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do § 5 ust. 17 i wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia



gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 40

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §6 ust. 1 ppkt b), e), h) - W naszej opinii zaproponowana w ppktach b), e), h) kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 41

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §6 ust. 5 Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej maksymalnie do wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 42

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §7 ust. 1 - Jak Zamawiający rozumie sformułowanie użyte w §7 ust. 1 wzoru umowy „właściwy organ”? Co do zasady ekspertyzy prywatne jak i sądowe wykonują prywatne firmy lub specjaliści, nie zaś organy.

Odpowiedź: Zamawiający przez właściwy organ rozumie podmiot posiadający kwalifikacje do sporządzenia ekspertyzy odnośnie cyfrowego aparatu RTG.

PYTANIE nr 43

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §7 ust. 2 - Prosimy o uzupełnienie §7 ust. 2 wzoru umowy o wskazanie, iż koszty związane z przeprowadzeniem opinii/ekspertyzy Wykonawca poniesie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. W związku z tym, że wzór umowy nie zakłada uczestniczenia Wykonawcy w wyborze podmiotu sporządzającego opinię – w celu ewentualnego zwrotu kosztów tej opinii przez Wykonawcę wnioski opinii zleconej przez Zamawiającego powinny zostać potwierdzone przez rozstrzygnięcie niezależnego sądu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku braku poniesienia kosztów związanych z przeprowadzeniem opinii lub ekspertyzy przez Wykonawcę kwestię tą rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

PYTANIE nr 44

Dotyczy wzoru umowy:



Dot. §8 ust. 2 pkt 2) - W §8 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy Zamawiający zastrzegł prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy jest złej jakości, a Wykonawca nie uznaje reklamacji. Czy Zamawiający wykreśli ww. zapis?

Jak wnioskuje Wykonawca celem Zamawiającego jest zapewnienie realizacji roszczeń gwarancyjnych przez Wykonawcę, czemu służą w ocenie Wykonawcy inne postanowienia umowne jak np. kara umowna. Ponadto z samego faktu nieuznania reklamacji nie powinno być wywodzone prawo do rozwiązania umowy - Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania się do roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego i oceny ich zasadności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 45

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §9 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1) - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §9 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1) wzoru umowy słowa „opóźnienie” na „zwłoka”. Zgodnie z zasadami ogólnymi wynikającymi z kodeksu cywilnego Wykonawca powinien odpowiadać za kwalifikowaną postać nieterminowej realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 2 z dn. 19.07.2022 r. Załącznika nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

PYTANIE nr 46

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §9 ust. 3 pkt 3) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w §9 ust. 3 pkt 3) wzoru umowy o treści: „3) innego rodzaju nienależytego, zawinionego przez Wykonawcę, wykonania umowy”? W ocenie Wykonawcy zapis jest zbyt ogólny. Uprawnienie do odstąpienia powinno opierać się na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu skonkretyzowanego obowiązku umownego, chociażby przez wzgląd na konsekwencje, jakie ze sobą niesie oświadczenie wierzyciela, o którym mowa w tym zapisie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednakże dokonuje Modyfikacji nr 2 z dn. 19.07.2022 r. Załącznika nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

PYTANIE nr 47

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §11 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §11 ust. 1 wzoru umowy formy ustalenia godzin realizacji prac przez personel Wykonawcy z pisemnej na mailową? Zamawiający oczekuje elastyczności ze strony Wykonawcy w zakresie godzin realizacji prac adaptacyjnych, w tym pracy po godzinie 15.00 oraz w dni wolne, w związku z czym możliwość czynienia w ww. zakresie bieżących ustaleń w formie mailowej znacznie ułatwi realizację zadania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 2 z dn. 19.07.2022 r. Załącznika nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

PYTANIE nr 48

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Stronę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 49

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed demontażem istniejącego systemu RTG we własnym zakresie dokona trwałego usunięcia danych pacjentów z aparatu oraz wykona dekontaminację sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



PYTANIE nr 50**Dotyczy prac adaptacyjnych:**

Prosimy o określenie miejsca pozostawienia zdemontowanego urządzenia z określeniem długości drogi transportu (poziom + pion). Czy jest konieczność użycia windy? Czy należy urządzenie pozostawić w innym budynku?

Odpowiedź: *Korytarz w bloku 1E/II (budynek Szpitala) znajduje się na tym samym poziomie, co pomieszczenia RTG. Długość drogi transportu ok. 100m. Nie ma konieczności używania windy.*

PYTANIE nr 51**Dotyczy prac adaptacyjnych:**

Czy niezbędne będzie poniesienie opłat związanych z realizacją dostawy i instalacji urządzenia, między innymi dotyczącymi parkowania pojazdów, zużycia energii elektrycznej, wody, ochrony w przypadku wejścia na teren obiektu którym dysponuje inny użytkownik, itp.? Jeżeli tak. Prosimy o podanie wysokości tych opłat.

Odpowiedź: *Opłaty mogą dotyczyć zużytych mediów: energii elektrycznej i wody w formie ryczałtu. Woda 100,00 zł netto/ m-c, energia elektryczna 250,00 zł netto /m-c.*

PYTANIE nr 52**Dotyczy prac adaptacyjnych:**

Prosimy o podanie parametrów pomieszczeń (pomieszczenia badań, sterowni): wymiarów, wysokości pomieszczeń: podłoga- strop, podłoga-belka (podciąg)/ inne elementy konstrukcyjne, podłoga- sufit podwieszany. Prosimy o udostępnienie rysunków.

Odpowiedź: *Pomieszczenie RTG (sufit podwieszany): podłoga- strop – 2,86 m; podłoga-belka (podciąg) – 2,56 m. Pomieszczenie sterowni: podłoga- strop – 2,94 m. Zamawiający publikuje rysunki wraz z Odpowiedzią na Zapytanie nr 4 w dn. 19.07.2022 r.*

PYTANIE nr 53**Dotyczy prac adaptacyjnych:**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej pracowni branży konstrukcyjnej w zakresie warstw podposadzkowych, konstrukcji stropu nad pomieszczeniem, klimatyzacji, branży elektrycznej – zasilanie i uziemienie dla systemu RTG (trasa przewodu zasilającego umożliwiająca ocenę jego długości), rodzaj i wielkość zabezpieczenia w rozdzielniczy głównej.

Odpowiedź: *Zamawiający wraz z Odpowiedzią na zapytanie 4 w dn. 19.07.2022 r. publikuje wnioskowane dokumenty z wyjątkiem dokumentacji dot. klimatyzacji i branży elektrycznej, natomiast podaje następujące informacje: Kabel zasilający z rozdzielniczy niskiego napięcia Rnn-2, YKY-zo 5x120 SM mm² 0,6/1kV długość ok 40-45 m. Zabezpieczenie: WT 00/gG 125A, klimatyzacji brak.*

PYTANIE nr 54**Dotyczy prac adaptacyjnych:**

Prosimy o potwierdzenie, że w istniejąca posadzka w pomieszczeniu badań nie zawiera w swoim przekroju materiałów ściśliwych.

Odpowiedź: *Istniejąca posadzka w pomieszczeniu badań nie zawiera materiałów ściśliwych.*

PYTANIE nr 55**Dotyczy prac adaptacyjnych:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych prac remontowych np. malowania, wymiany okładzin, wymiany białego montażu, lamp oświetleniowych, wyłączników, istniejącej



infrastruktury, zabudów meblowych, stolarki drzwiowej i okiennej, itd. Jeżeli jednak tak, prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie wraz z określeniem obszaru ich wykonywania.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że jeżeli w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac adaptacyjnych zostanie uszkodzona powierzchnia czy jakiś element, Wykonawca powinien doprowadzić do stanu nie gorszego jaki był przed rozpoczęciem przez niego prac.*

PYTANIE nr 56

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wprowadzenia zmian aranżacyjnych, architektonicznych w pracowni RTG.

Odpowiedź: *Zamawiający nie będzie wymagał wprowadzenia zmian aranżacyjnych i architektonicznych w pracowni RTG, jeśli nie będą one konieczne do montażu, instalacji i prawidłowego uruchomienia nowego aparatu RTG.*

PYTANIE nr 57

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację, czy należy przewidzieć zmianę układu elementów systemu RTG czy zrealizować montaż aparatu analogicznie do układu istniejącego. Prosimy o wskazanie Państwa preferencji.

Odpowiedź: *Należy przewidzieć zmianę układu elementów systemu RTG.*

PYTANIE nr 58

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona we własnym zakresie badania skuteczności osłon w pomieszczeniu RTG przez akredytowaną jednostkę badawczą.

Odpowiedź: *Zamawiający nie potwierdza. Badanie skuteczności osłon w pomieszczeniu RTG przez akredytowaną jednostkę badawczą, jest po stronie Wykonawcy.*

PYTANIE nr 59

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wykona identyfikację wizualną (tabliczki informacyjne, naklejki, tablice ostrzegawcze itp.) dla pomieszczeń RTG oraz pomieszczeń technicznych, sterowni.

Odpowiedź: *Zamawiający we własnym zakresie wykona identyfikację wizualną dla pomieszczeń RTG oraz pomieszczeń technicznych i sterowni.*

PYTANIE nr 60

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji w sytuacji, gdy nie będzie w stanie przekazać Wykonawcy pomieszczeń do montażu urządzeń w wymaganym terminie lub infrastruktura (po stronie Zamawiającego) wymagana do uruchomienia urządzeń nie będzie umożliwiała zakończenia realizacji umowy.

Odpowiedź: *Zamawiający nie przewiduje opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy pomieszczeń do montażu urządzeń w wymaganym terminie.*

PYTANIE nr 61

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca instalacja wentylacji spełnia wymogi przepisów i jest sprawna.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że instalacja wentylacji spełnia wymogi przepisów i jest sprawna.

PYTANIE nr 62

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie żądał wymiany instalacji wentylacji ani jej usprawnienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie żąda wymiany instalacji wentylacji, ani jej usprawnienia.

PYTANIE nr 63

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga w ramach przetargu montażu klimatyzacji dla pomieszczeń pracowni RTG, ale zapewni odpowiednie warunki temperatury i wilgotności w pomieszczeniu dla nowego urządzenia.

Jeżeli jednak wymaga, prosimy o przekazanie informacji gdzie należy zainstalować jednostkę zewnętrzną tej instalacji (montaż na elewacji).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga montażu klimatyzatora w ilości 1 szt. w celu zapewnienia długotrwałej funkcjonalności i bezpieczeństwa pracy apartu RTG i jego integralnych elementów. Jednostka zewnętrzna tej instalacji winna być umieszczona na ścianie zewnętrznej (elewacja – od strony Patio).

PYTANIE nr 64

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu osłon stałych dla obecnej pracowni oraz wskazanie liczby ekspozycji przewidywanej dla pracowni z nowym aparatem RTG.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu publikuje projekt osłon stałych. Tygodniowa liczba ekspozycji – 300.

PYTANIE nr 65

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o przekazanie informacji dotyczących funkcji sąsiadujących pomieszczeń (nad, pod, obok) w stosunku do pomieszczenia RTG.

Odpowiedź: Pomieszczenie RTG sąsiaduje z:

– terenem zewnętrznym (za ścianą z oknami) – wolna, niezabudowana przestrzeń /trawnik/, w odległości ok. 15M dalsza zabudowa szpitala (chodnik)

– istniejącą pracownią TK,

- istniejącą pracownią Mammografii,


- pomieszczeniem operatorów (sterownia)

– korytarzem,

Pod pomieszczeniem RTG brak jest pomieszczeń (przyziemie).

Nad pomieszczeniem RTG są pomieszczenia szpitalne – gabinety Poradni Kardiologicznej oraz gabinety Przychodni Lekarzy Rodzinnych POZ.



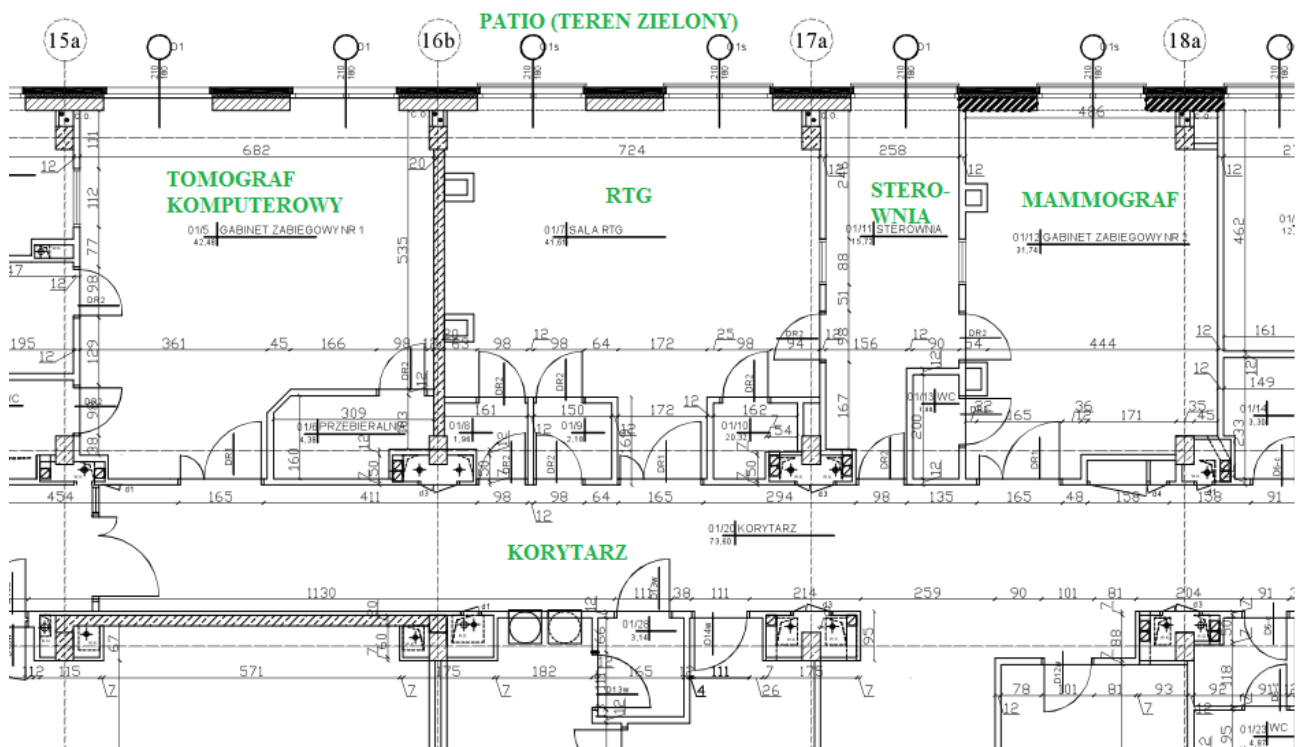

PYTANIE nr 66

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy wykonania nowej wykładziny w pracowni RTG a będzie wystarczające jej miejscowe uzupełnienie po wycięciu wykładziny do wymiany kabli systemowych i zaakceptuje miejscowo występującą zmianę kolorystyki wykładziny.

Odpowiedź: Wykonawca powinien doprowadzić do stanu nie gorszego niż jaki był przed rozpoczęciem przez niego prac. Jeśli dobór wstawianych odcinków wykładziny będzie harmonizował z pozostałością, wówczas dopuszczamy takie rozwiązanie, jeżeli nie to oczekujemy wykonania nowej wykładziny.

PYTANIE nr 67

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o wyspecyfikowanie mebli jakie należy dostarczyć w ramach umowy, jeżeli jest takie wymaganie Zamawiającego.

Odpowiedź: Biurko do konsoli technika – 1 szt., krzesło obrotowe -1 szt., taboret medyczny - 1 szt., szafka na osłony RTG -1 szt..

PYTANIE nr 68

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wystąpi do WSSE z prośbą o zatwierdzenie przygotowanego przez Wykonawcę projektu osłon stałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że we własnym zakresie wystąpi do WSSE z prośbą o zatwierdzenie przygotowanego przez Wykonawcę projektu osłon stałych. Powyższe leży po stronie Wykonawcy.

PYTANIE nr 69

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że do terminu realizacji umowy nie wlicza się czasu wymaganego do uzyskania zgód.



Odpowiedź: *Zamawiający nie potwierdza, że do terminu realizacji umowy nie wlicza się czasu wymaganego do uzyskania zgód.*

PYTANIE nr 70

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie wszelkich zgód administracyjnych, w szczególności na uruchomienie pracowni, zgodę na pracę z aparatem przez WSSE leży po stronie Zamawiającego (przy pełnym wsparciu Wykonawcy) i nie jest w zakresie Umowy (nie warunkuje podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego)? Pragniemy zaznaczyć, że Wykonawca nie jest stroną dla WSSE.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, że uzyskanie zgody administracyjnej tj. na uruchomienie pracowni - zgodę na pracę z aparatem wydaną przez WSSE leży po stronie Zamawiającego, po uprzednim kompletnym przygotowaniu niezbędnej dokumentacji przez Wykonawcę i przy jego pełnym wsparciu, ale Zamawiający nie potwierdza, że do czasu odbioru przez WSSE podpisze protokół zdawczo-odbiorczy. Szczegółowo powyższe zapisy określone są w Projektowanych postanowieniach umowy.*

PYTANIE nr 71

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach terminu realizacji umowy Zamawiający wymaga jedynie wstępnego szkolenia podstawowego z obsługi aparatu RTG bez udziału pacjentów. Szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w terminie późniejszym, po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na uruchomienie aparatu i pracowni.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

PYTANIE nr 72

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni RTG zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie aparat RTG, jakie jest obecnie zamontowane zabezpieczenie dla tej instalacji wraz z określeniem przekroju przewodu zasilającego i typu.

Odpowiedź: *Kabel zasilający z rozdzielnicy niskiego napięcia Rnn-2, YKY-zo 5x120 SM mm² 0,6/1kV długość ok 40-45 m. Zabezpieczenie: WT 00/gG 125A.*

PYTANIE nr 73

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja gazów medycznych nie wchodzi w zakres prac.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, że instalacja gazów medycznych nie wchodzi w zakres prac.*

PYTANIE nr 74

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. nie podlega modernizacji, wymianie i jest sprawna.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, że instalacja komputerowa, telefoniczna, ppoż itp. nie podlega modernizacji, wymianie i jest sprawna.*

PYTANIE nr 75

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wymiany ani przesunięcia umywalki umieszczonej w pracowni RTG bądź wykonania nowej.

Odpowiedź: *Jeżeli montaż nowego aparatu RTG nie będzie kolidował z umywalką, to Zamawiający nie wymaga jej wymiany, przesunięcia ani wymiany na nową.*



PYTANIE nr 76

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania/ wymiany przez Wykonawcę: oświetlenia awaryjnego, systemu SSP, instalacji teleinformatycznej, kontroli dostępu etc.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga wykonania /wymiany: oświetlenia awaryjnego, systemu SSP, instalacji teleinformatycznej, kontroli dostępu.

PYTANIE nr 77

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy w pomieszczeniach pracowni (zwłaszcza sterowni) są dostępne sprawne gniazda sieci LAN? Jeśli nie, czy Zamawiający posiada wolne miejsce, aby móc podłączyć nowe gniazda?

Odpowiedź: W pomieszczeniach sterowni są dostępne sprawne gniazda LAN - pracuje na nich obecny sprzęt radiografii pośredniej.

PYTANIE nr 78

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że w Zamawiający posiada dla nowego systemu RTG niezbędny zapas mocy elektrycznej około 125 kVA z określeniem miejsca włączenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że posiada zapas mocy ok. 125 kVA. Zamawiający uważa, że w związku z demontażem starego aparatu RTG, nie ma potrzeby zwiększenia mocy zamówionej.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

