

Warszawa, dnia 24 maja 2021 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa aparatu RTG typu ramię C” – sprawa nr
14/PN/2021/BK

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmian zapisów SWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 28 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni od dnia podpisania umowy z Modyfikacją treści SWZ z dnia 14 maja 2021 r.

Pytanie nr 2 - Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia pkt 58.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada do pracy przycisk nożny przewodowy z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające, natomiast bezprzewodowy włącznik nożny podnosi koszt aparatu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia o 7 dni czyli do 21 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni od dnia podpisania umowy z Modyfikacją treści SWZ z dnia 14 maja 2021 r.

Pytanie nr 4 - Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia pkt 39.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada DQE 72%? Oferowany parametr jest lepszy niż wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 - dotyczy SWZ, Rozdział VI pkt 6.1.1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 14 dni od daty złożenia zamówienia; wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatu rentgenodiagnostycznego, jakim jest aparat RTG z ramieniem C jest niewystarczający.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki. Również obecna sytuacja epidemiologiczną oraz rozprzestrzeniające się zagrożenie

związane z chorobą COVID-19, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców nie sprzyja tak krótkiemu terminowi realizacji umowy.

Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne, ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia.

Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu wirusa COVID-19 i związanych z obecną sytuacją działań służb sanitarnych wielu państw mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach.

Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Należy pamiętać również o czasie transportu, który w przypadku poczty kurierskiej z zagranicy w obecnej sytuacji trwa nawet 10 dni roboczych.

W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 42 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni od dnia podpisania umowy z Modyfikacją treści SWZ z dnia 14 maja 2021 r.

Pytanie nr 6 - Dotyczy Załącznika nr 2 – tabelka techniczna pkt 63

Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisu kontakt zdalny, telefoniczny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 - Dotyczy wzoru umowy w § 6 pkt 4 i 5 oraz Załącznika nr 2 – tabelka techniczna pkt 64

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów w w/w dokumentach zgodnie z umową, tj. *Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia: maksymalnie 21 dni roboczych.*

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje ujednoczania w § 6 pkt 4 i 5 oraz Załącznika nr 2 – tabelka techniczna pkt 64

Pytanie nr 8 - Dotyczy wzoru umowy w § 6 pkt 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploataowanie zastępczego aparatu.

Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploataowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy w przedmiotowym zakresie zgodnie z Modyfikacją treści SWZ z dnia 14 maja 2021 roku.

Pytanie nr 9 - Dotyczy wzoru umowy w § 6 pkt 9

Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na aparat rentgenowski. Tylko autoryzowany przez producenta, serwis Wykonawcy jest wyłącznie

upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urządzenia. W związku z tym prosimy o odstąpienie od w/w zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy w przedmiotowym zakresie zgodnie z Modyfikacją treści SWZ z dnia 14 maja 2021 roku.

Pytanie nr 10 - Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 1 lit a), b)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych w w/w punktach do 0,1% wartości umowy netto.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 11 - Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 2

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umownej netto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 12 - Dotyczy wzoru umowy w § 6 pkt 6 i Załącznika nr 2 – tabelka techniczna pkt 62

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów w w/w dokumentach, tj.

Jeżeli w wyniku 3 istotnych napraw tego samego podzespołu zgłoszonych w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego sprzętu na nowy wolny od wad w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy wykazuje wady.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 13 - Dotyczy wzoru umowy w § 6 pkt 7

Zwracamy uwagę, iż aktualny zapis jest nieuzasadniony ekonomicznie i naraża Wykonawcę na straty, ponieważ aparat jakim jest RTG z ramieniem C składa się z tak wielu części, że biorąc pod uwagę naprawę jakiegokolwiek elementu, którym może być choćby kabel czy myszka – wymiana całego aparatu z tego tytułu jest nieuzasadniona. Dlatego zwracamy się z prośbą o wykreślenie w/w punktu lub wprowadzenie modyfikacji, tj. *„Zgłoszone wady będą wadami jednego rodzaju, kolejno się powtarzającymi”.*

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 14


Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować punktację w pkt 4 mówiącym o mocy generatora? Pragniemy zauważyć, że aktualna punktacja stoi w sprzeczności z opisanym parametrem: z jednej strony Zamawiający ogranicza konkurencję i wymaga generatora max. 2,5kW, a z drugiej strony punktuje generator o największej mocy. Proponujemy:

	Moc generatora min. 2,02 kW	TAK, podać	Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 3 pkt. Reszta - proporcjonalnie
--	-----------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 15

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w parametrze 12 Zamawiający punktuje rozwiązanie gorsze technologiczne, powodujące artefakty na obrazie oraz generujące znacznie większą dawkę czy niepotrzebne ciepło. Taki sposób punktacji świadczy o skrajnej niewiedzy Zamawiającego na temat wykorzystywania aparatów RTG z ramieniem C. Pragniemy zauważyć, że technologia wysokopulsacyjna wyparła technologię skopi ciągłej oferując dawki mniejsze o nawet 80%, brak artefaktów ruchowych czy możliwość regulacji mAs i ograniczenie wydzielania się zbędnego ciepła. Wyjaśnienie znajduje się poniżej:

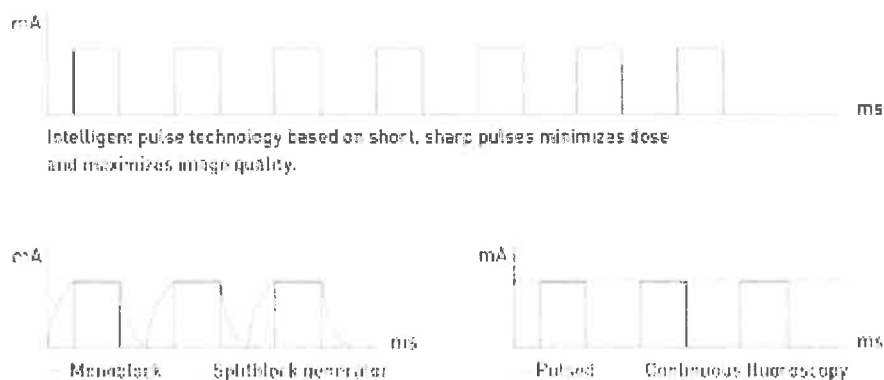

Pragniemy zaznaczyć, że taki sposób punktacji w sposób nieuczciwy i niekompetentny faworyzuje rozwiązania firmy GE, które poprzez starą technologię szkodzą personelowi i pacjentom, na co szpital państwowy nie może wyrażać zgody. Wnosimy o kategorię zmianę na zaproponowaną:

	Skopia wysokopulsacyjna lub Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 8 pulsów/s i skopia ciągła	TAK, podać	Skopia wysokopulsacyjna w zakresie min. 1-25p/s oferująca mniejszą dawkę, mniejsze artefakty ruchowe względem skopi ciągłej – 5 pkt. Skopia pulsacyjna – 1 do 8 pulsów/s oraz skopia ciągła – 0 pkt.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający dysponuje wiedzą iż opisana w SWZ technologia jest powszechnie stosowana w diagnostyce obrazowej przez co najmniej kilku oferentów tj. Siemens, Philips.

Pytanie nr 16

Prosimy o zmianę punktacji w pkt 14, ponieważ aktualny zapis premiuje nieuczciwie rozwiązanie firmy GE w modelu OEC ONE FD oraz co ważniejsze premiuje rozwiązanie gorsze technologicznie. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia powinien wiedzieć, że nie ilość ognisk, a ich rozmiar definiuje jakość obrazu. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający stosując taką punktację i jednoznacznie opisując aparat GE OEC ONE FD oczekuje rozwiązania z dużym ogniskiem dla radiografii większym niż małe ognisko we fluoroskopii, a zgodnie z regułami



panującymi w radiologii, większe ognisko oznacza mniejszą kontrastowość obrazu, tym samym Zamawiający oczekuje i punktuje rozwiązanie dające gorsze obraz. Wnosimy o kategorię zmianę zapisu na taką, która wymusi na wykonawcach zaoferowanie aparatu zapewniającego lepszą jakość obrazu:

Lampa ze stacjonarną anodą – jedno lub dwuogniskowa	TAK	Ognisko dla radiografii i fluoroskopii mniejsze bądź równe 0,6mm – 3 pkt Ognisko dla radiografii lub fluoroskopii większe niż 0,6 mm – 0 pkt
-----------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający posiada informację iż co najmniej 2 oferentów oferuje powyższe rozwiązania z lampą ze stacjonarną anodą jedno lub dwuogniskową w tym min. Ziehm, Philips, Siemens.

Pytanie nr 17

Wnosimy o zmianę punktacji w parametrze 15 na bardziej uczciwą stosując stopniowanie punktacji. Proponujemy:

Totalna filtracja min. 4,0 mm Al	TAK, podać	Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 3 pkt. Reszta - proporcjonalnie
----------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 18

Prosimy o wniesienie punktacji w bardzo ważnym parametrze jakim jest pojemność cieplna kołpaka i anody oraz prędkość chłodzenia. Aktualnie wprowadzona punktacja wygląda na rażąco tendencyjną na korzyść aparatu GE OEC ONE FD z pominięciem bardzo ważnych od strony użytkowej parametrów mających wpływ na możliwość wykonywania długich ekspozycji. Oferowany przez nas aparat znacznie przekracza wymagane parametry i tym samym przewyższa preferowany aparat GE. Proponujemy:

Pojemność cieplna anody min. 50 kWh	TAK, podać	Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 3 pkt. Reszta - proporcjonalnie
Pojemność cieplna kołpaka min. 900 kWh	TAK, podać	Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 3 pkt. Reszta - proporcjonalnie
Szybkość chłodzenia anody min. 37 kWh/min	TAK, podać	Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 3 pkt. Reszta - proporcjonalnie

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 19

Prosimy o dopuszczenie aparatu o masie około 347 kg. Jest to niewielka różnica względem wymaganych 320 kg wynikająca z solidnej, metalowej konstrukcji obudowy aparatu. Różnica nie ma wpływu na mobilność, czy wygodę użytkownika aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 20

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w kolejnych nieistotnych parametrach Zamawiający tendencyjnie i nieuczciwie punktuje rozwiązania jednego producenta, które nie mają żadnego wpływu na wygodę pracy, czy jakość obrazu. Jeżeli Zamawiający zgodził się punktować takie parametry jak zakres ruchu pionowego, gdzie różnica pomiędzy aparatami wynosi około 2cm, prosimy o wniesienie punktacji za parametr 25, czyli wolną przestrzeń, która ma bezpośredni wpływ na wygodę korzystania oferując większą ilość wolnej przestrzeni między generatorem, a detektorem. Proponujemy:

	Wolna przestrzeń: min. 75 cm	TAK, podać	Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 4 pkt. Reszta - proporcjonalnie
--	------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 21

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w kolejnych nieistotnych parametrach Zamawiający tendencyjnie i nieuczciwie punktuje rozwiązania jednego producenta, które nie mają żadnego wpływu na wygodę pracy, czy jakość obrazu. Jeżeli Zamawiający zgodził się punktować takie parametry jak zakres ruchu Wig-Wag, gdzie różnica pomiędzy aparatami wynosi około 2 stopnie, prosimy o wniesienie punktacji za parametr 29, czyli zakres ruchu wokół osi poziomej oraz ruchu orbitalnego. Proponujemy:

	Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej $\geq \pm 205^\circ$	TAK, podać	Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 4 pkt. Reszta - proporcjonalnie
	Zakres ruchu orbitalnego $\geq 150^\circ$	TAK PODAĆ	Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 4 pkt. Reszta - proporcjonalnie

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 22

Prosimy o dopuszczenie aparatu z zakresem ruchu pionowego 42cm. Różnica 42 cm jest zupełnie niezauważalna z perspektywy użytkownika i nie wpływa na komfort korzystania z aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie, gdyż nie zauważa w tym parametrze aż 42 cm różnicy jak wykonawca wskazuje w zapytaniu.



Pytanie nr 23

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową punktację w parametrze 9 mówiącym o zakresie wysokich napięć. Chcemy zaoferować jedyny dostępny na rynku aparat ze stacjonarną anodą z zakresem napięć 40-120kV. Pragniemy zauważyć, że zgodnie z zasadą ALARA personel korzystający z RTG z ramieniem C powinien korzystać z możliwie wysokich napięć, ponieważ gwarantuje to większą przezierność wiązki i tym samym mniejszą dawkę pochłoniętą przez pacjenta. Proponujemy:

Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV	TAK, podać	Wysokie napięcie min. 120 kV – 5 pkt Wysokie napięcie 110kV – 0 pkt Reszta - proporcjonalnie
----------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 24

Prosimy o wniesienie punktacji za najbardziej istotny parametr mający największy wpływ na jakość powstałego obrazu czyli rozdzielczość detektora. Brak punktacji w tym parametrze oraz punktowanie parametrów nie mających absolutnie żadnego wpływu na jakość otrzymywanych obrazów czy wygodę użytkownika narusza podstawowe zasady uczciwej konkurencji, tym samym jest nie zgodna z ustawą PZP. Brak punktacji za najważniejszy parametr oznacza zgodę Zamawiającego na zaoferowanie aparatu gorszej jakości, a postępowanie tym samym powinno być prowadzone w trybie ograniczonym, ponieważ stosowana punktacja i arytmetyka przetargowa niejako skazuje aparat GE OEC ONE FD na wygraną. Wnosimy o dodanie punktacji:

Rozdzielczość detektora CMOS min. 1400 x 1400	TAK, podać	Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Reszta - proporcjonalnie
-----------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 25

Wnosimy o modyfikację w parametrze

Możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie min. 35 cm bez ruchu pionowego kolumny	TAK	
------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

Takie rozwiązanie z monitorem na ramieniu C z niezależną regulacją jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla aparatów marki GE, co stoi w sprzeczności z ustawą PZP poprzez nieuczciwą konkurencję. Zaoferowany aparat posiada monitor na przegubowym uchwycie na ramieniu C, lecz regulacja wysokości odbywa się poprzez zmianę wysokości ramienia C. proponujemy:

Możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie min. 35 cm	TAK	
--------------------------------------------------------------	-----	--

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 26

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego pamięć wewnętrzna wynosi 100. 000 zdjęć, co jest wartością zupełnie wystarczającą, chociażby ze względu na fakt, że zgodnie z RODO najbezpieczniejszym, trwałym sposobem przechowywania informacji obrazowych jest serwer PACS Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 27

Wnosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla aparatu, który będzie posiadał funkcję automatycznego dopasowania częstotliwości skopii w zależności od ruchu w polu detektora. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić dawkę promieniowania w tle, bez ingerencji personelu oraz bez zauważalnych strat jakości.

Proponujemy:

59.	Zaawansowany system dopasowujący częstotliwość skopii automatycznie, oprócz ustawień ręcznych w zależności od prędkości obiektu w polu obrazowym detektora.	TAK/Nie		Tak – 5 pkt Nie – 0pkt
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--	---------------------------

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia **termin składania ofert** z dnia 27 maja 2021 roku godz. 10:00 na dzień **28 maja 2021** roku na godz. 11:00. **Otwarcie ofert** nastąpi w dniu **28 maja 2021** roku o godz. **11:30**.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

PEŁNOMOCCNIK DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNYCH
Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
mgr Damian Wrona

Sporządziła: Bogumiła Kalinowska

SPECJALISTA W ZAKRESIE PUBLICZNYCH
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie
Bogumiła Kalinowska
Bogumiła Kalinowska

ZAŁĄCZNIK NR 2

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Punktacja
WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2021 Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe.	TAK PODAĆ		
2.	Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz.	TAK		
3.	Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10%.	TAK		
4.	Moc generatora min. 2,02 kW max. 2,5 kW.	TAK PODAĆ		Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 3 pkt
5.	Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz.	TAK PODAĆ		
6.	Prąd dla trybów fluoroskopii ≥12mA Automatyka parametrów fluoroskopii.	TAK PODAĆ		
7.	Radiografia cyfrowa.	TAK		
8.	Prąd radiografii cyfrowej min. 20 mA.	TAK PODAĆ		
9.	Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 60%.	TAK PODAĆ		
10.	Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV.	TAK PODAĆ		
11.	Automatyka doboru parametrów skopii.	TAK		

12.	Skopia wysokopulsacyjna lub Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 8 pulsów/s i skopia ciągła	TAK PODAĆ		Skopia wysokopulsacyjna – 0 pkt. Skopia pulsacyjna – 1 do 8 pulsów/s oraz skopia ciągła – 3 pkt.
LAMPA X-RAY				
14.	Lampa ze stacjonarną anodą – jedno lub dwuogniskowa	TAK		Lampa jednoogniskowa – 0 pkt. Lampa dwuogniskowa – 3 pkt
15.	Totalna filtracja min. 4,0 mm Al	TAK PODAĆ		Wartość wymagana – 0 pkt Wartość największa – 3 pkt
16.	Wielkość mniejszego ogniska max. 0,6 mm.	TAK PODAĆ		
17.	Pojemność cieplna anody min. 50 kHU.	TAK PODAĆ		
18.	Pojemność cieplna kołpaka min. 900 kHU.	TAK PODAĆ		
19.	Szybkość chłodzenia anody min. 37 kHU/min.	TAK PODAĆ		
20.	Kolimator typu IRIS.	TAK		
21.	Kolimator szczelinowy z rotacją.	TAK		
22.	Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania.	TAK		
WÓZEK Z RAMIENIEM C				
23.	Waga wózka z ramieniem C max. 320kg.	TAK PODAĆ		
24.	Głębokość ramienia C min. 66 cm.	TAK PODAĆ		
25.	Wolna przestrzeń: min. 75 cm.	TAK PODAĆ		
26.	Odległość SID min. 100 cm.	TAK PODAĆ		
27.	Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm.	TAK PODAĆ		
28.	Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 44 cm.	TAK PODAĆ		Wartość wymagana – 0 pkt Wartość większa – 4 pkt
29.	Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20°.	TAK PODAĆ		Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość większa – 4 pkt

30.	Zmotoryzowany ruch pionowy.	TAK		
31.	Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej $\geq \pm 205^\circ$.	TAK PODAĆ		
32.	Zakres ruchu orbitalnego $\geq 150^\circ$	TAK PODAĆ		
33.	Ramię C zbalansowane w każdej pozycji.	TAK		
34.	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody.	TAK		
35.	Pojedyncza dźwignia do sterowania kołami aparatu, dodatkowo pozostałe hamulce aparatu oznaczone kolorami	TAK		
36.	Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 3 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny.	TAK PODAĆ		
37.	Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu.	TAK		
CYFROWY DETEKTOR OBRAZU				
38.	Średnica nominalna $> 20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$.	TAK PODAĆ		
39.	Ilość pól detektora obrazu min. 3. DQE 70%	TAK PODAĆ		
40.	Rozdzielczość detektora CMOS min. 1400 x 1400	TAK, PODAĆ		
MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU				
41.	Monitory umieszczone na wózku z ramieniem C.	TAK		
42.	Monitory 2x 19" o rozdzielczości $\geq 1280 \times 1024$ pikseli lub monitor 27" medyczny, dotykowy wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości $\geq 3840 \times 2160$ pikseli Kontrast $\geq 1000:1$ luminancja $\geq 600 \text{ cd/m}^2$.	TAK PODAĆ		Monitory 2x 19" o rozdzielczości $\geq 1280 \times 1024$ pikseli – 0 pkt. Monitor 27" medyczny, dotykowy wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości $\geq 3840 \times 2160$ pikseli – 5 pkt
43.	Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu, widoczny ze wszystkich czterech stron systemu	TAK		



44.	Możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie min. 35 cm bez ruchu pionowego kolumny	TAK		
45.	Kąt widzenia (obrazu min. 176°).	TAK PODAĆ		
46.	Wyjście do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji.	TAK		
47.	Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów.	TAK PODAĆ		
48.	Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 pikseli, 32 bit.	TAK PODAĆ		
49.	Pojemność pamięci na dysku twardym min. 150 000 obrazów.	TAK PODAĆ		
50.	Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Wyjście USB.	TAK		
51.	Archiwizacja obrazów w formacie TIFF lub Raw lub BMP.	TAK, PODAĆ		
52.	Funkcja „Last Image Hold” (LIH).	TAK		
53.	Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo / prawo na monitorze.	TAK		
54.	ZOOM min. x 4. Obraz lustrzany.	TAK PODAĆ		
55.	Oprogramowaie DICOM 3.0	TAK		
56.	Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwiania dodatkowych dawek promieniowania.	TAK		
57.	Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym.	TAK		
58.	Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 lub dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280x800 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live. System wyposażony w bezprzewodowy przycisk nożny do skopii i zapisu.	TAK, PODAĆ		Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 – 0 pkt Dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280x800 – 5 pkt
WYPOSAŻENIE DODATKOWE / WARUNKI SERWISU I GWARANCJI				



59.	Zapewnienie części zamiennych przez okres 10 lat.	TAK		
60.	2 komplety ochrony radiologicznej (fartuch i tarczyca) o ekwiwalencji 0,25 mmPb.	TAK		
61.	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.	TAK		
62.	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy - 3 naprawy.	TAK		
63.	Czas reakcji: zgłoszenie - naprawa 48 godz. (dni robocze).	TAK		
64.	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia: maksymalnie 21 dni	TAK		
65.	Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu.	TAK		
66.	Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji.	TAK		
67.	Oferent musi zapewnić serwis pogwarancyjny na terenie Polski.	TAK		
68.	Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski.	TAK		
69.	Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych aparatu.	TAK		
70.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK		
71.	Gwarancja minimum 24 miesiące.	TAK PODAĆ		
72.	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.	TAK PODAĆ		

ZAŁĄCZNIK NR 3
POSTANOWIENIA DLA STRON, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI UMOWY

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **14/PN/2021/BK**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia fabrycznie nowego, nie używanego aparatu RTG typu ramię C dla Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zgodnego z załącznikiem nr 1 do umowy (Opisem oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia) oraz załącznikiem nr 2 do umowy (Opisem przedmiotu zamówienia - *stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ*) za cenę łączną:
netto:zł (słownie:.....)
VAT:.....zł (słownie:.....)
brutto:.....zł (słownie:)
2. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach ceny podanej w ust. 1, należy dostarczenie przedmiotu umowy pod wskazany przez Zamawiającego adres, rozładunek oraz zapewnienie serwisu w okresie gwarancyjnym.
3. Wartość ceny podana w ust. 1, obejmuje ubezpieczenie, transport zamawianego urządzenia, a także inne koszty, podatki i opłaty konieczne do prawidłowego zrealizowania umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia towaru oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas transportu przedmiotu umowy.
5. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach ceny podanej w ust. 1 należą także czynności nie wyszczególnione w niniejszym paragrafie, a wynikające z załącznika nr 2 do umowy.

§ 2

1. Miejsce odbioru: Narodowy Instytut Geriatrii i Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa, ul. (dokładny adres zostanie wskazany w umowie z Wykonawcą).

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie: **dni**, licząc od dnia podpisania umowy (*dzień zawarcia umowy nie jest wliczany do terminu realizacji*).
2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do korzystania z przedmiotu umowy, w szczególności dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi, użytkowania, konserwacji - w języku polskim lub innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Realizacja umowy zostanie potwierdzona protokołem odbioru, podpisanym bez zastrzeżeń przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Zamawiający (osoba wyznaczona do odbioru) przy odbiorze przedmiotu umowy zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności dostarczonego urządzenia z oferowanym w ofercie Wykonawcy.

§ 4

1. Podstawę wystawienia faktury stanowił będzie protokół, o którym mowa w **§ 3 ust.3**.
2. Zamawiający na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i na wskazane w niej konto dokona przelewem zapłaty za zrealizowany przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Wykonawca w wystawionej fakturze zobowiązany jest wskazać kwoty jednostkowe za poszczególne asortymenty.
5. Wszelkie należności wynikające z faktur wystawionych za realizację przedmiotu Umowy zostaną zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 5

1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury prawidłowo wystawionej po wykonaniu całości przedmiotu umowy.
2. Dostarczony w ramach niniejszej umowy asortyment musi odpowiadać parametrom jakościowym oraz wydajnościowym opisanym w załączniku nr 2 do SWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym jednocześnie **załącznik nr 2 do umowy** oraz być zgodny z urządzeniem wskazanym w złożonej ofercie Wykonawcy – tj. opisem oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia - **stanowiącym załącznik nr 1 do umowy**.
3. Wykonawca zapewnia, że dostarczone urządzenie jest wolne od wad.

§ 6

1. Wykonawca udziela **gwarancji jakości** na przedmiot umowy na **okres ... miesięcy**, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłową realizację przedmiotu umowy.
2. Wszelkie koszty dotyczące gwarancji ponosi Wykonawca, w tym koszty transportu urządzenia i koszty jego naprawy.



3. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
4. Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia: maksymalnie 5 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia: maksymalnie 21 dni roboczych. ~~Jeżeli naprawa przekroczy określony czas skutecznej naprawy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. Obowiązek dostawy Sprzętu zastępczego powstaje w 22 dniu licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia. Koszty transportu wadliwego przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę – w tym wypadku, okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.~~
6. Jeżeli w wyniku 3 napraw zgłoszonych w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego sprzętu na nowy wolny od wad w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy wykazuje wady. Zawiadomienie winno być wysłane listem poleconym.
7. Zgłoszone wady nie muszą być wadami jednego rodzaju, kolejno się powtarzającymi, lecz jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy
8. Za zagubienie/uszkodzenie sprzętu wysłanego do/z serwisu odpowiada Wykonawca i on ponosi wszelkie koszty.
9. ~~W przypadku gdy Wykonawca nie zastosuje się do powyższych punktów Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad samodzielnie lub w drodze zlecenia naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy oraz innych przepisów w szczególności związanych z uprawnieniami z tytułu gwarancji i rękojmi.~~

§ 7

1. Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne:
 - a. za każdy dzień zwłoki w terminowym wykonaniu całości przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,2 %** ceny umownej netto,
 - b. za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi liczonego od dnia następnego po upływie terminu do usunięcia wady Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,2 %** wartości netto umowy,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej netto za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem.
3. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. **Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony Umowy wynosi 25% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 1 ust.1 Umowy;**



5. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.
6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z min. 2 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy asortymentu stanowiącego przedmiot umowy (dni robocze). Powyższą informację należy przekazać osobie odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego wskazanej w ust.2.
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest:

..... tel.

3. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest:

..... tel.

§9

1. Termin „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie, jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne.
2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej.
3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o zaistnieniu Siły Wyższej i jej przyczynach.
4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty zaistnienia Siły Wyższej przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej.
5. Jeżeli po zawiadomieniu Strony w formie pisemnej nie uzgodnią inaczej, każda ze Stron będzie kontynuowała prace w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.
6. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań.

§10.

ZASTOSOWANIE RODO DO POSTĘPOWANIA

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:



- 1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest **Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1,**
 - 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl.
 - 3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 - 4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 – Prawo zamówień publicznych (Pzp),
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 - 7) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 - 8) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
- 1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 - 2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
 - a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - b) skorzystanie z prawa do sprostowania na podstawie art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
 - d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.

- 3) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe, stosownie do art. 22 RODO.
- 4) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- 5) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

§11.

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu Umowy.
4. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

