

Zamawiający: ŚREDZKIE CENTRUM ZDROWIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z siedzibą w 55-300 Środa Śląska ul. Kolejowa 16a

03.12.2021r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ –ZP.2.2021.TP.

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa urządzeń medycznych z listy pakietów wraz z dostawą i montażem, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej z siedzibą 55 -300 Środa Śląska ul. Kolejowa 16a, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1159), Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym (art.275 ust.2):

część I

Pakiet nr 1: Dermatoskop

Pyt.1) W tabeli z zestawieniem parametrów technicznych, pkt.6 Zamawiający wymaga „możliwości dokumentacji cyfrowej, poprzez specjalne soczewki integrujące aparat fotograficzny i układ optyczny”. Czy tak określony parametr oznacza jedynie wymóg aby oferowany instrument był przygotowany do takiej możliwości, czy też Zamawiający wymaga dostarczenia gotowego rozwiązania łącznie z przedmiotowym instrumentem?

Odp: Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt posiadał możliwość dokonywania dokumentacji cyfrowej poprzez specjalne soczewki integrujące aparat fotograficzny i układ optyczny.

Pyt.2) W tabeli z zestawieniem parametrów technicznych, pkt.9 Zamawiający wymaga „Zasilania bateryjnego 2,5V; akumulatorowego 3,3V.”. Czy Zamawiający wymaga obecności obydwu rodzajów zasilania w instrumencie, czy zaoferowania jednego z nich?

Odp: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego rodzaju zasilania z podanych w OPZ.

Pakiet nr 4: Zestaw rektoskopowy

Pyt.1) W tabeli z zestawieniem parametrów technicznych, pkt.2 oraz 7 Zamawiający wymaga, jako źródła światła obecności w zestawie projektora zimnego światła o mocy 150W wraz z przewodem światłowodowym zakończonym rękojeścią. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o zasilanie akumulatorowe z ładowarką, bateria w technologii Li-ION obecna w rękojeści z dedykowanym łącznikiem światłowodowym umożliwiającym połączenie ze światłowodową główką rektoskopową?

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu w OPZ.

Pyt.2) Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z zestawem tubusów 1x użytku? Do pełnej funkcjonalności wymagana jest ich obecność. Jako dystrybutor takich zestawów oferujemy je w trzech rozmiarach, 250x20mm, 130x20mm, 85x20mm, pakowane po 25szt. jednego rodzaju. Jeżeli Zamawiający wymaga, to których i w jakiej ilości?

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu w OPZ.

Część II

Dotyczy: pakiet nr 9 – Wózki medyczne

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

Dotyczy: pakiet nr 9 – Wózki medyczne

Wózek opatrunkowy – 3 szt.

2. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego stalową, lakierowaną proszkowo ramę wózka?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

3. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego cztery koła o średnicy 150 mm? Jednocześnie prosimy i przyznanie 10 pkt. za ww. rozwiązanie.

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu jak w OPZ.

4. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego układ jezdny składający się z czterech kół w przeciwnopływowej obudowie (nie antystatycznych), dwa koła wyposażone w hamulec, bez koła z blokadą kierunku jazdy?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

5. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w trzy szuflady na prowadnicach teleskopowych, trzy szuflady o wys. 225 mm, szuflady wysuwają się w całości (100 %), zaopatrzone w system samo domykający się?

Odp: Zamawiający dopuszcza wyposażenie szuflad w prowadnice teleskopowe.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyposażenie wózka w trzy szuflady o jednakowej wys. 225 mm i pozostawia zapis jak w OPZ.

6. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w ergonomiczny uchwyt do przetaczania zainstalowany z prawej strony wózka?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

7. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w zamykany kosz na śmieci z pokrywą otwieraną kolaniem?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

8. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt na pudełko rękawiczek (jak na zdjęciu poniżej)?



Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu w OPZ.

9. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego standardowo w trzy uniwersalne, wielofunkcyjne, uchylne, tworzywowe kuwety montowane z boku wózka?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

10. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża nad blatem roboczym wózka?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

11. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego w 4 narożnikach nad kołami krążki odbojowe?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

12. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w szyny montażowe, ze względu na to, że w oferowanym wózku wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża nad blatem roboczym wózka i nie ma konieczności stosowania w tym celu szyn montażowych?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

13. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego ściany boczne, tył oraz szuflady w kolorze szarym oraz uchwyty szuflad w kolorze żółtym?

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu w OPZ.

14. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego uchwyty szuflad wykonane z tworzywa ABS w kolorze żółtym?

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu w OPZ.

15. Prosimy (w pkt. 26) o wyrażenie zgody na załączenie Deklaracji Zgodności CE oraz powiadomienia do rejestru wyrobów medycznych.

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu w OPZ.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Dotyczy: pakiet nr 9 – Wózki medyczne

Wózek reanimacyjny – 1 szt.

16. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego stalową, lakierowaną proszkowo ramę wózka?
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.
17. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego cztery koła o średnicy 150 mm? Jednocześnie prosimy o przyznanie 10 pkt. za ww. rozwiązanie.
Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu jak w OPZ.
18. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego układ jezdny składający się z czterech kół w przeciwnopływowej obudowie (nie antystatycznych), dwa koła wyposażone w hamulec, bez koła z blokadą kierunku jazdy?
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.
19. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pięć szuflad na prowadnicach teleskopowych, dolna szuflada o wym. 450 x 450 x 225 mm, dwie środkowe szuflady o wym. 450 x 450 x 150 mm, dwie górne szuflady o wym. 450 x 450 x 75 mm, szuflady wysuwają się w całości (100 %), zaopatrzone w system samo domykający się?
Odp: Zamawiający dopuszcza wyposażenie szuflad w prowadnice teleskopowe. Zamawiający nie wyraża zgody na wyposażenie wózka w szuflady o zaproponowanych wymiarach i pozostawia zapis jak w OPZ.
20. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego centralną blokadę wszystkich szuflad na kluczyk?
Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu jak w OPZ.
21. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w ergonomiczny uchwyt do przetaczania zainstalowany z prawej strony wózka?
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.
22. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w obrotową półkę na defibrylator z możliwością zablokowania w czterech pozycjach, półka o wymiarach 320 x 400 mm, bez regulacji szerokości i wysokości, posiadająca dwa regulowane pasy do mocowania urządzenia?
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.
23. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt na butlę tlenową z paskami umożliwiającymi zamocowanie butli o różnych rozmiarach?
Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu jak w OPZ.
24. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty z paskami umożliwiającymi zamocowanie pojemnika o różnych rozmiarach (jak na zdjęciu poniżej)?



chy

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu jak w OPZ.

25. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w płytę do przeprowadzania RKO montowaną na tylnej ścianie wózka o wym. 550 x 390 x 10 mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu jak w OPZ.

26. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża nad blatem roboczym wózka?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

27. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego w 4 narożnikach nad kołami krążki odbojowe?


Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

28. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego ściany boczne, tył oraz szuflady w kolorze szarym oraz uchwyty szuflad w kolorze czerwonym?

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu jak w OPZ.

29. Prosimy (w pkt. 24) o wyrażenie zgody na załączenie Deklaracji Zgodności CE oraz powiadomienia do rejestru wyrobów medycznych.

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu jak w OPZ.

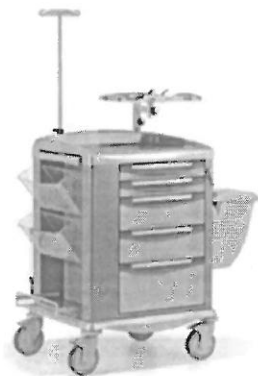

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Część III

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę lamp bakteriobójczych za pośrednictwem firmy kurierskiej, co nie zmienia w żaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy za ich jakość i prawidłowe działanie.

Montaż lamp jest prosty i nie wymaga od montażysty, elektryka żadnych specjalnych kwalifikacji, a cała operacja nie zajmuje więcej niż 10 - 15 minuty na jedną lampę.

Opcja dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej znacznie obniży wartość oferty.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część IV

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 8** tolerancje długości narzędzi chirurgicznych +/- 5 mm lub +/- 10 mm ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy jak w OPZ.

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie 8 poz. 4** pęsetę o długości 15 cm ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie 8 poz. 6** nożyczki o długości 15 cm ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 8 poz. 7** Nożyczki preparacyjne Toennis Adson z uchwytami złożonymi TC ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

Czy Zamawiający dopuścić w **Pakiecie 8 poz. 8** kleszczyki naczyniowe o nazwie własnej Rochester Ochsner ?
Rochester Ochsner = Pean.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

Czy Zamawiający dopuścić w **Pakiecie 8 poz. 13** Nożyczki LISTER o długości 18 cm ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

Czy Zamawiający dopuścić w **Pakiecie 8 poz. 14** Nożyczki LISTER o długości 20 cm ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

Czy Zamawiający dopuścić w **Pakiecie 8 poz. 15** Nożyczki BRUNS o długości 23 cm ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

Czy Zamawiający dopuścić w **Pakiecie 8 poz. 16** Piłę do gipsu

ZAMIĄST : o wadze 1,0 kg bez kabla (z kablem 1,2 kg)

WYKONAWCA OFERUJE : o wadze 0,97 kg bez kabla (z kablem 1,1 kg)?

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu w OPZ.

Czy Zamawiający dopuścić w **Pakiecie 8 poz. 16** Piłę do gipsu

ZAMIĄST : wersja slim motor z cichym silnikiem 52-77 dB(A)

WYKONAWCA OFERUJE : wersja slim motor z cichym silnikiem 50-72 dB(A) ?

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu w OPZ.

Czy Zamawiający dopuścić w **Pakiecie 8 poz. 20** Kleszcze Allis Baby o długości 13 cm ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

Czy Zamawiający dopuścić w **Pakiecie 8 poz. 22** Ssak do zatok Eicken o długości 15 cm ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

Czy Zamawiający dopuścić w **Pakiecie 8 poz. 24** wannę do dezynfekcji poj. 3 l. o wymiarach 300 x 200 x 110 mm ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

Czy Zamawiający dopuścić w **Pakiecie 8 poz. 34** kleszczyki Hartmann o dł. 9 cm ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

Czy Zamawiający dopuścić w **Pakiecie 8 poz. 39** łyżeczkę kostną Williger o długości 13,5 cm ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w OPZ.

Część V

Czy Zamawiający dopuścić czas realizacji 6-8 tygodni co jest standardowym terminem produkcji dla tego typu stołów ?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę o wydłużenie czasu realizacji do 6 tygodni.

Część VI

Pakiet nr 6: Stoły zabiegowe

1. W związku z różnicami ilościowymi pomiędzy załącznikiem nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy) a załącznikiem nr 2 (ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH) prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości wymaganych stołów zabiegowych.

Odp: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską formularza asortymentowo-cenowym, powinno być 4 sztuki.

Poz. I. Stół zabiegowy – szt. 2

2. Czy Zamawiający dopuścić do zaoferowania stół zabiegowy z podstawą i kolumną obudowanymi osłonami wykonanymi ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego, gdyż materiał z którego wykonane są osłony jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis ja w OPZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z podstawą w kształcie „przedłużonej litery >-<” umożliwiającą łatwy dostęp do powierzchni zabiegowej?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis ja w OPZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z leżem o szerokości 600mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu w OPZ.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z elektromechaniczną regulacją wysokości w zakresie 600-900mm, sterowanie za pomocą pilota przewodowego? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego, gdyż najniższa pozycja leża na wysokości 600mm znacznie ułatwia pacjentowi zajęcie miejsca na stole.

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu w OPZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z manualną regulacją głowy w zakresie +/-25°? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis ja w OPZ.

Poz. II. Stół zabiegowy – szt. 1

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z podstawą i kolumną obudowanymi osłonami wykonanymi ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym oraz segmentami leża (głowy, pleców, siedziska i nóg) tapicerowanymi w całości bez konieczności stosowania dodatkowych osłon wykonanych z tworzywa? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego, gdyż materiał z którego wykonane są osłony podstawy i kolumny są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, natomiast segmenty leża tapicerowane w całości są bardziej estetyczne jak te z zastosowanymi tworzywowymi osłonami?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis ja w OPZ.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z elektromechaniczną regulacją wysokości w zakresie 600-900mm, sterowanie za pomocą pilota przewodowego? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego, gdyż najniższa pozycja leża na wysokości 600mm znacznie ułatwia pacjentowi zajęcie miejsca na stole.

Odp: Zamawiający dopuszcza obok istniejącego zapisu w OPZ.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z elektromechaniczną regulacją segmentu pleców w zakresie -5°/+75°? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis ja w OPZ.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z manualną regulacją segmentu głowy w zakresie +/-25°? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis ja w OPZ.

Poz. III. Stół zabiegowy – szt. 1

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulowanym zagłówkiem przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie +/-45°? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis ja w OPZ.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z elektromechaniczną regulacją wysokości w zakresie 500-900mm, sterowanie za pomocą pilota przewodowego? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis ja w OPZ.

W związku z odpowiedziami na pytania do SWZ Zamawiający przesuwa termin składania ofert na **8 grudnia do godziny 9.30, otwarcie o godzinie 10.00.**

DYREKTOR
Średzkiego Centrum Zdrowia SP ZOZ
w Środzie Śląskiej
Jocanna Waluchowska

ŚREDZKIE CENTRUM ZDROWIA
SP ZOZ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
55-300 Środa Śląska, ul. Kolejowa 16A
NIP 9131631912 REGON 520248195