



Słupsk, dnia 07.11.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych, immunologicznych, fizykochemicznych, elementów moczu upostaciowionych oraz dzierżawa sortera analitycznego” - nr postępowania 87/PN/2024

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Firma XXX uprzejmie prosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania do warunków SWZ. Podkreślamy, iż odpowiedź Zamawiającego „Zgodnie z SWZ” lub podobna nie będzie stanowić odpowiedzi na pytanie zgodnie z ustawą Pzp. Zgodnie z treścią wyroku KIO 505/20, skład orzekający stwierdził, iż: „Zdaniem Izby zamawiający w każdym przypadku oświadczając „Zgodnie z SIWZ”, nie udzielił odpowiedzi na pytania. Oświadczenie takie nie stanowi rzeczywistego wyjaśnienia, gdyż odsyła jedynie SIWZ. (...). Obowiązkiem wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne jest współdziałanie z zamawiającym polegające na zadawaniu pytań wyjaśniających treść SIWZ (vide: wyrok Sm z 5 czerwca 2014 r. sygn. Akt CSK 626/13), zatem analogicznym obowiązkiem zamawiającego jest udzielanie rzetelnych i jasnych wyjaśnień”. (KIO 505/20)

Odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień art. 99 ustawy Pzp, który nakazuje opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszelkie wymagania oraz okoliczności mające wpływ na przygotowanie oferty.

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 pkt. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako analizatora wspomagającego (backupowego) półautomatycznego czytnika pasków do analizy moczu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 pkt. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator wspomagający (backupowy) pochodził od tego samego producenta, co analizator podstawowy?

Odp.: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Parametry techniczne analizatorów pkt. 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby zastosowana technologia umożliwiła obrazowanie mikroskopowe całych pól widzenia?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Parametry techniczne analizatorów pkt. 6:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje możliwości zmiany przez Użytkownika klasyfikacji poszczególnych elementów upostaciowanych na ekranie analizatora, przed odesłaniem wyniku do systemu LIS?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Parametry techniczne analizatorów pkt. 6:

Czy Zamawiający wymaga analizatora elementów upostaciowanych moczu posiadającego funkcjonalność obrazowania w czasie rzeczywistym, z możliwością ręcznej zmiany warstwy ogniskowej i wyboru pola widzenia przez operatora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Parametry techniczne analizatorów pkt. 16:

Narażenie pól testowych na działanie wilgoci jest jedną z głównych przyczyn ich degradacji, co może skutkować zafałszowaniem wyników badania.

Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany system prezentował ostrzeżenie wskazujące bezpośrednio na problem dotyczący zawilgocenia pól reakcyjnych i zabezpieczał przed ich użyciem (sprawdzanie i raportowanie przed nakropieniem próbki i odczytaniem wyniku), zapobiegając tym samym przed zaraportowaniem zafałszowanego wyniku?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Parametry techniczne analizatorów pkt. 20:

Czy Zamawiający oczekuje, że wraz z wynikami kontroli jakości będą archiwizowane obrazy cyfrowe (zdjęcia) próbki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Część III – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Parametry techniczne analizatorów pkt. 21:

Czy Zamawiający, w celu optymalizacji organizacji pracy, oczekuje zaoferowania uniwersalnego (tego samego) materiału kontrolnego dla wszystkich oferowanych analizatorów (moduł parametrów fizykochemicznych, moduł elementów upostaciowanych)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Parametry techniczne analizatorów pkt. 28:

Czy ze względu na standaryzację wymiarów i konstrukcji stołów dedykowanych pod analizatory, tym samym oferowanie sprawdzonych rozwiązań, Zamawiający odstąpi od wymogu ruchomych półek?

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu ruchomych półek na odczytniki. Zamawiający zmodyfikował Część III C SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3.

Pytanie nr 10:

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Parametry techniczne analizatorów pkt. 32:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie materiałów eksploatacyjnych do drukarki kodów?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 11:

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Parametry techniczne analizatorów WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA ANALIZATORÓW pkt. 33:

Czy Zamawiający dopuści harmonogram przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta? Pozwoli to zachować odpowiednie, zgodne z zaleceniami producenta, standardy pracy analizatora, a zarazem uzyskanie korzystniejszej oferty.

Odp.: Nie dopuszcza, Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądów okresowych 2 razy w roku.

Pytanie nr 12:

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Parametry techniczne analizatorów WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA ANALIZATORÓW pkt. 34:

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 180 minut od chwili zgłoszenia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13:

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Parametry techniczne analizatorów WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA ANALIZATORÓW pkt. 37:

Prosimy o zmianę zapisu na „Dostępność serwisu – ciągła, przez cały czas trwania umowy – zgłaszanie awarii przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy) przez infolinię, e-mail lub dedykowaną platformę / aplikację”.

Prosimy o zgodę na podanie jako telefonu do kontaktu numeru infolinii 800 120 133 lub 800 675 075 - co gwarantuje dostęp do obecnego w pracy inżyniera /specjalisty aplikacyjnego. Posiadanie numeru do wybranego inżyniera nie gwarantuje skutecznej pomocy serwisowej w przypadku rotacyjnej obsady inżynierów lub nieobecności danej osoby w pracy. Proponowane rozwiązanie zapewni najszybszą i najbezpieczniejszą drogę uzyskania wsparcia dla Zamawiającego, gwarantującą niezwłoczne zarejestrowanie, monitorowanie oraz udokumentowanie zgłoszenia. Fakt każdorazowej rejestracji zgłoszenia (w tym nagranie treści zgłoszenia) w systemie, dokumentuje działania obu stron, co odpowiada obecnym standardom rynkowym i polityce jakości.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. W opisanej sytuacji należy podać numery kontaktowe do wszystkich serwisantów przypisanych do realizacji tego zamówienia.

Pytanie nr 14:

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Parametry techniczne analizatorów WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA ANALIZATORÓW Pyt. do pkt. 37:

Czy Zamawiający, oprócz opcji telefonicznego zgłaszania awarii, wymaga również możliwości tworzenia zgłoszeń serwisowych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez dedykowaną platformę internetową oraz aplikację na urządzenia mobilne, z możliwością obserwacji historii zgłoszeń i pobierania raportów serwisowych przez Użytkownika?

Odp.: Zamawiający wymaga możliwości zgłaszania awarii tylko telefonicznie na numer bezpośredni serwisanta.

Pytanie nr 15:

Dotyczy Część III C SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Parametry techniczne analizatorów WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA ANALIZATORÓW Pyt. do pkt. 39:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie wymogu dot. terminu ważności odczynników do 6 miesięcy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Część IIA -Wzór umowy:

Czy zamawiający wyraża zgodę na ustalenie progu 0,1% za dzień zwłoki o którym mowa w par. 7 ust. 2, par. 7 ust. 3, par. 7 ust. 4, par. 7 ust. 5, par. 7 ust. 6?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

Dotyczy Część IIA -Wzór umowy:

Czy zamawiający dopuszcza ustalenie progu, o którym mowa w par. 8 ust. 3 pkt 16 na poziomie 15%?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 18:

Dotyczy Część III A SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO pkt. 3:

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie technologiczne, w którym:

- kalibracja modułu ISE jest przeprowadzana automatycznie co 4 godziny bez konieczności zastosowania zewnętrznego kalibratora, a kalibracja odbywa się bez angażowania operatora

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Dotyczy Część III A SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO pkt.4:

Serdecznie prosimy o doprecyzowanie czy podajnik na próbki ma posiadać 150 pozycji na próbek łącznie w kolejce (ścieżce) wejściowej i wyjściowej, czy też 150 pozycji w pozycji wejściowej i 150 osobnych miejsc w pozycji wyjściowej?

Odp.: Zamawiający wymaga, aby każdy z oferowanych analizatorów posiadał podajnik na próbki minimum 150 pozycji i dopuszcza oba rozwiązania.

Pytanie nr 20:

Dotyczy Część III A SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO pkt.10:

Prosimy o doprecyzowanie. Czy zamawiający przez sformułowanie: „Odczynniki w postaci płynnej gotowe do użycia, bez konieczności manualnego przygotowania.”, rozumie odczynniki płynne które mogą być dostarczane w opakowaniach innego typu i mogą być przelewane do dedykowanych opakowań, czy też dotyczy to tylko odczynników które sformułowane są w postaci liofilizatu i trzeba by je rozpuścić?

Odp.: Zamawiający przez sformułowanie „Odczynniki w postaci płynnej gotowe do użycia, bez konieczności manualnego przygotowania.” rozumie odczynniki płynne, które mogą być dostarczane w opakowaniach innego typu i mogą być przelewane do dedykowanych opakowań.

Pytanie nr 21:

Dotyczy Część III A SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO pkt.19:

Prośba o doprecyzowanie czy zamawiającemu chodzi o stabilność zamkniętych odczynników na pokładzie analizatora czy o stabilność otwartych, napoczętych odczynników?

Odp.: Zamawiający określa stabilność odczynników na pokładzie analizatora niezależnie od tego czy są otwarte, napoczęte czy też zamknięte.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Część III A SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO pkt. 27:

Prośba o doprecyzowanie, czy zamawiający przez zapis: „Elektrody bezobsługowe niewymagające uzupełniania płynów i wymiany membran. Wymieniane pojedynczo.” Rozumie elektrody, które do pracy nie wymagają zastosowania standardów, rozcieńczalników i kalibratorów?

Odp.: Zamawiający wymaga, aby elektrody były bezobsługowe, niewymagające uzupełniania płynów i wymiany membran oraz wymieniane pojedynczo. Natomiast Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardów, rozcieńczalników i kalibratorów do pracy analizatora.

Pytanie nr 23:

Dotyczy FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1 poz.14:

Czy zamawiający dopuszcza wykonywanie oznaczenia CKMB na analizatorze immunochemicznym.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Dotyczy FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1 poz.53:

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązywanie oznaczania UIBC jako parametr wyliczany z TIBC i żelaza?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Dotyczy Części nr 2:

Dot. § 3 ust. 1 wzoru umowy CZĘŚĆ II A:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy przedmiotu zamówienia, cyklicznie według rzeczywistych potrzeb Zamawianego odbywał się do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę tylko dla części nr 2. Zamawiający zmodyfikował Część II A SWZ – Wzór umowy.

Pytanie nr 26:

Dotyczy Części nr 2:

Dot. § 3 ust. 3 wzoru umowy CZĘŚĆ II A :

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie było większe niż 20%, a minimalny próg wykonania umowy wynosił min. 80%.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 27:

Dot. § 5 ust. 1 wzoru umowy CZĘŚĆ II A:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników dla immunochemii z minimum 4 miesięcznym terminem ważności?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28:

Dot. § 7 ust. 8 wzoru umowy CZĘŚĆ II A:

Czy Zamawiający jako „część umowy” ma na myśli oferowane przez Wykonawcę odczynniki, kalibratory, kontrole, materiały zużywalne i analizator?

Odp.: Zamawiający ma na myśli analizator.

Pytanie nr 29:

Dot. § 7 ust. 8 wzoru umowy CZĘŚĆ II A:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację niniejszego zapisu na „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł netto za każde stwierdzone powierzenie danych osobowych podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, a także karę umową w wysokości 5 000,00 zł netto za każde stwierdzenie powierzenia podwykonawcy wykonania części umowy bez zgody Zamawiającego z wyłączeniem dostawcy LIS, firm transportowych (kurierskich) oraz dostawcy materiałów kontrolnych”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 30:

Dot. § 1 ust. 2.1. wzoru umowy CZĘŚĆ II B:

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu dzierżawy z 14 dni na min. 21 dni od daty zawarcia umowy. Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu dzierżawy dla części nr 2. Zamawiający zmodyfikował Część II B SWZ – Wzór umowy dzierżawy.

Pytanie nr 31:

Dot. § 3 ust. 12 wzoru umowy CZĘŚĆ II B oraz pkt. 36 parametry wymagane:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego zapisu na: „Wydzierżawiający zobowiązuje się przystąpić do naprawy nie później niż w ciągu 24 godzin w dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii w przypadku awarii jednego z analizatorów oraz 12 h w przypadku awarii analizatora głównego i backup”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32:

Dot. § 3 ust. 12 wzoru umowy CZĘŚĆ II B:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego zapisu na: „Wydzierżawiający zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze, licząc od momentu przystąpienia do naprawy oraz 48 godzin w przypadku awarii analizatora głównego i backup”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33:

Dot. pkt. 3 i 4 - Parametry wymagane, Parametry techniczne analizatorów immunochemicznych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę dla analizatora głównego i analizatora wspomagającego, aby to maksymalna katalogowa wydajność aparatu wynosiła 200 oznaczeń na godzinę?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34:

Dot. pkt. 10 - Parametry wymagane, Parametry techniczne analizatorów immunochemicznych:

Czy Zamawiający przez kalibratory gotowe do użycia, rozumie takie które nie wymagają rekonstytucji?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 35:

Dot. pkt. 34 - Parametry wymagane, Parametry techniczne analizatorów immunochemicznych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rozwiązania:

Przegląd techniczny analizatorów min. 1 w roku połączony z czterocznym proaktywną materiałów eksploatacyjnych przez autoryzowany serwis producenta połączony z przeglądem technicznym podzespołów opartym o zalecenia wynikające z danych pochodzący z ciągłego zdalnego monitoringu analizatorów, zakończonego wpisem w paszporcie technicznym urządzenia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36:

Dot. pkt. 35 - Parametry wymagane, Parametry techniczne analizatorów immunochemicznych:

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje punktu na: Czas reakcji serwisu – max. 60 min. od chwili zgłoszenia w godzinach 8-21.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37:

Dot. pkt. 37 - Parametry wymagane, Parametry techniczne analizatorów immunochemicznych:

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje punktu na: Dostępność serwisu – ciągła, przez cały czas trwania umowy – zgłaszanie awarii przez 24 godz./dobę i wsparcie serwisanta w godzinach min 8-21, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca przekaze Zamawiającemu bezpośredni numer telefonu do serwisanta.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38:

Dot. pkt. 40 - Parametry wymagane, Parametry techniczne analizatorów immunochemicznych:

Celem określenia zmian adaptacyjnych, prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39:

Dot. pkt. 43 - Parametry wymagane, Parametry techniczne analizatorów immunochemicznych:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta dla parametrów ilościowych i możliwość zrezygnowania z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej.

Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający wymaga aby oferent zaoferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta ? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora.

Odp.: Zamawiający nie posiada na wyposażeniu podchlorynu i wymaga dostarczenia go przez wykonawcę.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu 4 sprawdzianów kontroli EQA dla Cyklosporyny, Toxo Awidności i anty CCP i zgodzi się na zaoferowanie 2 sprawdzianów w ciągu roku?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 2 sprawdzianów w ciągu roku dla Cyklosporyny, Toxo Awidności i anty CCP.

Pytanie nr 43:

Dotyczy § 7 projektu umowy – CZĘŚĆ II A – WZÓR UMOWY:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego zapisu na:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust. 1) zwłoki w dostawie.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej lub wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44:

Pakiet 3 I 4 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA ANALIZATORÓW: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów na:

Czas reakcji serwisu – do 3 godzin od chwili zgłoszenia.

Czas przystąpienia do naprawy – do 48 godz. od chwili zgłoszenia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45:

Pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby analizator wspomagający, backupowy był innego producenta i pracował w oparciu o inne materiały eksploatacyjne? Jeśli tak, prosimy o określenie przez Zamawiającego ilości planowanych badań na analizatorze backupowym.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający szacuje, że ilość badań na analizatorze backupowym wyniesie około 10%.

Pytanie nr 46:

Pakiet 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podstawowego analizatora do badań parametrów fizykochemicznych, który nie wymaga kalibracji przez użytkownika?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 47:

Pakiet 3

Czy Zamawiający wymaga systemu analitycznego do badania moczu, który po umieszczeniu statywów z próbkami na pokładzie, automatycznie rozpoczyna pracę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 48:

Pakiet 3

Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe stosowane w podstawowym analizatorze do badania parametrów fizykochemicznych posiadały pole testowe do pomiaru kwasu askorbinowego? Kwas askorbinowy jest silnym czynnikiem interferującym w testach paskowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 49:

Pakiet 3

Czy zamawiający wymaga pasków testowych wykrywających leukocyty? (esteraza leukocytów)

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 50:

Pakiet 3

Czy Zamawiający wymaga, aby odczynniki i wszystkie materiały zużywalne były gotowe do użycia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 51:

Pakiet 3

Czy Zamawiający wymaga analizatora do oceny elementów upostaciowanych w moczu niewirowanym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 52:

Pakiet 3

Czy Zamawiający wymaga analizatora, który pozwala na ciągłe dokładanie pasków w trakcie pracy analizatora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 53:

Pakiet 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ważność odczynników od dnia dostawy wynosiła minimum 6 miesięcy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54:

Pakiet 3

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy analizatorów do 4 tygodni.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55:

Pakiet 4

W związku z wymogiem dostarczenia sortera z modułem tworzenia próbek wtórnych prosimy o podanie liczby wykonywanych wtórników w celu określenia ilości materiałów zużywalnych do zaoferowania. Prosimy jednocześnie o rozbudowanie tabeli ofertowej o materiały zużywalne do tworzenia próbek wtórnych

Odp.: Zamawiający planuje wykonywać rocznie około 10 000 próbek wtórnych.

Pytanie nr 56:

Pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga sortera z oprogramowaniem w języku polskim?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 57:

Pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga sortera, z możliwością rozpoznawania w trzech wymiarach przestrzennych (3D) kształtu, rozmiaru oraz koloru korka – np. zdjęcia wykonywane zarówno od frontu oraz z góry próbki w celu zapewnienia dokładnej identyfikacji rodzaju próbki i materiału znajdującego się wewnątrz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 58:

Pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga precyzyjnej identyfikacji korków zawierających kolorowy pierścień determinujący rodzaj, zawartość i przeznaczenie próbki potwierdzone załączeniem firmowych ulotek i zdjęć.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 59:

Pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga bazy instalacyjnej sorterów z modułem rozlewającym w Polsce w ilości minimum 8 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 60:

Pytania do umowy: Część IIA §3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”?

Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61:

Pytania do umowy: Część IIA §3 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na 4 dni robocze?

Odp.: Patrz pytanie nr 25.

Pytanie nr 62:

Pytania do umowy: Część IIA §3 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kart charakterystyki, o których mowa po podpisaniu umowy, a nie z pierwszą dostawą?

Uzasadnienie: Towar wysyłany jest z magazynu – gdzie pracownicy pakują towar nie wiedząc, która dostawa jest pierwsza. Metodyki te są również dostępne na stronie internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający ma całodobowy nieodpłatny dostęp.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 63:

Pytania do umowy: Część IIA §3 ust. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wartości minimalnej na 70%?

Uzasadnienie: Wykonawcy kalkulują oferty w oparciu o 3 letni okres zapotrzebowania dążąc do zaoferowania możliwie jak najkorzystniejszych warunków dla Zamawiającego. Przy takiej konstrukcji postanowienia Wykonawca będzie zobowiązany wziąć pod rozwagę gwarancje co do dostarczania produktów w okresie ok 300 dni z 1095 dni, w których umowa ma obowiązywać co znacząco zwiększy koszty po stronie Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 64:

Pytania do umowy: Część IIA §5 ust. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Jeżeli podczas odbioru lub pierwszego użycia okaże się, że towar jest wadliwy to odpowiednio, wadliwe części dostawy lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65:

Pytania do umowy: Część IIA §5 ust. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji dostarczy zamienny, pozbawiony wad i braków, element takiego samego towaru bez wad, na swój koszt i ryzyko. Towar zamienny podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 66:

Pytania do umowy: Część IIA §7 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 67:

Pytania do umowy: Część IIA §7 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust. 1) zwłoki w dostawie”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 68:

Pytania do umowy: Część IIA §7 ust. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1,5% czynszu dzierżawnego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie i zainstalowaniu przedmiotu dzierżawy”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 69:

Pytania do umowy: Część IIA §7 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1,5% czynszu dzierżawnego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie i zainstalowaniu urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 3 ust. 13 Umowy dzierżawy”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 70:

Pytania do umowy: Część IIA §7 ust. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 71:

Pytania do umowy: Część IIA §7 ust. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej za zasadną w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 72:

Pytania do umowy: Część IIA §7 ust. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w związku ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w § 8 ust. 3 pkt 14-18 Umowy”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 73:

Pytania do umowy: Część IIA §7 ust. 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 500,00 zł netto za każde stwierdzone powierzenie danych osobowych podwykonawcy bez zgody

Zamawiającego, a także karę umowną w wysokości 2 500,00 zł netto za każde stwierdzenie powierzenia podwykonawcy wykonania części umowy bez zgody Zamawiającego”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 74:

Pytania do umowy: Część IIA §7 ust. 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 500,00 zł netto za każde stwierdzone niepoinformowanie Zamawiającego o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 75:

Pytania do umowy: Część IIA §8 ust. 3 pkt. 15)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy należy złożyć w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 76:

Część IIB §3 ust. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wydzierżawiający zobowiązuje się przystąpić do naprawy nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 77:

Część IIB §3 ust. 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wydzierżawiający zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 72 godziny, licząc od momentu przystąpienia do naprawy.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78:

Część III A SWZ - OPZ dla części nr 1 Dostawa odczynników, kontroli, płynów systemowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów do wykonania około 2 432 790 badań biochemicznych przez okres 36 m-cy. PARAMETRY BEZWZGLĘDNIIE WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO. Punkt 2.

Prosimy o potwierdzenie, że wymagana wydajność dotyczy każdego z oferowanych analizatorów (głównego i zastępczego)?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wymagana wydajność dotyczy każdego z oferowanych analizatorów, nie jest to wydajność wspólna dla dwóch analizatorów.

Pytanie nr 79:

Część III A SWZ - OPZ dla części nr 1 Dostawa odczynników, kontroli, płynów systemowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów do wykonania około 2 432 790 badań biochemicznych przez okres 36 m-cy. PARAMETRY BEZWZGLĘDNIIE WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO. Punkt 5.

Prosimy o potwierdzenie, że wymagana ilość pozycji dotyczy możliwości wykonania 55 oznaczeń?

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż wymagana ilość pozycji w rotorze dotyczy możliwości wykonania 55 oznaczeń na każdym z oferowanych analizatorów.

Pytanie nr 80:

Część III A SWZ - OPZ dla części nr 1 Dostawa odczynników, kontroli, płynów systemowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów do wykonania około 2 432 790 badań biochemicznych przez okres 36 m-cy. PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO. Punkt 10.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania dwóch odczynników (MTX, TBA) wymagających przelania do odpowiedniej kasety, bez konieczności odmierzenia jakichkolwiek ilości?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony w opisanej sytuacji.

Pytanie nr 81:

Część III A SWZ - OPZ dla części nr 1 Dostawa odczynników, kontroli, płynów systemowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów do wykonania około 2 432 790 badań biochemicznych przez okres 36 m-cy. PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO. Punkt 12.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku bezpośredniego dostępu do zleceń CITO poprzez dedykowane raki lub port CITO?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony w opisanej sytuacji.

Pytanie nr 82:

Część III A SWZ - OPZ dla części nr 1 Dostawa odczynników, kontroli, płynów systemowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów do wykonania około 2 432 790 badań biochemicznych przez okres 36 m-cy. PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO. Punkt 14.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli objętość mieszaniny reakcyjnej jest w zakresie 75- 185µl?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony w opisanej sytuacji.

Pytanie nr 83:

Część III A SWZ - OPZ dla części nr 1 Dostawa odczynników, kontroli, płynów systemowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów do wykonania około 2 432 790 badań biochemicznych przez okres 36 m-cy. PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO. Punkt 19.

Czy Zamawiający dopuści aby stabilność odczynników na pokładzie wynosiła do 182 dni?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84:

Część III A SWZ - OPZ dla części nr 1 Dostawa odczynników, kontroli, płynów systemowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów do wykonania około 2 432 790 badań biochemicznych przez okres 36 m-cy. PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO. Punkt 31

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku kiedy oferowane analizatory wyposażone są w dwie igły / sondy próbkowe i dwie odczynnikowe?

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 130.

Pytanie nr 85:

Dotyczy. Część III B SWZ - OPZ dla części nr 2. Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli, płynów systemowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów do wykonania około 373 270 oznaczeń immunologicznych przez okres 36 m-cy. PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORÓW IMMUNOLOGICZNYCH pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwisowanie aparatów przez autoryzowany serwis dystrybutora / Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 86:

Część III B SWZ - OPZ dla części nr 2, PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORÓW IMMUNOLOGICZNYCH. Punkt 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu wspomagającego o maksymalnej wydajności 120 ozn./godz., przy jednoczesnym zaoferowaniu aparatu głównego o maksymalnej wydajności 300 ozn./godz.? Łączna maksymalna wydajność dwóch analizatorów immunochemicznych (aparat główny i wspomagający) wynosić będzie w takim przypadku 420 ozn./ godz., a więc będzie wyższa niż opisana przez Zamawiającego w p. 3 i 4 (łącznie 400 ozn./godz.). Łączna wydajności 420 ozn./ godz. w zupełności wystarczy na zaspokojenie potrzeb laboratorium i pozwoli na oznaczenie dziennej ilości badań immunochemicznych w czasie poniżej 1 godziny.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 87:

Część III B SWZ - OPZ dla części nr 2, PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORÓW IMMUNOLOGICZNYCH. Punkt 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu wspomagającego posiadającego 28 pozycji odczynnikowych, przy jednoczesnym zaoferowaniu aparatu głównego posiadającego 48 miejsc odczynnikowych? Łączna ilość miejsc odczynnikowych dwóch analizatorów immunochemicznych (aparat główny i wspomagający) wynosić będzie w takim przypadku 76 pozycji, co z nadmiarem wystarczy na jednoczesną dostępność wszystkich wyspecyfikowanych przez Zamawiającego parametrów (46 odczynników immunochemicznych).

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 88:

Część III B SWZ - OPZ dla części nr 2, PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORÓW IMMUNOLOGICZNYCH. Punkt 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uzupełnianie odczynników w aparacie wspomagającym odbywało się bez przerywania procesu analizy w trybie "wstrzymanie pobierania statywów", trwającym nie dłużej niż 5 min.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 89:

Dotyczy Część III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1- W związku z wymogiem zapewnienia systemu kolejkowego prosimy Zamawiającego o odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza udostępnienie zasobów serwerowych wykonawcy systemu kolejkowego w celu instalacji maszyny wirtualnej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90:

Dotyczy. Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy.xlsx FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 2.

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, ft4, ft3 i anty-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji noworodków, niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

Pytanie nr 91:

Dotyczy. Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy.xlsx FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 2.

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total wyłącznie jako test ciężowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

Odp.: Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total jako test ciężowy.

Pytanie nr 92:

Część III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 2, Parametry wymagane analizatorów immunochemicznych, punkt 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora który stosuje jednorazowe kuwety reakcyjne, a pomiar i odczyt końcowy, ze względu na zastosowaną technologię, odbywa się w komorze pomiarowej będącej elementem wyposażenia aparatu? Aparat ten nie wymaga i nie stosuje jednorazowych kuwet pomiarowych, a użycie jednorazowych końcówek dozujących oraz jednorazowych kuwet reakcyjnych zabezpiecza całkowicie przed ryzykiem kontaminacji i carry-over

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 93:

Część III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 2, Parametry wymagane analizatorów immunochemicznych, punkt 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby część kalibratorów dostarczanych była w formie liofilizatu do szybkiej jednorazowej rekonstrukcji? Proces przygotowania nie jest czasochłonny - jednorazowo wystarczy rekonstruować zawartość fiolki przy pomocy automatycznej pipety (co zajmuje nie więcej niż 1 minutę), i tak przygotowana kontrola/kalibrator są już w formie płynnej i gotowej do użycia.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 94:

Część III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 2, Parametry wymagane analizatorów immunochemicznych, punkt 11:

Czy pod określeniem "chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu do temperatury lodówki" Zamawiający rozumie zakres temperatury 5 - 10°C?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania takiej temperatury lodówki na pokładzie analizatora, która jest wymagana przez producenta odczynników.

Pytanie nr 95:

Część III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 2, Parametry wymagane analizatorów immunochemicznych, punkt 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby identyfikowanie odczynników odbywało się za pomocą kodu RFID?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 96:

Część III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 2, Parametry wymagane analizatorów immunochemicznych, punkt 43:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla testów gdzie ilość oznaczeń jest mniejsza niż 365 rocznie, codzienna kontrola wykonywana była wraz z oznaczeniem danego testu, naprzemiennie stosując różne poziomy materiałów kontrolnych?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 97:

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy - CZĘŚĆ NR 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania wysokoczułej Troponiny I lub wysokoczułej Troponiny T? Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno troponina I hs jak i troponina T hs są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej. Przy wysokoczułej TnT Zamawiający zyskuje ponadto lepsze narzędzie prognostyczne w różnych stanach kardiologicznych - źródło: Wytyczne ESC 2020 dotyczące postępowania u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST, Zeszyty edukacyjne Kardiologia Polska 6/2020, str.27: Podczas gdy hs-cTnT i I mają porównywalną dokładność diagnostyczną, hs-cTnT wykazuje większą wartość prognostyczną.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 98:

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy - CZĘŚĆ NR 2:

Prosimy o uściślenie ile oznaczeń kortyzolu w moczu Zamawiający zamierza wykonać w trakcie trwania umowy?

Odp.: Zamawiający planuje wykonać około 10% oznaczeń z podanej ilości w formularzu asortymentowo-ilościowym.

Pytanie nr 99:

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy - CZĘŚĆ NR 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oznaczenia kortyzolu wykonywane było w ślinie lub w moczu? Oznaczenia wolnego kortyzolu w ślinie są nowoczesną alternatywą dla mniej dokładnych oznaczeń kortyzolu w moczu, o czym świadczy obszerne piśmiennictwo w tym zakresie.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 100:

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy - CZĘŚĆ NR 2:

Prosimy o uściślenie czy oferowany odczynnik do oznaczania PTH ma być odczynnikiem 3 generacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 101:

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy - CZĘŚĆ NR 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny wysokoczułej był zgodny z aktualnymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 102:

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy - CZĘŚĆ NR 2:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany odczynnik do oznaczania prolaktyny posiadał zwalidowaną metodykę i możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny, co umożliwi wiarygodną interpretację wyników u pacjentów z makroprolaktynemią?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 103:

Dotyczy Część III A SWZ - OPZ dla części nr 1 W związku z wymogiem zapewnienia udziału w kontroli zewnętrznej wszystkich badań z załącznika asortymentowo-cenowego minimum 4 razy w roku na koszt Wykonawcy, prosimy Zamawiającego o zgodę na zapewnienie kontroli do parametrów, do których jest ona dostępna na rynku. Na dzień dzisiejszy na rynku nie jest dostępna kontrola do parametrów tj. Glukoza met. Heksokinazowa w surowicy w krwi pełnej Immunoglobulina IgA PMR i IgM PMR.

Odp.: Zamawiający dopuszcza brak zaoferowania kontroli glukozy met. heksokinazową w krwi pełnej immunoglobuliny IgA i IgM w PMR, natomiast nie wyraża zgody na brak kontroli glukozy metodą heksokinazową w surowicy.

Pytanie nr 104:

Dotyczy Część III A SWZ - OPZ dla części nr 1 W związku z wymogiem zapewnienia udziału w kontroli zewnętrznej wszystkich badań z załącznika asortymentowo-cenowego minimum 4 razy w roku na koszt Wykonawcy, prosimy Zamawiającego o zgodę na zapewnienie kontroli do parametru Cystatyna C- w dostępnej na rynku częstotliwości tj. cykl roczny (2 rundy).

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie kontroli do parametru Cystatyna C - w dostępnej na rynku częstotliwości tj. cykl roczny (2 rundy).

Pytanie nr 105:

Część III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1,2,4

| |
|--|
| Dostępność serwisu - ciągła, przez cały czas trwania umowy - zgłaszania awarii i wsparcie serwisanta przez 24 godz. / dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca przekaze Zamawiającemu bezpośredni numer telefonu do serwisanta. |
|--|

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

“Możliwość zgłoszenia awarii całodobowo w dni robocze i świąteczne, telefonicznie lub poprzez aplikację navify.”

Czy Zamawiający zgodzi się na niepodawanie konkretnych inżynierów?

Komentarz: Całodobowa możliwość zgłoszenia awarii jest poprzez kontakt telefoniczny z Regionalnym Centrum Wsparcia, e-mailem lub przez platformę navify. Jeśli nie uda się pomóc zdalnie, wówczas do zadania przydzielany jest dostępny inżynier, o odpowiednich umiejętnościach dla danego aparatu, który kontaktuje się z klientem i umawia wizytę.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 106:

Dot. SWZ zał. część III A SWZ, część III B SWZ, część III D SWZ proszę o informację czy w kolumnie „parametry oferowane” będzie wystarczające wpisanie słowa „TAK” na potwierdzenie parametrów wymaganych?

Odp.: Zamawiający potwierdza, z wyjątkiem wiersza w którym należy wskazać numer telefonu serwisanta.

Pytanie nr 107:

Dot. SWZ pkt 13. 2. 5a przedmiotowe środki dowodowe Czy Zamawiający wyrazi zgodę by dostarczone materiały dotyczyły oferowanych analizatorów.

Odp.: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających parametry wskazane w Części III SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, czyli dotyczące oferowanych analizatorów i kompatybilnych z nimi odczytników, kontroli i kalibratorów.

Pytanie nr 108:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 109:

Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w opisanej sytuacji wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Pytanie nr 110:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?


Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 111:

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

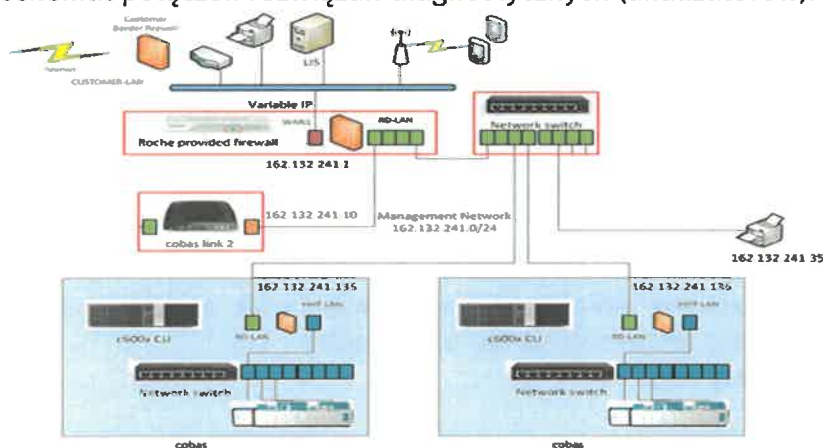

| URL | IP | Port | Typ | Description |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------|---|
| *.navify.com | 193.88.193.0/24 | 443 | CloudFlare | Main connections enabling Remote Service |
| *.navify.com | 193.228.103.0/24 | 433 (514/541) | CloudFlare | Current/future setup using Cloudflare |
| remoteservice.roche.com | 62.209.44.11 | 443 | Direct | Dedicated connections enabling Remote Support |
| remoteservice-gas1.roche.com | 62.209.44.21 | 443 | Direct | Dedicated connections enabling Remote Support |
| remoteservice-gas2.roche.com | 62.209.44.22 | 443 | Direct | Dedicated connections enabling Remote Support |
| remoteservice-gas3.roche.com | 209.202.167.19 | 443 | Direct | Dedicated connections enabling Remote Support |
| remoteservice-gas4.roche.com | 209.202.167.20 | 443 | Direct | Dedicated connections enabling Remote Support |
| remoteservice-gas5.roche.com | 120.136.45.231 | 443 | Direct | Dedicated connections enabling Remote Support |
| remoteservice-gas6.roche.com | 120.136.45.230 | 443 | Direct | Dedicated connections enabling Remote Support |
| remoteservice-gas15.roche.com | 35.76.193.4 | 443 | Direct | Dedicated connections enabling Remote Support |
| remoteservice-gas16.roche.com | 52.193.219.53 | 443 | Direct | Dedicated connections enabling Remote Support |
| rln-cm-***.dis.roche.com | 52.178.37.238 | 514 / 541 | Direct | Dedicated connections enabling FortiGate management |
| teleservice.roche.com | 196.3.50.39 | 443 / 80 | HTTP | Dedicated connection to TSN |
| remoteservice-dr.roche.com | 209.202.167.21 | 443 | Direct | Axede Disaster Recovery |

Odp.: Tak, Zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu.

Pytanie nr 112:

Część III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1, 2, 4 pkt 40: W związku z wymogiem wykonania zmian adaptacyjnych prosimy Zamawiającego o wskazanie dokładnego zakresu prac.

Odp.: Zamawiający oczekuje przeprowadzenia zmian adaptacyjnych w zakresie:

- **wykonanie ścianki działowej (kartonowo-gipsowej) i odświeżenie ścian w pomieszczeniu o kubaturze 15 m2 w punkcie numer 1 walidacji wyników i doposażenia w niezbędne meble,**
- **doposażenie punktu walidacji wyników numer 2 w niezbędne meble oraz odświeżenie ścian w pomieszczeniu o kubaturze 15 m2,**
- **doposażenie punktów walidacji wyników, pracownię immunologiczną oraz punktu przyjęcia materiału w rolety zewnętrzne w ilości 6 sztuk (wymiar okna 175 cm /235 cm),**
- **wykonanie ścianki działowej w punkcie przyjęcia materiału (wymiary 300 cm/200 cm).**

Pytanie nr 113:

PYTANIA DO UMOWY: par. 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia, tak aby minimalny poziom zamówienia wyniósł 80%?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 114:

PYTANIA DO UMOWY: par. 3 ust. 7-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 115:

PYTANIA DO UMOWY: par. 3 ust. 7-9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 116:

PYTANIA DO UMOWY: par. 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie: Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 117:

PYTANIA DO UMOWY: par. 7 ust. 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia, tak aby kara była liczona od wartości czynszu dzierżawnego dla urządzenia, z którego dostawą Wykonawca pozostaje w zwłoce?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 118:

PYTANIA DO UMOWY: par. 7 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z "5 000,00 zł" na "1 000,00 zł"?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 119:

PYTANIA DO UMOWY: par. 7 ust. 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 120:

PYTANIA DO UMOWY: par. 8 ust. 3 pkt 14)

W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Czy wobec powyższego Zamawiający wprowadziłby do wzoru umowy zaproponowaną poniżej treść postanowień waloryzacyjnych zgodnych z art. 439 PZP, które dzielą koszty wzrostu cen pomiędzy zamawiającego i wykonawcę?

1. Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §6 Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).

2. Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).

3. Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.

4. Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.

5. Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.

6. W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.

7. W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.

8. W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy.

10. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca przekaze Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 121:

PYTANIA DO UMOWY: par. 8 ust. 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 122:

CZĘŚĆ II B – WZÓR UMOWY DZIERŻAWY par. 1 ust. 2 pkt 2.1 i par. 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzeń do 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury celne z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy w zaproponowany w sposób.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń do 21 dni od daty zawarcia umowy tylko dla części nr 2. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy termin na instalację urządzenia. Zamawiający zmodyfikował Część II B SWZ – Wzór umowy dzierżawy.

Pytanie nr 123:

CZĘŚĆ II B – WZÓR UMOWY DZIERŻAWY par. 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji w formie elektronicznej tj. pliku przesłanego w email lub udostępnionego na stronie internetowej? Rozwiązanie takie należy uznać za optymalniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, zapewniające Zamawiającemu bieżący i nieograniczony dostęp, zwłaszcza wobec postępującego procesu elektronizacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający dopuszcza przestanie instrukcji w formie elektronicznej.

Pytanie nr 124:

CZĘŚĆ II B – WZÓR UMOWY DZIERŻAWY par. 3 ust. 11-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 125:

CZĘŚĆ II B – WZÓR UMOWY DZIERŻAWY par. 3 ust. 13

Czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy, a tym samym wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 126:

CZĘŚĆ II B – WZÓR UMOWY DZIERŻAWY par. 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 127:

CZĘŚĆ II C – WZÓR UMOWY RODO - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH par. 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy załącznika nr 1 z listą podmiotów podprzetwarzających, w tym na dodanie do Umowy par. 4 ust. 9 o treści "Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Podmiot przetwarzający jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy."?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie załącznika nr 1. Zamawiający zmodyfikował Część II C SWZ – Wzór umowy RODO.

Pytanie nr 128:

CZĘŚĆ II C – WZÓR UMOWY RODO - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH par. 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:

"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrazać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmodyfikował Część II C SWZ – Wzór umowy RODO.

Pytanie nr 129:

Dotyczy Części nr 2: Dot. pkt. 32 - Parametry wymagane, Parametry techniczne analizatorów immunochemicznych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie witryny mroźniczej zamrażarką o pełnych drzwiach o pojemności wymaganej przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 130:

Część III A SWZ - OPZ dla części nr 1 Dostawa odczynników, kontroli, płynów systemowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów do wykonania około 2 432 790 badań biochemicznych przez okres 36 m-cy. PARAMETRY BEZWZGLĘDNE WYMAGANE DLA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO. Punkt 32

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku kiedy oferowane analizatory wyposażone są w dwie igły / sondy próbkowe i dwie odczynnikowe?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony w opisanej sytuacji.

Ponadto:

Zamawiający działając na podstawie **art. 137 ust. 1 PZP** dokonuje zmiany w treści SWZ. Zgodnie z **art. 137 ust. 2 PZP** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający działając na podstawie **art. 135 ust. 3 PZP** przedłuża termin składania ofert na dzień **14.11.2024 roku do godz. 09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **14.11.2024 roku o godz. 10:00**.

Zmianie ulega pkt 17.1 i 18.1 Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega również pkt 12.1 Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą na dzień **11.02.2024 r.**

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.


KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak

Załączniki:

- 1) Część II A SWZ – Wzór umowy
- 2) Część II B SWZ – Wzór umowy dzierżawy
- 3) Część II C SWZ – Wzór umowy RODO
- 4) Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-ilościowy dla części nr 2