



Wrocław, 19.04.2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław**

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem monitorów; 4WSzKzP.SZP.2612.4.2021

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dalej SWZ w ww. postępowaniu przetargowym:


Pytanie nr 1: Pakiet nr 12- Czy Zamawiający dopuści adsorber o niżej wymienionych parametrach:

1. Objętość wypełniająca krwi 185 ml.
2. Minimalny przepływ 100 ml.
3. Max. przepływ 700 ml.
4. Adapter do CPB.
5. Adapter do ECMO.
6. Adapter do intergracji za hemofiltrem PRISMA FLEX.
7. Adapter do primingu .

Odpowiedź na pytanie nr1: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2: Pakiet nr 11 - Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available

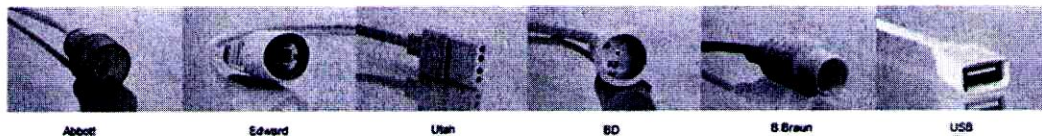

Odpowiedź na pytanie nr 2: Kończówka EDWARDS (nr 2 z obrazów załączonych powyżej)

Pytanie nr 3- Pakiet nr 11- Bardzo prosimy Zamawiającego o podanie jaką ilość kabli będzie wymagał i dokładnie do jakich monitorów?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Ilość kabli: 1 szt. do monitorów: STOCKERT S III, MAQUET HL-30

Pytanie nr 4: Pakiet 4 - Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści oksygenator z przepływem 0,5-7l/min, wypełnieniem statycznym 366ml, powierzchnią wymiany gazowej 1,78m² i wymiennikiem ciepła poliuretanowym?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5: Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści schematy drenów do zadania nr 1 – schematy w załączeniu ?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza.

