



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 04.12.2024 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO.**

Nr postępowania: ZP/31/24

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- Dotyczy Pakietu Nr 23, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści w pak. 23 w poz.1 siatki przepuklinowe polipropylenowe :
 - gramatura siatki 50g/m²
 - grubość siatki 0,41 mm
 - wielkość porów 1x1,25 mm
 - grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?Rozmiary zgodnie z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 1** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 17 poz.1 Cewnik trocar do drenażu klatki piersiowej w dostępnych rozmiarach: 16, 20, 24, 28, 32
Zamawiający dopuszcza.
- Dotyczy Pakietu Nr 23: Siatki przepuklinowe** - Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy i które spełniają zasady konkurencyjności oraz zachowują funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta, proponujemy:
Polipropylenową monofilamentową siatkę chirurgiczną:
 - _ Niewchłaniałna siatka polipropylenowa z pojedynczym włóknem
 - _ Konstrukcja z siatki dziewiarskiej, wycinana laserowo.
 - _ Wytrzymałość na rozerwanie: 18 kg/cm²
 - _ gramatura siatki (gram/m²): < 46 gramów/m²
 - _ Rozmiar porów: 1,5 mm – 2,0 mm.
 - _ Grubość Filamentu: 0,15 mm
 - _ Grubość siatki: 0,56 mm.
 - _ Sterylizowany EO.Elastyczna, mocna, elastyczna i przezroczysta siatka. Idealna porowatość zapewniająca dobrą widoczność i kolonizację. Wysoka wytrzymałość i odporność na rozerwanie zapewniająca trwałe wsparcie. Z przeznaczeniem do naprawy przepuklin, rekonstrukcji ściany klatki piersiowej, rany pourazowe lub chirurgiczne, zabiegi interwencyjne powięzi, do zabiegów laparoskopowych, rozmiar zgodny z opisem



Zgodnie z zapisami SWZ.

4. **Dotyczy Pakietu Nr 24: Siatki przepuklinowe** - Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy i które spełniają zasady konkurencyjności oraz zachowują funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta, o różnicach podanych poniżej:
Rozmiar porów: 1,5 mm – 2,0 mm zamiast wielkości porów min. 3,6x2,8 mm.
W rozmiarze 30x30 zamiast 20 x 30
pozostałe parametry jak w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 30: Siatka przepuklinowa tytanizowana** - Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy i które spełniają zasady konkurencyjności oraz zachowują funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści:
Siatki bez parametru „powierzchniowo tytanizowana o porowatości 61%”
Oferujemy siatki o wytrzymałości na rozerwanie: 18 kg/cm², Grubość Filamentu: 0,15 mm, Grubość siatki: 0,56 mm w rozmiarze 20 cm x 25 cm
Zamawiający dopuszcza.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie 17 w pozycji 1 dopuści Cewnik trocar do drenażu klatki piersiowej o rozmiarach 16, 20, 24, 28, 32 spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający dopuszcza.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1-3** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 1-3 cewnik Foley z plastikową zastawką? Pozostałe zgodnie z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 4 worek do dobowej zbiórki moczu: pojemność worka 2 600 ml, skalowany co 100ml, pojemność komory pomiarowej 500 ml, skalowana komory: co 1ml od 4 do 50ml; co 5ml od 50 do 150ml; co 10ml od 150 do 500ml? Pozostałe zgodnie z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18, pozycji 1 dren o długości 3m? Pozostałe zgodnie z SWZ.
Zamawiający dopuszcza.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18, pozycji 4, sterylny dren łączący do odsysania CH24 dł. 210 cm? Pozostałe zgodnie z SWZ.
Zamawiający dopuszcza.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 23** - Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 23 - SIATKI PRZEPUKLINOWE** dopuści Makroporowa monofilamentowa niewchłaniałna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g/m². Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękką, łatwodopasowująca

się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar siatki bez zmian 10 x 15 cm.



Zgodnie z zapisami SWZ.

- 12. Dotyczy Pakietu Nr 24 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 - SIATKI PRZEPUKLINOWE** dopuści Makroporowa monofilamentowa niewchłaniaalna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g/m². Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękką, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar siatki 30,5 x 30,5 cm z możliwością docięcia.



Zamawiający dopuszcza.

- 13. Dotyczy Pakietu Nr 38 - Czy Zamawiający w Pakiet Nr 38 - SIATKA PRZEPUKLINOWA 3D** dopuści siatkę do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m². Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm² Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna, rozmiar 7.9 x 13,4 cm, 10.3 x 15.7 cm, 12.2 x 17.0 cm Lub Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 137,1 g/ m². Grubość siatki 0,69mm . Rozmiar porów 0,55 mm² Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna, rozmiar 8.5 x 13.7 cm, 10.8 x 16.0 cm, 12.4 x 17.3 cm Zamawiający rodzaj (ciężar, rozmiar, strona) siatki określi w trakcie składania zamówienia.



Zgodnie z zapisami SWZ.

- 14. Dotyczy Pakietu Nr 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?**

Skład:

- 1 x osłona na stół Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;
 - 2 x taśma mocująca 9x50cm; 2 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;
 - 1 x serweta główna 240/215x350cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (otoczony padem chłonnym 50x70cm, z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany);
 - 1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)
- Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m². Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów min. 115cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 147,3/144,5kPa.

Opakowanie papier-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie nr REF, LOT, data ważności, nazwa marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI

Zgodnie z zapisami SWZ.

15. Dotyczy Pakietu Nr 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

2 x taśma przylepna 9 x 50 cm;

1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm;

4 x ręcznik do osuszania rąk;

1 x osłona na kończynę 36 x 65 cm;

1 x serweta pomocnicza 150 x 190 cm;

1 x serweta do operacji kończyn 225 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm, z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów;

1 x serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu trzywarstwowego (nieprzemakalna włóknina + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 19µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 65g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m² (łączna gramatura 120g/m²). Odporność na penetrację płynów min. 140cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160,1/157,2kPa; Serweta pomocnicza na całej powierzchni wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m². Odporność na penetrację płynów min. 115cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 147,3/144,5kPa. Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019.

Opakowanie papier-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie nr REF, LOT, data ważności, nazwa marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI

Zgodnie z zapisami SWZ.

16. Dotyczy Pakietu Nr 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu (różnice podkreślono i pogrubiono)?

Uniwersalny zestaw sterylnych serwet do zabiegów chirurgicznych, ze wzmocnieniem w polu krytycznym, wielowarstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi :

- Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki ok.150x190 cm – 1 szt,

- Pokrowiec do nakrycia stolika Mayo 1 szt, (niebieski)

- Samoprzylepne serwety wzmocnione o wymiarach 75x90cm – 2szt.,

- Samoprzylepne serwety wzmocnione 180x180cm-1 szt.,

- Samoprzylepne serwety wzmocnione 150x240cm 1 szt.,

- Ręczniki chłonne **4szt.**

- Taśma samoprzylepna włókninowa **9** x50cm 1szt.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz conajmniej 2 etykiety samoprzylepne, służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, **nazwa marki** oraz kod **UDI**

Zamawiający dopuszcza.

17. Dotyczy Pakietu Nr 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład: 1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;

2 x taśma mocująca 9x50cm;

1 x serweta 100x150cm;

1 x osłona na kończynę 36x120cm;

1 x serweta główna 225x260cm z wycięciem U 20x85cm otoczonym taśmą przylepną, z padem chłonnym 50x100cm i organizatorami przewodów;

1 x serweta 150x300cm, wzmocnienia 15x50cm, 2 podwójne organizatory przewodów;

1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m².

Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów min. 125cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 148,1/145,2kPa.

Opakowanie papier-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie nr REF, LOT, data ważności, nazwa marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI

Zgodnie z zapisami SWZ.

18. Dotyczy Pakietu Nr 44 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

1 x osłona na stół Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;

1 x taśma mocująca 9x50cm; 4 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;

1 x serweta dla dziecka 75x120cm z włókniny Spunlace 50g/m²;

1 x serweta główna do cięcia cesarskiego 225x330cm, otwór 36x36cm wypełniony folią chirurgiczną, torba na płyny 72x72cm, 4 podwójne organizatory przewodów;

1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m².

Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów min. 115cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 147,3/144,5kPa.

Zamawiający dopuszcza.

19. Dotyczy Pakietu Nr 30 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 30 Siatkę dwustronna wewnątrzotrzewnowa separująca, miękka, niewchłaniająca, 2-warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, a z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość siatki 0,62 mm, porowatość średnia 667 µm, porowatość maksymalna 1359 µm, gramatura średnia 108 g/m², z oznaczeniem czarnym markerem powierzchni siatki, która powinna być skierowana w stronę jelit, o dwukierunkowej elastyczności, owalna, z możliwością docinania siatki.

w rozmiarach **pozycja nr 1: 20-25 cm**

pozycja nr 2: 14-18 cm

Zgodnie z zapisami SWZ.

20. Dotyczy Pakietu Nr 25, poz. 1 - Odnosząc się do wymagań Zamawiającego w pakiecie 25 w pozycji 1, dotyczących klipsów II generacji, informujemy, że oryginalne klipsy Hem-o-lok skutecznie utrzymują się na naczyniach. Z tego powodu nie ma potrzeby aby były wyposażone w ostre zęby osadzone pod kątem 45°, które mogłyby wywierać nadmierny nacisk na delikatną tkankę narażając ją na osłabienie. O stabilności, jakości oraz bezpieczeństwie klipsów Hem-o-lok świadczy fakt, że są one jedynymi klipsami rekomendowanymi przez producenta robota Da Vinci, firmę Intuitive Surgical. Chcielibyśmy zatem zapytać, czy Zamawiający w pakiecie 25 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłaniające, rozmiar L i XL (do wyboru przez Zamawiającego), nietoksyczne, niprogenne. Pakowane po 6 sztuk w magazynku, każdy magazynek wyposażony w taśmę umożliwiającą umocowanie do każdej powierzchni. Papierowa etykieta z każdego magazynka może zostać dołączona do dokumentacji chorego, z informacją o nr ref., numerze serii, dacie ważności itd?

Zgodnie z zapisami SWZ.

21. Dotyczy Pakietu Nr 25, poz. 2 - Odnosząc się do wymagań Zamawiającego w pakiecie 25 w pozycji 2, dotyczących klipsów II generacji, informujemy, że oryginalne klipsy Hem-o-lok skutecznie utrzymują się na naczyniach. Z tego powodu nie ma potrzeby aby były wyposażone w ostre zęby osadzone pod kątem 45°, które mogłyby wywierać nadmierny nacisk na delikatną tkankę narażając ją na osłabienie. O stabilności, jakości oraz bezpieczeństwie klipsów Hem-o-lok świadczy fakt, że są one jedynymi klipsami rekomendowanymi przez producenta robota Da Vinci, firmę Intuitive Surgical. Chcielibyśmy zatem zapytać, czy Zamawiający w pakiecie 25 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłaniające, rozmiar XL nietoksyczne, niprogenne. Pakowane po 6 sztuk w magazynku, każdy magazynek wyposażony w taśmę umożliwiającą umocowanie do każdej

powierzchni. Papierowa etykieta z każdego magazynka może zostać dołączona do dokumentacji chorego, z informacją o nr ref., numerze serii, dacie ważności?

Zgodnie z zapisami SWZ.

22. Dotyczy Pakietu Nr 25, poz. 3 - Czy Zamawiający w pakiecie 25 w pozycji 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy naczyniowe tytanowe rozmiar ML, sterylne do laparoskopii z zabezpieczeniem przed zsunieniem w postaci rowkowania poprzecznego i wzdłużnego wewnętrznej powierzchni. Pakowane po 6 sztuk w magazynku, każdy magazynek wyposażony w taśmę umożliwiającą umocowanie do każdej powierzchni. Papierowa etykieta z każdego magazynka może zostać dołączona do dokumentacji chorego, z informacją o nr ref., numerze serii, dacie ważności?

Zgodnie z zapisami SWZ.

23. Dotyczy Pakietu Nr 25 - W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pakiecie 25 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

Zamawiający nie wymaga.

24. Dotyczy Pakietu Nr 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie komponentów w pakiecie 7:

- 2x taśma lepna
- 1 x Elastyczna osłona na kończynę 30 x 75cm
- 1 x Serweta 150 x 190cm

Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Zgodnie z zapisami SWZ.

25. Dotyczy Pakietu Nr 22 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 22 zestawu o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny wzmocniona 117g/m² 190 x 150cm
- 1 x Serweta na stół instrumentalny wzmocniona 80g/m² 190 x 150cm
- 2 x Taśma OP 50 x 9cm
- 1 x Rzep 25 x 2cm
- 1 x Serweta 90 x 75cm
- 1 x Serweta 240 x 150cm z przyklepcem, wzmocniona

Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Zgodnie z zapisami SWZ.

26. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 5, 10-11 - Czy zamawiający wydzieli poz. 5, 10-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonanie takich czynności nie jest możliwe na gruncie przepisów ustawy Pzp i możliwości technicznych Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - Formularza Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

27. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 5 - Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?


Zamawiający nie dopuszcza.

28. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 10-11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający nie dopuszcza.

- 29. Dotyczy Projektu umowy § 10 ust. 4** - Prosimy o dopisanie zastrzeżenia o treści "za wyjątkiem sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 60 dni".
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 30. Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotki do chirurgicznego mycia rąk na stawce podatku vat 23%?
Zamawiający nie dopuszcza.
- 31. Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści dren o długości 3m?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 32. Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany podwójnie: wewnątrz folia, zewnątrz papier-folia?
Zamawiający dopuszcza.
- 33. Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści uchwyt o długości 21cm?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 34. Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie całego ortopedycznego zestawu do odsysania wraz z końcówkami i drenem?
Zamawiający nie dopuszcza.
- 35. Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści podwójne opakowanie (folia + folia-papier)?
Zamawiający dopuszcza.
- 36. Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze Ch24 o długości 2,1m?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 37. Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści podwójne opakowanie (folia + folia-papier)?
Zamawiający dopuszcza.
- 38. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1-3** - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z gumową zastawką?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 39. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley o długości 27cm?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 40. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu pakowany podwójnie folia/papier-folia?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 41. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści cewnik Tieman o powierzchni niezmróżonej w rozmiarach CH8-24?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 42. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 10-11** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 43. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarze całkowitym 65 x 95 cm, pow. lepna 65 x 85 cm?
Zamawiający dopuszcza.
- 44. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchem w rozmiarze L, umieszczony wewnątrz zestawu jako pierwszy komponent po rozwinięciu serwety na stolik instrumentariuszki?
Zgodnie z zapisami SWZ.

45. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo 80 x 140cm?
Zamawiający dopuszcza.
46. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią na narzędzia 30 x 40cm?
Zamawiający dopuszcza.
47. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem do ssaka CH24, 300cm?
Zamawiający dopuszcza.
48. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw bez drewna?
Zamawiający nie dopuszcza.
49. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami chirurgicznymi 150 x 180 cm (zamiast 150 x 190 cm)?
Zamawiający dopuszcza.
50. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z wycięciem U 230 x 260cm, rozmiar wycięcia 20 x 100cm ze wzmocnieniem w polu krytycznym?
Zamawiający dopuszcza.
51. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą samoprzylepną 150 x 240 cm (zamiast 150x250 cm) ze wzmocnieniem w polu krytycznym?
Zamawiający dopuszcza.
52. Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kończynę elastyczną w rozmiarze 22 x 75 cm?
Zamawiający dopuszcza.
53. Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:
- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm?

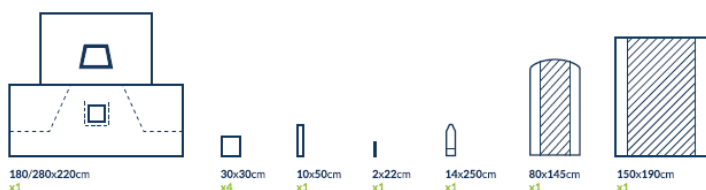

Zamawiający dopuszcza.

54. Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo w kolorze czerwonym?
Zamawiający nie dopuszcza.
55. Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 szt ręczników zamiast 3 szt?
Zamawiający dopuszcza.
56. Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą 13795? Norma ta dotyczy wyrobów włókienniczych.
Zamawiający wyraża zgodę.

- 57. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści ściereczki wykonane z włókniny spunlace zamiast z celulozy?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 58. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem 8,5 x 85 cm (zamiast 9 x 85 cm)?
Zamawiający dopuszcza.
- 59. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane mączką kukurydzianą, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu $0,18\pm 0,02$, na dłoni $0,16\pm 0,02$, mankiecie $0,14\pm 0,02$, długość min 280 mm. Poziom pudru <7 mg/dm², potwierdzony raportem zgodnie z ASTM D6124. Rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu ≤ 30 µg/g, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń, z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, co minimalizuje straty i podnosi efektywność pracy. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika, zewnętrzne foliowe z kodem GS-128?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 60. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana ułatwiająca zakładanie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu $0,18\pm 0,02$, na dłoni $0,16\pm 0,02$, mankiecie $0,14\pm 0,02$, długość min 280 mm. Rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu ≤ 30 µg/g, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń, z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, co minimalizuje straty i podnosi efektywność pracy. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika, zewnętrzne foliowe z kodem GS-128?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 61. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankieta, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Wyrób medyczny klasy Is. Grubość na palcu $0,33 - 0,40$ mm, na dłoni $0,27 - 0,35$ mm, na mankiecie $0,20 - 0,22$ mm, długość 480 ± 10 mm. Siła zrywu min 12 N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 10 µg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, EN ISO 374-1,2,3 (raport z badań z jednostki niezależnej). Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane podwójnie papier-papier. Rozmiary S(6.5), M(7.5), L(8.5)?
Zgodnie z zapisami SWZ.

62. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu $0,33\pm 0,01\text{mm}$, na dłoni $0,27\pm 0,02\text{mm}$, na mankiecie $0,22\pm 0,01\text{mm}$, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej $25\mu\text{g/g}$, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności) oraz przebadane zgodnie z wymaganiami normy ASTM D6978. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6.0-9.0?

Zgodnie z zapisami SWZ.

63. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, mikrotekstura na całej rękawicy i dodatkowa tekstura końcach palców, grubość na palcu $0,11\pm 0,02\text{mm}$, na dłoni $0,10\pm 0,02\text{mm}$ na mankiecie $0,07\pm 0,02\text{mm}$, długość min 245mm. AQL 1,0, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Zgodnie z zapisami SWZ.

64. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu $0,16\text{mm} \pm 0,01\text{mm}$, na dłoni $0,12 \pm 0,01\text{mm}$, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Zgodnie z zapisami SWZ.

65. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: $0,20\pm 0,02$, dłoni $0,18\pm 0,02\text{mm}$, mankiecie $0,16\pm 0,02\text{mm}$. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz

rozdzieleniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6.0-9.0?

Zgodnie z zapisami SWZ.

66. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczowania, bezpydrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Grubość ścianki rękawic: palec - rękawica spodnia $0,18 \pm 0,03$ mm, rękawica wierzchnia $0,21 \pm 0,02$ mm, dłoń - rękawica spodnia min 0,10 mm, rękawica wierzchnia $0,17 \pm 0,02$ mm, mankiet - rękawica spodnia min 0,10 mm, rękawica wierzchnia $0,16 \pm 0,02$ mm, długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max $30 \mu\text{g/g}$ dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozdzieleniem lewej i prawej dłoni oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5?

Zgodnie z zapisami SWZ.

67. Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Thorax pakowany w opakowanie papier – folia?

Zgodnie z zapisami SWZ.

68. Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętnicze z zamknięciem Fluoswitch w rozmiarze 20G x 13/4 " 1,1 x 45mm?

Zgodnie z zapisami SWZ.

69. Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o długości 400cm?

Zamawiający dopuszcza.

70. Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę ortopedyczną do odsysania o długości kaniuli 23cm?

Zgodnie z zapisami SWZ.

71. Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści dren łączący do odsysania w rozmiarze CH24 o długości 210cm, pakowany podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne?

Zamawiający dopuszcza.


72. Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki żółci z łącznikiem schodkowym CH8-24?

Zamawiający dopuszcza.

73. Dotyczy Pakietu Nr 22, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm


- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm?

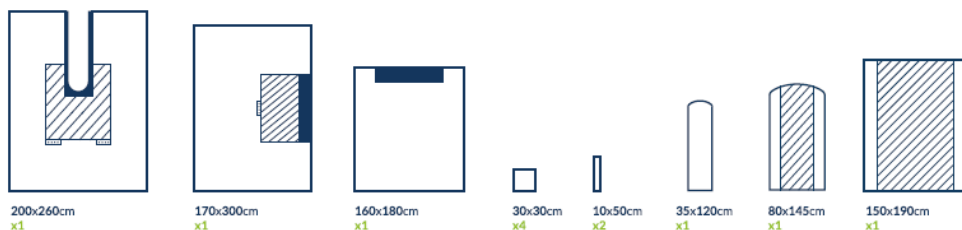

Zamawiający dopuszcza.

74. Dotyczy Pakietu Nr 22, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm?

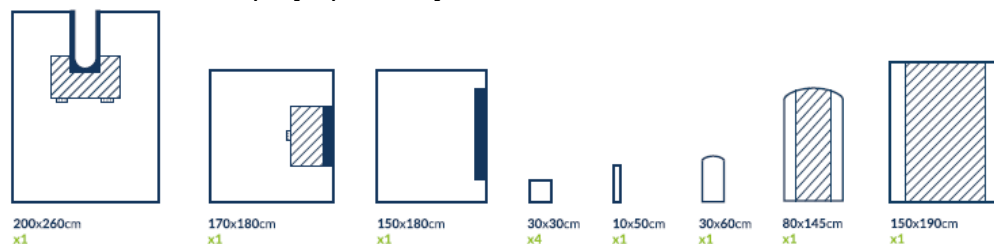

Zgodnie z zapisami SWZ.

75. Dotyczy Pakietu Nr 31, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści dren Khera wykonany w 100% biokompatybilnego silikonu o długości ramion 450mmx180mm pakowany w opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne: perforowana folia?

Zgodnie z zapisami SWZ.

76. Dotyczy Pakietu Nr 31, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści butelki redon skalowane co 10ml mające możliwość połączenia z drenami o średnicach od 8CH do 16CH?

Zamawiający dopuszcza.

77. Dotyczy Pakietu Nr 32, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z 5 szt tupferów z nitką RTG?

Zamawiający dopuszcza.

78. Dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści stapler skórny z 35 zszywkami wykonanymi ze stali nierdzewnej klasy medycznej bez dodatkowego powleczenia?

Zgodnie z zapisami SWZ.

79. Dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści stapler skórny z 35 zszywkami w rozmiarze 5,9mm x 3,9mm i średnicy 0,5mm?

Zgodnie z zapisami SWZ.

80. Dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści stapler skórny z 35 zszywkami w rozmiarze 7,2mm x 4,9mm i średnicy 0,6mm?

Zgodnie z zapisami SWZ.

81. Dotyczy Pakietu Nr 42, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z pokrowcami na nogi o wymiarach 70 x 120 cm?

Zamawiający dopuszcza.

82. Dotyczy Pakietu Nr 42, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą włókninową podfoliowaną 100 x 150cm, zamiast 90 x 150 cm?

Zamawiający dopuszcza.

83. Dotyczy Pakietu Nr 43, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

- 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm
- 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny spunlace
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm z włókniny spunlace
- 2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm

Do zestawu dołączona osobno sterylna serweta porodowa pod poślądki o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm. Bez taśmy przylepnej?

Zamawiający dopuszcza.

84. Dotyczy Pakietu Nr 44, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną o grubości 0,03mm i paroprzepuszczalności 850g/m²/24h, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm 360° z 2 portami do odsysania treści


• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m²

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm z włókniny spunlace

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m².

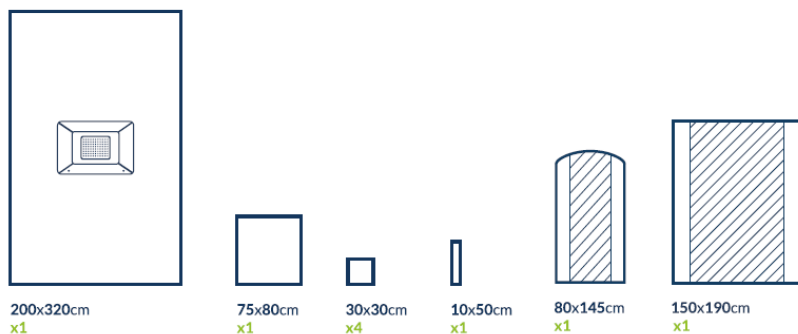

Zamawiający dopuszcza.

85. Dotyczy Pakietu Nr 6 - Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, LOT, dane wytwórcy.

Zamawiający dopuszcza.

86. Dotyczy Pakietu Nr 7 - Czy można zaoferować zestaw do zabiegów artroskopowych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo

1 osłona ortopedyczna na kończyne 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończyne 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego

Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref, data ważności, LOT, dane wytwórcy.

Zgodnie z zapisami SWZ.

87. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Czy można zaoferować zestaw do zabiegów brzuszno-kroczych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta brzuszno - kroczoza wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyne dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm

z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna.

Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref, data ważności, LOT, dane wytwórcy.

Zgodnie z zapisami SWZ.

88. Dotyczy Pakietu Nr 9 - Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego zawierającego 4 ręczniki celulozowe w którym serweta na stolik mayo wykonana jest z niebiesko- zielonej folii polietylenowej, a obszar wzmocniony wykonany z ciemnozielonej włókniny polipropylenowej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zamawiający dopuszcza.

89. Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik mayo wykonanej z niebiesko- zielonej folii polietylenowej, a obszar wzmocniony wykonany z ciemnozielonej włókniny polipropylenowej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zamawiający dopuszcza.

90. Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 2 - Czy można zaoferować torbę o wymiarach 60 cm x 90 cm? Dolna część posiada taśmę samoprzylepną, sztywnik oraz drobne sito i zawór, górna część samoprzylepne wycięcie w kształcie litery "U". Posiada perforację, która umożliwia zastosowanie w różnych procedurach chirurgicznych. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref, data ważności, LOT, dane wytwórcy.

Zamawiający nie dopuszcza.

- 91. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 1** - Czy można zaoferować ręczniczki w rozmiarze 30 x 40 cm pakowane a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający nie dopuszcza.
- 92. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 2** - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 150 x 240 cm ?
Zamawiający dopuszcza.
- 93. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 2** - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 150 x 180 cm ?
Zamawiający nie dopuszcza.
- 94. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 4** - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 225 x 260 cm z wycięciem U 10 x 100 cm?
Zamawiający dopuszcza.
- 95. Dotyczy Pakietu Nr 22** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestetyczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Pragniemy nadmienić iż Zamawiający od kilku lat pracuje z w/w zestawem i nigdy nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.
Zamawiający dopuszcza.
- 96. Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 1** - Czy można zaoferować fartuchy wykonane z włókniny SMMS w rozmiarach S/M, L, XL, XXL? Fartuchy posiadają oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR . Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 97. Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 2** - Czy można zaoferować fartuchy posiadające oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, z ręcznikami w rozmiarze 30 x 40 cm? Odporność na przenikanie cieczy 26 cm H₂O. 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR . Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 98. Dotyczy Pakietu Nr 33** - Czy można zaoferować kieszeń 1-komorową lub 2-komorową w rozmiarze 38 x 40 cm?
Zamawiający dopuszcza.
- 99. Dotyczy Pakietu Nr 43** - Czy można zaoferować zestaw do porodu o gramaturze 48g/m² o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta 2-warstwowa 100cm x 150cm (owinięcie zestawu)
10 kompresów włókninowych 10cm x 10cm
1 ręcznik 30 x 20 cm
1 serweta 2-warstwowa 75cm x 90cm
1 serweta dla noworodka 90cm x 90cm
1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90cm x 92cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE.
Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen + polietylen).
Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.
Pragniemy nadmienić iż Zamawiający od kilku lat pracuje z w/w zestawem i nigdy nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.
Zamawiający nie wyraża zgody.

100. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych o poniższym składzie:

1 x serweta 250/312x290cm cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 9 x 12 cm, zintegrowana z torbą na płyny, wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu.

1 x serweta na stół instrumentalny 140 cm x 190 cm.

1 pokrowiec na stolik Mayo

1 ręcznik chłonny

1 taśma samoprzylepna

Dodatkowo :

1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm

Zamawiający wyraża zgodę.

101. Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do zabiegów artroskopowych o poniższym składzie:

1 serweta do nakrycia stołu inst. 140x190 cm,

1 pokrowiec na stolik Mayo,

1 serweta wzmocniona do obłożenia kończyny rozmiar 200x320cm cm. z elastycznym samouszczelniającym otworem

2 taśmy samoprzylepne 9 x 50 cm ,

2 ręczniki chłonne

1 osłona na kończynę elastyczna rozmiar 35 cm x 80cm

Dodatkowo:

1 x nieprzylepna serweta 150x150cm

Zamawiający wyraża zgodę.

102. Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do zabiegów brzuszno-kroczywych o poniższym składzie:

1 serweta brzuszno-kroczywa o wymiarach 250/260x230 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 6 uchwytów na dren oraz 2 okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 32x40 cm wypełnione folią operacyjną o wymiarach 19x29cm oraz otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i nieprzylepne okno do obłożenia krocza (bez klapki) o wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na pow. 50x84 cm, zintegrowane z osłoną na kończyny

Pokrowiec na stolik Mayo 80x145cm .

Serweta na stół instrumentalny o wym. 140x190cm

2 Ręczniki chłonne 3szt.

Zgodnie z zapisami SWZ.

103. Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o poniższym składzie:

Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki ok.140x190 cm – 1 szt,

Pokrowiec do nakrycia stolika Mayo1 szt, (niebieski)
Samoprzylepne serwety wzmocnione o wymiarach 75x90cm – 2szt.,
Samoprzylepna serweta wzmocniona 175x200cm -1szt.,
Samoprzylepna serweta wzmocnione 150x240cm 1 szt.,
Ręczniki chłonne 4szt.
Taśma samoprzylepna włókninowa 9 x50cm 1szt.

Zamawiający dopuszcza.

104. Dotyczy Pakietu Nr 44, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o poniższym składzie i parametrach:

A) 1 x serweta główna w kształcie To wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem wypełnionym całkowicie folią chirurgiczną o wymiarach 17x32x27cm otoczonym torbą 360o do zbiórki płynów (bez elementów metalowych) oraz 2 portami do podłączenia drenów i piankowym kształtownikiem. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 62g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) większa niż 100cm oraz wytrzymałości na rozerwanie min.100 Kpa

B) pokrowiec na stół Mayo 80X145cm wykonany z folii PE o minimalnej grubości min. 0,06mm i warstwy chłonnej wykonanej włóknina polipropylenowa 40 g/m2 – 1szt.

C) ściereczka chłonna – 2szt.,

D) owinięcie noworodka z włókniny bawełnopodobnej o wymiarze 90x100 cm,

E) serweta owinięcie 140X190 cm – przykrycie na stół instrumentalny wykonane w całości z folii piaskowanej PE 50g/m2 + na powierzchni 80x190cm wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 30g/m2, o minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): = większe 100cm oraz wytrzymałość na rozerwanie min.100 KPA- 1szt.

Zamawiający nie wyraża zgody.

105. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zoferowania zestawu do biodra o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm
3 fartuch chirurgiczny typu SMS wzmocniony XL- 147 cm
1 fartuch chirurgiczny typu SMS wzmocniony L (na zewnątrz zestawu)- 127 cm
1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm
2 Serweta chirurgiczna 175 cm x 150 cm
1 zestaw ssaków ortopedycznych 23,4/7,8 CH/mm 300 cm
1 kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm
1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
1 opatrunek pooperacyjny 10 x 8 cm
1 opatrunek pooperacyjny 25 x 10 cm
1 pojemnik plastikowy niebieski 250 ml
1 elektroda czynna typu Erbe 320 cm, 16,5 cm z końcówką nożową
1 Czyścik do koagracji 5 x 5 cm
1 Kleszczyki do mycia pola operacyjnego proste, 24 cm, niebieski
1 pojemnik na igły i ostrza magnetyczny 15/15 miejsc
1 butelka Redona OR-System 400 ml
1 dren Redona 16/5,33 CH/mm, 50 cm
2 igła iniekcyjna 18G,1,20 x 40 mm
2 strzykawka do płukania ran 100 ml
4 Ręcznik chłonny 33 cm x 30 cm
4 taśma przylepna 10 x 50 cm
10 tuper z gazy z nitką RTG 34 x 34 cm
10 Serwety gazowe do laparotomii ze znacznikiem Rtg 45 cm 45 cm, 4 warstwy
20 kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw
1 serweta wzmocniona 225 x 280 cm, z otworem przylepnym „U” 10 x 100 cm
1 serweta wzmocniona przylepna 240 x 150 cm

Zgodnie z zapisami SWZ.

106. Dotyczy Pakietu Nr 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ginekologicznego o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona (nieprzylepna, bez naklejki do zamykania zestawu) 150 x 190 cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów bez sztywnika i otworem (9 x 12 cm) 250/280 x 280 cm

1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod poślądki 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 2 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Zgodnie z zapisami SWZ.

107. Dotyczy Pakietu Nr 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów artroskopowych o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm) 300 x 200 cm

1 osłona na kończynę 35 x 55 cm

3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

1 osłona na kamerę 13 x 250 cm

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 2 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Zgodnie z zapisami SWZ.

108. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów brzuszno- kroczywych o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 taśma przylepna 10 x 50 cm

1 serweta przylepna 90 x 75 cm

1 serweta brzuszno-kroczywa z padami chłonnymi (otwory 19 x 29 cm i 9 x 12 cm z klapką) zintegrowana z osłonami na kończy 230 x 250/280 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 2 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności,

Zamawiający dopuszcza.

109. Dotyczy Pakietu Nr 9 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Lub

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 200 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

W obu zestawach opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 2 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy

Zamawiający dopuszcza.

- 110. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczniczków celulozowych w rozmiarze 30 x 33 cm, pakowanych w opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający nie dopuszcza.

- 111. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z wycięciem „U” w rozmiarze 6,5 x 95cm?

Zgodnie z zapisami SWZ.

- 112. Dotyczy Pakietu Nr 22** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu) 190 x 150 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm
- 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x serweta extra wzmocniona, U przylepne 10 x 95 cm (pad z wiskozy) 245 x 280 cm
- 1 x serweta przylepna 300 x 170 cm
- 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm
- 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm

LUB

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 4 x ręczniki celulozowe 33 x 30 cm
- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x serweta extra wzmocniona, U przylepne 10 x 95 cm (pad z wiskozy) 245 x 280 cm
- 1 x serweta wzmocniona przylepna z warstwą przylepną 300 x 170 cm
- 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona 190 x 150 cm
- 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm

W obu zestawach opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 2 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy

Zamawiający nie dopuszcza.

- 113. Dotyczy Pakietu Nr 32** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do mycia pola operacyjnego o następującym składzie:

- 6 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jajka
- 1 x kleszczyki plastikowe 24 cm

1 x transparentna miseczka plastikowa 150 ml

Zgodnie z zapisami SWZ.

114. Dotyczy Pakietu Nr 36 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów stawu kolanowego o następującym składzie:

- 1 serweta do obłożenia kończyny rozmiar 200x320 cm. z elastycznym samouszczelniającym otworem 5 x 7 cm i z uchwytem do mocowania kabli i drenów;
- 1 osłona na kończynę elastyczna rozmiar 35cm x 80cm
- 1 fartuch chirurgiczny SMS 127 cm rozmiar L (umieszczony na zestawie)
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 2 serwety na stół instrumentariuszki wzmocnione 150 x 190 cm
- 4 ręcznik 30x33cm.
- 3 fartuchy chirurgiczne wzmocnione SMS 147cm- rozmiar XL.
- 1 serweta na stół Mayo 80x145cm.
- 1 kieszeń na narzędzia 43x38cm jednokomorowa.
- 4 taśma samoprzylepna 10x50cm.
- 1 zestaw ssaków ortopedycznych 23,4/7,8 CH/mm 300 cm.
- 1 elektroda czynna monopolarna do elektrokoagulacji typu Erbe z końcówką nożową dł kabla 3,2m.
- 1 dren Redona 16/5,33 CH/mm 50 cm
- 1 butla Redona 400ml
- 1 pudełko magnetyczne do liczenia igieł.
- 2 strzykawki 100 ml .
- 2 igły iniekcyjne 18 G (1,2 x 40 mm)
- 1 czyścik do elektrody 5x5cm.
- 1 pojemnik plastikowy 250ml.
- 10 tupferów gazowych z nitką RTG do mycia pola operacyjnego
- 1 kleszczyki do mycia pola operacyjnego
- 20 kompresy gazowe z nitką RTG, 16 warstwowe 10x10cm.
- 10 serwet gazowych białych z chip RTG 4-warstwowe 45x45cm.
- 1 opatrunek do ran 10x25cm.
- 1 opatrunek do ran 10x8cm

Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z 2 dwiema papierowymi okrągłymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. W opakowaniu etykieta ze składem zestawu i z min. 4 odklejanymi etykietami z numerem serii, datą ważności produktu.

Zamawiający dopuszcza.

115. Dotyczy Pakietu Nr 42 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia poporodowego o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) 75 x 90 cm
- 1 serweta operacyjna 90 x 75 cm
- 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm
- 1 imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 16 cm
- 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm
- 1 kleszczyki plastikowe proste (do mycia pola operacyjnego) 19 cm
- 1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm
- 10 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 40g/m²
- 5 tupferów gazowych 24 x 24 cm, 20 nitek

Opakowanie wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Zamawiający nie dopuszcza.

116. Dotyczy zapisów SWZ, punkt 4.4a - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodnie z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykule 2 ust. 37?

Zamawiający oczekuje oświadczenia zgodnie z punktem 4.4a SWZ.

117. Dotyczy Projektu umowy § 2, ust. 15 - Wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Zgodnie z § 9, ust. 1 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy

Zamawiający nie wyraża zgody.

118. Dotyczy Projektu umowy § 9, ust. 1 - Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §9 ust. 1, pkt.1 do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia;
- §9 ust. 1 pkt. 2 do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia;
- §9 ust. 1 pkt. 3 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części zamówienia;

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Zamawiający nie wyraża zgody.

119. Czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem wskazania w nim czynności, do których jest umocowany Pełnomocnik.

120. Dotyczy Projektu umowy § 2, ust. 12 - Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych wyrobów medycznych z 18 do 12 miesięcy? Biorąc pod uwagę fakt, że dostawy realizowane są na bieżąco, w bardzo krótkich terminach i Szpital nie buduje sobie zapasów, 12 miesięczny termin ważności wydaje się być wystarczający.

Zamawiający nie wyraża zgody.

121. Dotyczy Projektu umowy § 5, ust. 1, pkt. 2) - Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować podany paragraf w następujący sposób: „2) Wykonawca może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia, pod warunkiem, iż suma dwóch kolejnych kwartalnych wskaźników wzrostu cen towarów i usług w stosunku do poprzednich okresów kwartalnych, wynikających z komunikatów Prezesa GUS ogłaszanych na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2023.1251 tj. z dnia 2023.06.30 ze zm..) w sprawie wskaźnika cen

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i przypadających na okres realizacji umowy przekroczy poziom 5 %;”?

Zamawiający nie wyraża zgody.

122. Dotyczy Projektu umowy § 5, ust. 1, pkt. 8) - Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować podany paragraf w następujący sposób: „8) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów, wynosi 10 % liczona od wartości pierwotnej wynagrodzenia”?

Zamawiający nie wyraża zgody.

123. Dotyczy Projektu umowy § 9, ust. 3 - Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 20% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto?

Zamawiający nie wyraża zgody.

124. Dotyczy Projektu umowy § 14, ust. 2 - Czy Zamawiający zgodzi się dodać do wzoru umowy „chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczony towar przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie dotychczasowej treści § 14 ust. 2 wzoru umowy może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 14 ust. 2 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana na podstawie np. art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Zamawiający nie wyraża zgody.

125. Dotyczy Pakietu Nr 6 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów ginekologicznych z serwetą 275 cm x 200 cm (pozostałe wymagania dot. serwety zgodne z SWZ), dwoma ręcznikami chłonnymi, zamiast trzech oraz dodatkową serwetą 90 cm x 75 cm z przyklepcem na dłuższym boku? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zgodnie z zapisami SWZ.

126. Dotyczy Pakietu Nr 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet wzmocnionych do zabiegów artroskopowych z laminatu dwuwarstwowego zgodnego z normą 13795 o podanym niżej składzie?

- pokrowiec na kończynę 75 cm x 37 cm – 1 szt.,
- serweta wzmocniona do obłożenia kończyny rozmiar 320 cm x 240 cm z otworem o średnicy 6 cm z elementem elastycznym – 1 szt.,
- ręczniki chłonne – 2 szt.,
- pokrowiec na stół Mayo – 1 szt.,
- serweta do nakrycia stołu inst. 150 cm x 190 cm – 1 szt.,
- taśmy samoprzylepne 9 cm x 50 cm - 2 szt.
- opakowanie zgodne z SWZ.

Zgodnie z zapisami SWZ.

127. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów brzuszno-kroczykowych z laminatów zgodnych z normą 13795 o podanym niżej składzie?

- serweta podstawowa 260 cm x 240 cm, w części centralnej serwety znajduje się otwór 34 cm x 30 cm z folią chirurgiczną, w części kroczykowej otwór 10 cm x 15 cm wraz z przykrywającą go klapką, zintegrowane osłony na kończynie – 1 szt.,
- serweta dwuwarstwowa 90 cm x 75 cm – 1 szt.,
- serweta do nakrycia stołu inst. 150 cm x 190 cm – 1 szt.,
- pokrowiec na stół Mayo – 1 szt.,
- ręczniki chłonne – 4 szt.,
- kieszeń dwukomorowa 42 cm x 35 cm z przyklepcem i kształtką – 1 szt.,
- taśma medyczna 9 cm x 50 cm – 1 szt.,
- opakowanie zgodne z SWZ.

Zamawiający dopuszcza.

- 128. Dotyczy Pakietu Nr 9** - Czy Zamawiający dopuści uniwersalny zestaw sterylnych serwet do zabiegów chirurgicznych, ze wzmocnieniem w polu krytycznym, z laminatu dwuwarstwowego z łatami chłonnymi zgodnego z normą 13795 z samoprzylepną serwetą wzmocniona o wymiarach 170 cm x 200 cm (zamiast 180 cm x 180 cm), ręcznikami chłonnymi 2 szt. oraz taśmą chłonną 9 cm x 50 cm – 1 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 129. Dotyczy Pakietu Nr 23** - Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe o wadze 60 – 85 g/m², powierzchnia makroporów min. 3,3 mm², grubość nici transparentnej jak i niebieskiej 0,16 mm, rozmiar 10 cm x 16 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 130. Dotyczy Pakietu Nr 24** - Czy Zamawiający dopuści siatkę o powierzchni makroporów min. 3,3 mm²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 131. Dotyczy Pakietu Nr 29, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem owalnym 6 x 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Zamawiający dopuszcza.
- 132. Dotyczy Pakietu Nr 32** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do mycia pola operacyjnego z tupferami o wykroju 20 cm x 20 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 133. Dotyczy Pakietu Nr 32** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do mycia pola operacyjnego o podanym niżej składzie?
- miska 500 ml – 1 szt.,
 - tupfery bez znacznika RTG o wykroju 50 cm x 50 cm – 5 szt.,
 - korbang plastikowy – 19 cm – 1 szt.;
 - rękawice niepudrowane nitrylowe L – 2 szt.
- Zgodnie z zapisami SWZ.**
- 134. Dotyczy Pakietu Nr 42** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia poporodowego z serwetą w rozmiarze 180 cm x 90 cm z laminatu polipropylenowo-polietylenowego (w miejsce serwety z włókniny w rozmiarze 90 cm x 150 cm) oraz z dwoma pokrowcami na kończynę z włókniny o gramaturze 35 g/m² (w miejsce 43 g/m²)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza.
- 135. Dotyczy Pakietu Nr 43** - Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z opisem w formularzu asortymentowo-cenowym z dodatkową serwetką kompresową w rozmiarze 80 cm x 60, osobno zapakowana serweta pod pośladki z torbą na płyny bez wzmocnienia i przylepca? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza.
- 136. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o dł. 27 cm, sztywna zastawka do napełnienia balonu.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 137. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z sztywną zastawką do napełnienia balonu.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 138. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem o pojemności 30-50 ml, z sztywną zastawką do napełnienia balonu.
Zgodnie z zapisami SWZ.

- 139. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 5** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o dł. 120 cm.
Zamawiający dopuszcza.
- 140. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 6 i 7** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika bez powierzchni zmrożonej, która nie jest niezbędna do wprowadzenia cewnika do cewki moczowej.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 141. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 8** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 24-34 Fr.
Zamawiający dopuszcza.
- 142. Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 1** - Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m², stopień 2 repelencji dla wody i alkoholi. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów min. 50 cm H₂O w obszarze krytycznym i mniej krytycznym. Oznaczenie SP (Standard Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 4,8 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M – 2XL (tj. o długości od 115 cm do 160 cm). Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30 x 39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. Pakowane po 32 lub 36 sztuk w kartonie zbiorczym, w zależności od rozmiaru.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 143. Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 1** - Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m². Stopień 8 repelencji materiału dla wody i alkoholu. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów min. 50 cm H₂O w obszarze krytycznym i mniej krytycznym. Oznaczenie SP (Standard Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Oznaczenie graficzne na przedniej części fartucha określające barierowość w Amerykańskiej skali AAMI, służące do wzajemnej kontroli użytkowników. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 4,0 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach L – 2XLL (tj. o długości od 120 cm do 170 cm). Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30 x 39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. Pakowane po 32 lub 36 sztuk w kartonie zbiorczym, w zależności od rozmiaru.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 144. Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 2** - Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina z masy celulozowej i poliestru), o gramaturze min. 68 g/m². Stopień 7 repelencji materiału dla wody i alkoholu. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów min. 24 cm H₂O w obszarze krytycznym i mniej krytycznym. Oznaczenie SP (Standard Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 2,8 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL (tj. o długości od 115 cm do 170 cm). Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez

jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30 x 39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. Pakowane po 24 lub 28 sztuk w kartonie zbiorczym, w zależności od rozmiaru.

Zgodnie z zapisami SWZ.

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1003738>